




DOC023.98.90830

# EZ2700sc

06/2025, Edition 1

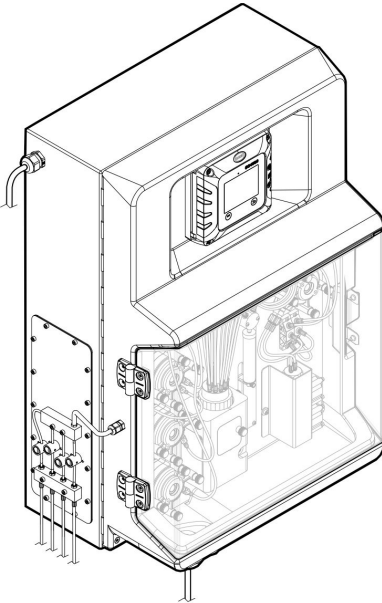

**Installation Manual**  
**Installationsanleitung**  
**Manuale di installazione**  
**Manuel d'installation**  
**Manual de instalación**  
**Manual de instalação**  
**Návod k instalaci**  
**Installatiehandleiding**  
**Installationsvejledning**  
**Podręcznik instalacji**  
**Installationshandbok**  
**Asennusohjeet**  
**Ръководство за инсталиране**  
**Beépítési útmutató**  
**Manual de instalare**  
**Įrengimo vadovas**  
**Руководство по установке**  
**Kurulum Kılavuzu**  
**Inštaláčná príručka**  
**Namestitveni priručnik**  
**Priručnik za ugradnju**  
**Εγχειρίδιο εγκατάστασης**  
**Paigaldusjuhend**

## Table of Contents

---

English.....	3
Deutsch.....	21
Italiano.....	40
Français.....	59
Español.....	78
Português.....	97
Čeština.....	116
Nederlands.....	135
Dansk.....	154
Polski.....	172
Svenska.....	192
Suomi.....	210
български.....	229
Magyar.....	249
Română.....	268
lietuvių kalba.....	287
Русский.....	306
Türkçe.....	326
Slovenský jazyk.....	344
Slovenski.....	362
Hrvatski.....	380
Ελληνικά.....	399
eesti keel.....	419

Figures ■ Abbildungen ■ Figure ■ Figures ■ Figuras ■ Figuras ■ Obrázky ■ Afbeeldingen  
■ Figurer ■ Rysunki ■ Figurer ■ Kuviot ■ Фигури ■ Ábrák ■ Figuri ■ Skaičiai ■ Рисунки  
■ Şekil ■ Obrázky ■ Slike ■ Slika ■ Εικόνες ■ Joonised..... 437

# Table of Contents

1	<a href="#">Additional information</a>	on page 3	4	<a href="#">General information</a>	on page 5
2	<a href="#">Product overview</a>	on page 3	5	<a href="#">Installation</a>	on page 7
3	<a href="#">Specifications</a>	on page 4	6	<a href="#">Startup</a>	on page 16

## Section 1 Additional information

The basic user manual contains information that is sufficient for commissioning. An expanded user manual is available online and contains more information.

⚠ DANGER	
	Multiple hazards! More information is given in the individual sections of the expanded user manual that are shown below.

- User interface and navigation
- Operation
- Maintenance
- Troubleshooting
- Replacement part lists

Scan the QR codes that follow to go to the expanded user manual.



European languages



American and Asian languages

## Section 2 Product overview

The Hach EZ2700sc analyzer is an online analyzer that measures one parameter in water samples from industrial and environmental applications. Refer to [Figure 1](#) on page 438, [Figure 2](#) on page 441 and [Figure 3](#) on page 446.

The analyzer is an online colorimetric analyzer for general water analysis (e.g., nitrate, phosphate). The analyzer has options for Remote start, automatic validation, automatic calibration, automatic cleaning and Modbus.

The sample water enters the analyzer through the sample tube. The pumps, valves and syringes in the analyzer move the sample and reagents to the measuring cell on the analytics panel. When the analysis vessel is complete, the analyzer discards the sample through the drain tube. The analysis results show on the display of the SC4500 Controller. The SC4500 Controller saves the analyzer data (data log, event log, settings log and service log). Use the SC4500 Controller to operate and configure the analyzer.

To increase the number of sample streams (channels) that the analyzer can measure (2, 4 or 8), purchase the Moduplex multi-stream panel with the analyzer.

To precondition the sample (filtration, settling), purchase the EZ9010, EZ9020, EZ9150, EZ9200 or EZ9250 filtration panel with the analyzer.

## Section 3 Specifications

Specifications are subject to change without notice.

Specification	Details
Dimensions (W x H x D)	460 x 688 x 340 mm (18.1 x 27.1 x 13.4 inches)
Enclosure	IP44; ABS, PMMA and coated steel
Display	IP66, 3.5 inch TFT color display with capacitive touchpad
Weight	40 kg (88 lb)
Power requirements	100 to 240 VAC $\pm$ 10%, 50/60 Hz
Power consumption	240 VA maximum
Altitude	2000 m (6560 ft) maximum
Overvoltage category	II
Environmental conditions	Indoor use only
Pollution degree	2
Operating temperature	10 to 30 °C (50 to 86 °F); 5 to 95% relative humidity, non-condensing, non-corrosive
Storage temperature	-20 to 60 °C (-4 to 140 °F), 95% relative humidity, non-condensing maximum
Sample inlets	One
Sample pressure	By external overflow vessel (open to atmospheric pressure)
Sample flow rate	100 to 300 mL/min
Sample temperature	10 to 30 °C (50 to 86 °F)
Sample quality	< 100 $\mu$ m particles, < 0.1 g/L maximum Turbidity < 50 NTU
Air purge for corrosive environments	0.2 bar (20 kPa or 3 psi); dry and clean air
Drain	Atmospheric pressure, vented, minimum $\varnothing$ 32 mm
Earth connection	Dry and clean grounding pole with low impedance (< 1 $\Omega$ ) with an earth cable of > 2.5 mm <sup>2</sup> (13 AWG)
Analog outputs	Eight 0–20 mA (or 4–20 mA) analog outputs maximum <i>Note: The analog outputs supply the loop power. Power cannot be supplied to the contacts of the SCADA or PLC system.</i>
Digital inputs	Seven digital inputs: Two digital inputs for remote start. The remaining digital inputs are for future use.
Digital outputs	Four energized digital outputs for the valves and pumps of the EZ9150 panel; eight energized digital outputs for the valves of the Moduplex panel; 24 VDC, 500 mA.
Relays	Five potential-free contact (PFC), maximum loading 24 VDC, 0.5 A (resistive load)
Ethernet connections	Clarus Ethernet connection and Modbus TCP/IP Ethernet connector; LAN version; 10/100 Mbps, or Profinet or Ethernet IP
RS485 communications	Profibus DP or Modbus RTU

<sup>2</sup> For information on Ethernet configuration and Modbus configuration, refer to the SC4500 Controller documentation.

Specification	Details
Certifications	CE, ETL certified to UL and CSA safety standards, UKCA
Warranty	1 year (EU: 2 years)

## Section 4 General information

In no event will the manufacturer be liable for damages resulting from any improper use of product or failure to comply with the instructions in the manual. The manufacturer reserves the right to make changes in this manual and the products it describes at any time, without notice or obligation. Revised editions are found on the manufacturer's website.

EN

### 4.1 Safety information

The manufacturer is not responsible for any damages due to misapplication or misuse of this product including, without limitation, direct, incidental and consequential damages, and disclaims such damages to the full extent permitted under applicable law. The user is solely responsible to identify critical application risks and install appropriate mechanisms to protect processes during a possible equipment malfunction.

Please read this entire manual before unpacking, setting up or operating this equipment. Pay attention to all danger and caution statements. Failure to do so could result in serious injury to the operator or damage to the equipment.

If the equipment is used in a manner that is not specified by the manufacturer, the protection provided by the equipment may be impaired. Do not use or install this equipment in any manner other than that specified in this manual.

#### 4.1.1 Use of hazard information

##### **▲ DANGER**

Indicates a potentially or imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

##### **▲ WARNING**

Indicates a potentially or imminently hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

##### **▲ CAUTION**



Indicates a potentially hazardous situation that may result in minor or moderate injury.





##### **NOTICE**

Indicates a situation which, if not avoided, may cause damage to the instrument. Information that requires special emphasis.


#### 4.1.2 Precautionary labels

Read all labels and tags attached to the instrument. Personal injury or damage to the instrument could occur if not observed. A symbol on the instrument is referenced in the manual with a precautionary statement.









	This is the safety alert symbol. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid potential injury. If on the instrument, refer to the instruction manual for operation or safety information.
	This symbol identifies a risk of chemical harm and indicates that only individuals qualified and trained to work with chemicals should handle chemicals or perform maintenance on chemical delivery systems associated with the equipment.

	This symbol indicates that a risk of electrical shock and/or electrocution exists.
	This symbol indicates the presence of devices sensitive to Electro-static Discharge (ESD) and indicates that care must be taken to prevent damage with the equipment.
	This symbol indicates that the marked item requires a protective earth connection. If the instrument is not supplied with a ground plug on a cord, make the protective earth connection to the protective conductor terminal.
	Electrical equipment marked with this symbol may not be disposed of in European domestic or public disposal systems. Return old or end-of-life equipment to the manufacturer for disposal at no charge to the user.

#### 4.1.3 Chemical and biological safety

<b>⚠ DANGER</b>	
	Chemical or biological hazards. If this instrument is used to monitor a treatment process and/or chemical feed system for which there are regulatory limits and monitoring requirements related to public health, public safety, food or beverage manufacture or processing, it is the responsibility of the user of this instrument to know and abide by any applicable regulation and to have sufficient and appropriate mechanisms in place for compliance with applicable regulations in the event of malfunction of the instrument.

#### 4.2 Icons used in illustrations

			
Manufacturer supplied parts	User supplied parts	Look	Do steps in reverse order
			
Use two people	Listen	Use fingers only	Do not touch

#### 4.3 Intended use

The Hach EZ-series analyzers are intended for use by individuals who have to continuously measure water quality parameters in samples from industrial and environmental applications. The Hach EZ-series analyzers do not treat or alter water and are not used to control procedures.

#### 4.4 Product components

Make sure that all components have been received. Refer to [Figure 4](#) on page 450. If any items are missing or damaged, contact the manufacturer or a sales representative immediately.

## Section 5 Installation

### ⚠ DANGER



Multiple hazards. Only qualified personnel must conduct the tasks described in this section of the document.

### 5.1 Installation guidelines

#### ⚠ WARNING



Fire hazard. The user is responsible to make sure that sufficient precautions are taken when the equipment is used with methods that use flammable liquids. Make sure to obey correct user precautions and safety protocols. This includes, but is not limited to, spill and leak controls, proper ventilation, no unattended use, and that the instrument is never left unattended while power is applied.

#### ⚠ CAUTION



Chemical exposure hazard. Obey laboratory safety procedures and wear all of the personal protective equipment appropriate to the chemicals that are handled. Refer to the current safety data sheets (MSDS/SDS) for safety protocols.

#### ⚠ CAUTION



Chemical exposure hazard. Dispose of chemicals and wastes in accordance with local, regional and national regulations.

- Install the analyzer indoors, in a non-hazardous environment.
- Install the analyzer in an environment that is protected from corrosive fluids.
- Install the analyzer in a clean, dry, well-ventilated and temperature-controlled location.
- Install the analyzer as near to the sampling point as possible.
- Do not install the analyzer in direct sunlight or near a heat source.
- Make sure that there is sufficient clearance to make plumbing and electrical connections.
- Make sure to leave sufficient space in front of the analyzer to open the analyzer door. Refer to [Analyzer dimensions](#) on page 8.
- Make sure that the ambient conditions are within operating specifications. Refer to [Specifications](#) on page 4.

Although the analyzer is not designed for use with flammable samples, some EZ-analyzers use flammable reagents. Refer to the Method & Reagent Sheet of the applicable EZ series model for more information on reagents used in the analyzer. If the analyzer uses flammable reagents, make sure to obey the safety precautions that follow:

- Keep the analyzer away from heat, sparks and open flame.
- Do not eat, drink or smoke near the analyzer.
- Use a local exhaust ventilation system.
- Use spark and explosion-proof appliances and lighting system.
- Prevent electrostatic discharges. Refer to [Electrostatic discharge \(ESD\) considerations](#) on page 8.
- Fully clean and dry the instrument before use.
- Wash hands before breaks and at the end of the working period.
- Remove contaminated clothing. Wash clothing before reuse.
- These fluids must be handled in accordance with local regulatory agency requirements on permissible exposure limits.

## 5.2 Analyzer dimensions

Refer to [Figure 5](#) on page 454 for the analyzer dimensions.

## 5.3 Mechanical installation

### 5.3.1 Attach the instrument to a wall

#### ▲ WARNING



Personal injury hazard. Make sure that the wall mounting is able to hold 4 times the weight of the equipment.

#### ▲ WARNING



Personal injury hazard. Instruments or components are heavy. Use assistance to install or move.

#### ▲ WARNING



Personal injury hazard. The object is heavy. Make sure that the instrument is securely attached to a wall, table or floor for a safe operation.

Use the supplied mounting brackets to attach the instrument upright and level on a flat, vertical wall surface. Refer to [Figure 6](#) on page 456.

Install the instrument in a location and position where the user can easily disconnect the instrument from the power source.

Make sure that there is sufficient clearance below the analyzer to install the bottles.

Mounting hardware is supplied by the user. Make sure that the wall fastener has sufficient load bearing capacity (approximately 160 kg or 353 lbs). The mounting hardware must be approved for the properties of the wall.

### 5.3.2 Open the analyzer door

Use the supplied key to unlock the two locks on the side of the analyzer. Refer to [Figure 7](#) on page 456. Make sure to close the door before operation to maintain the environmental rating of the enclosure and safety rating.

## 5.4 Electrical installation

#### ▲ DANGER



Electrocution hazard. Always remove power to the instrument before making electrical connections.

### 5.4.1 Electrostatic discharge (ESD) considerations

#### NOTICE



Potential Instrument Damage. Delicate internal electronic components can be damaged by static electricity, resulting in degraded performance or eventual failure.

Refer to the steps in this procedure to prevent ESD damage to the instrument:

- Touch an earth-grounded metal surface such as the chassis of an instrument, a metal conduit or pipe to discharge static electricity from the body.
- Avoid excessive movement. Transport static-sensitive components in anti-static containers or packages.

- Wear a wrist strap connected by a wire to earth ground.
- Work in a static-safe area with anti-static floor pads and work bench pads.

## 5.4.2 Electrical access

Put the cables of the external devices through the cable glands. Refer to [Figure 8](#) on page 457. Keep the plugs in the cable glands that are not used.

[Figure 9](#) on page 460 shows the components inside the analyzer. The power switch is a circuit breaker that automatically cuts off the main power supply from the AC power line if an overcurrent (short circuit for example) or overvoltage condition occurs.

## 5.4.3 Connect the external devices

Connect the external devices that will be used with the analyzer to the signal and control terminals in the analyzer. Refer to [Figure 10](#) on page 463 and [Table 1](#) on page 9.

**Table 1 Signal and control terminals—Descriptions**

Pin	Description
AO1–AO8 (P101)	Eight analog outputs to control external devices. Refer to the expanded user manual version online for more information.
FCT1–FCT5 (P102)	Five relays (potential-free contacts). The loading maximum is 24 VDC, 0.5 A. <ul style="list-style-type: none"> <li>• FCT1—Malfunction alarm</li> <li>• FCT2—Maintenance alarm</li> <li>• FCT3—Analyzer ready</li> <li>• FCT4 and FCT5—For future use</li> </ul>
DI1–DI7 (P103)	Seven digital inputs to control the analyzer remotely <sup>5</sup> . Connect the digital inputs to an external potential-free contact (24 VDC) to trigger the analyzer to start a measurement for a channel. <ul style="list-style-type: none"> <li>• DI1—Remote start for Channel 1</li> <li>• DI2—Remote start for Channel 2</li> <li>• DI3 to DI7—For future use</li> </ul>
FB1–FB4 (P104)	Profibus DP or Modbus RTU (RS485) connectors <b>Profibus DP:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FB1—A1 (input)</li> <li>• FB2—A2 (output)</li> <li>• FB3—B1 (input)</li> <li>• FB4—B2 (output)</li> <li>• SHL—Shield</li> </ul> <b>Modbus RTU:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FB1—D (+)</li> <li>• FB2—D (-)</li> <li>• FB3—not used</li> <li>• FB4—not used</li> <li>• SHL—Shield</li> </ul> Refer to the SC4500 Controller documentation for Modbus configuration instructions and telegram tags.
24VDC/1A (P105)	24 V DC power supply for EZ9010 and EZ9020 filtration units

<sup>5</sup> If the analyzer is in maintenance mode, remote control is disabled.

**Table 1 Signal and control terminals—Descriptions (continued)**

Pin	Description
STR1–STR8 (P106)	<p>Eight digital outputs for the optional Moduplex panel. Connect the bare wires of each channel valve on the Moduplex panel to the related STR connectors.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• STR1—Channel 1</li> <li>• STR2—Channel 2</li> <li>• ...</li> <li>• STR8—Channel 8</li> </ul>
EXT9–EXT12 (P107)	<p>Four digital outputs for the optional EZ9150 filtration panel. Connect the electric valves and pump on the EZ9150 filtration panel to the EXT connectors.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EXT9—Rinse valve</li> <li>• EXT10—Backflush valve</li> <li>• EXT11—Drain overflow valve</li> <li>• EXT12—Filtration pump</li> </ul>
D01–D06 (P108 and P109)	<p>Six pneumatic valve outputs for the EZ9150 panel.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• D01—Sample inlet valve</li> <li>• D02—Drain overflow valve</li> <li>• D03—Channel 1 valve</li> <li>• D04—Channel 2 valve</li> <li>• D05—Channel 3 valve</li> <li>• D06—Channel 4 valve</li> </ul>

#### 5.4.4 Connect to AC power

### ⚠ DANGER



Electrical shock and fire hazards. Make sure that the supplied cord and non-locking plug meet the applicable country code requirements.


- Make sure that a circuit breaker with sufficient electrical current capacity is installed in the power line.
- Make sure that the circuit breaker or an emergency switch is installed near the analyzer so that the analyzer can be immediately disconnected from the power supply if necessary.
- Connect equipment in accordance with local, state or national electrical codes.
- Install the supplied power cord through the cable gland that is on the side of the analyzer.
- Tighten the cable gland to hold the power cable securely and keep the environmental rating of the enclosure.

Connect the analyzer to AC power with the supplied AC power cord. Refer to [Table 2](#) on page 11 and [Figure 11](#) on page 468.

## NOTICE

Do not set the power switch to on. Complete all of the electrical and plumbing connections before startup or damage to the analyzer can occur.

**Table 2 Wiring information—AC power**

Terminal	Description	Cable color—North America and Canada	Cable color—EU
L	Hot/Line (L)	Black (1)	Brown
N	Neutral (N)	White (2)	Blue
	Protective earth ground (PE)	Green with yellow stripe	Green with yellow stripe

EN

## 5.5 Plumbing

### 5.5.1 Sample line guidelines

#### ⚠ CAUTION



Fire hazard. This product is not designed for use with flammable samples.

Select a good, representative sampling point for the best instrument performance. The sample must be representative of the entire system.

- Make sure that the sample flow is higher than the flow to the analyzer.
- Make sure that the sample line is at atmospheric pressure if the analyzer uses a peristaltic pump to move the sample into the analysis vessel.
- Make sure that the sample line collects sample from a small overflow vessel near to the analyzer.
- Use the sample line that is supplied. Do not change the length of the sample line.

The sample in the overflow vessel must be continuously refreshed. If the size of solids in the sample is too high, sample filtration is also recommended.

### 5.5.2 Drain line guidelines

#### ⚠ WARNING



Fire hazard. The user is responsible to make sure that sufficient precautions are taken when the equipment is used with methods that use flammable liquids. Make sure to obey correct user precautions and safety protocols. This includes, but is not limited to, spill and leak controls, proper ventilation, no unattended use, and that the instrument is never left unattended while power is applied.

#### ⚠ CAUTION



Chemical exposure hazard. Dispose of chemicals and wastes in accordance with local, regional and national regulations.

## NOTICE

Do not connect the drain lines to other lines because backpressure or damage to the analyzer can occur. Make sure that the drain lines are open to air.

## NOTICE

To prevent backpressure and damage to the analyzer, make sure that the analyzer is higher than the facility drain(s) used and that the drain line has a constant downward slope. Install the drain lines with a 2.54 cm (1 inch) or more vertical decrease for each 0.3 m (1 ft) length of tubing.

The analyzer uses the drain line to release the sample and reagents after analysis. Correct installation of the drain lines is important to make sure that all of the liquid is removed from the instrument. Incorrect installation can cause liquid to go back into the instrument and cause damage. A floor or sink drain is sufficient for the drain line. The recommended external diameter for the drain tube is 32 mm. Refer to [Figure 12](#) on page 470.

- Make the drain lines as short as possible.
- Make sure that the drain is lower than the analyzer.
- Make sure that the drain lines have a constant slope down.
- Make sure that the drain lines do not have sharp bends and are not pinched.
- Make sure that the drain lines are open to air and are at zero pressure.
- Make sure that the drain lines are closed to the ambient of the installation room.
- Do not block or submerge the drain line.

A water connection near to the analyzer is also recommended so that the drain sink and drain tubing are regularly flushed with clean water to prevent blockage by crystallization.

Refer to the Method & Reagent Sheet of the applicable EZ series model for more information on reagents used in the analyzer. If the analyzer uses flammable reagents, make sure to obey the safety precautions that follow:

- Do not plumb the drain line to a floor drain.
- Dispose of waste in accordance with local, state and national environmental regulations.

### 5.5.3 Vent line guidelines

#### ▲ WARNING



Fire hazard. The user is responsible to make sure that sufficient precautions are taken when the equipment is used with methods that use flammable liquids. Make sure to obey correct user precautions and safety protocols. This includes, but is not limited to, spill and leak controls, proper ventilation, no unattended use, and that the instrument is never left unattended while power is applied.

#### ▲ CAUTION



Chemical exposure hazard. Dispose of chemicals and wastes in accordance with local, regional and national regulations.

## NOTICE

Do not connect the vent line (exhaust gas port) to other lines because backpressure or damage to the analyzer can occur. Make sure that the vent line is open to air at the building exterior.

## NOTICE

To prevent backpressure and damage to the analyzer, make sure that the analyzer is higher than the facility vent(s) used and that the vent line has a constant downward slope. Install the vent line with a 2.54 cm (1 inch) or more vertical decrease for each 0.3 m (1 ft) length of tubing.

The analyzer uses the vent line to keep the analysis vessel at atmospheric pressure. Correct installation of the vent line is important to make sure that during the pump operation no liquid enters the analysis vessel from the vent line. Incorrect installation can cause gas to go back into the analyzer and cause damage. The recommended external diameter for the header tube of the vent line is 32 mm. Refer to [Figure 12](#) on page 470.

- Make the vent line as short as possible.
- Make sure that the vent line has a constant slope down.

- Make sure that the vent line does not have a sharp bend and is not pinched.
- Make sure that the vent line is closed to the ambient of the installation room and is at zero pressure.
- Make sure that the vent line is always higher than the drain.
- Do not block or submerge the vent line.

If the analyzer uses flammable reagents, make sure to obey the safety precautions that follow:

- Do not plumb the vent line to a floor drain.
- Dispose of waste in accordance with local, state and national environmental regulations.

### 5.5.4 Plumb the analyzer for the component test


#### ▲ CAUTION



Fire hazard. This product is not designed for use with flammable liquids.


Before the analyzer with all of the reagents is put into operation, a component test with deionized water must be done. Refer to the illustrated steps and to [Do the component tests](#) on page 17.

1. Install the four pinch valve tubes as shown in illustrated step 1 that follows.
  - a. Push the black button, then push the tubing into the valve.
  - b. Release the button when the tubing is correctly installed.
2. Make sure that the drain tubing is correctly installed in the sample vessel. Refer to the illustrated step 2 that follows.
3. Make sure that the digester tubing is correctly installed in the digester vessel. Refer to the illustrated step 3 that follows.
4. Plumb all of the analyzer liquid tubing to a large bottle of deionized water to do a test of the components. Refer to the illustrated step 3 that follows. The tubing is factory installed.

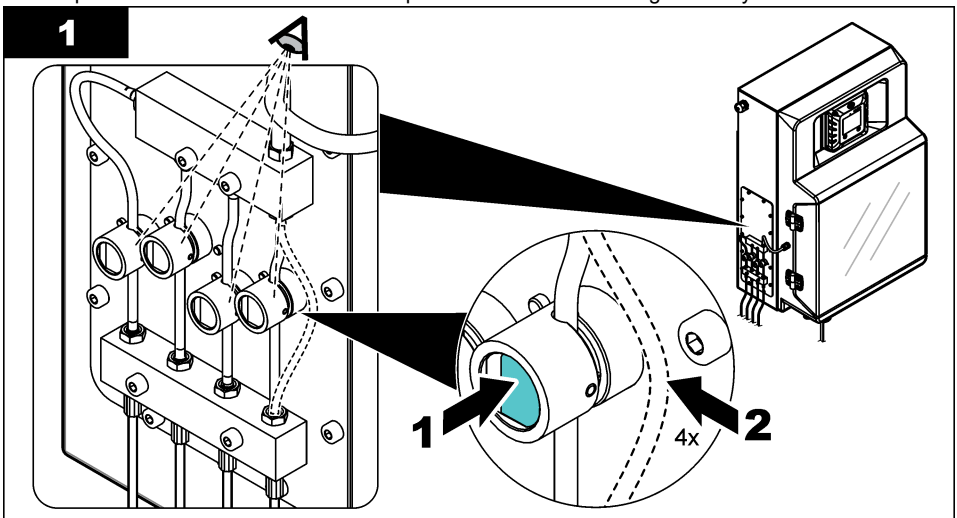




2

EN

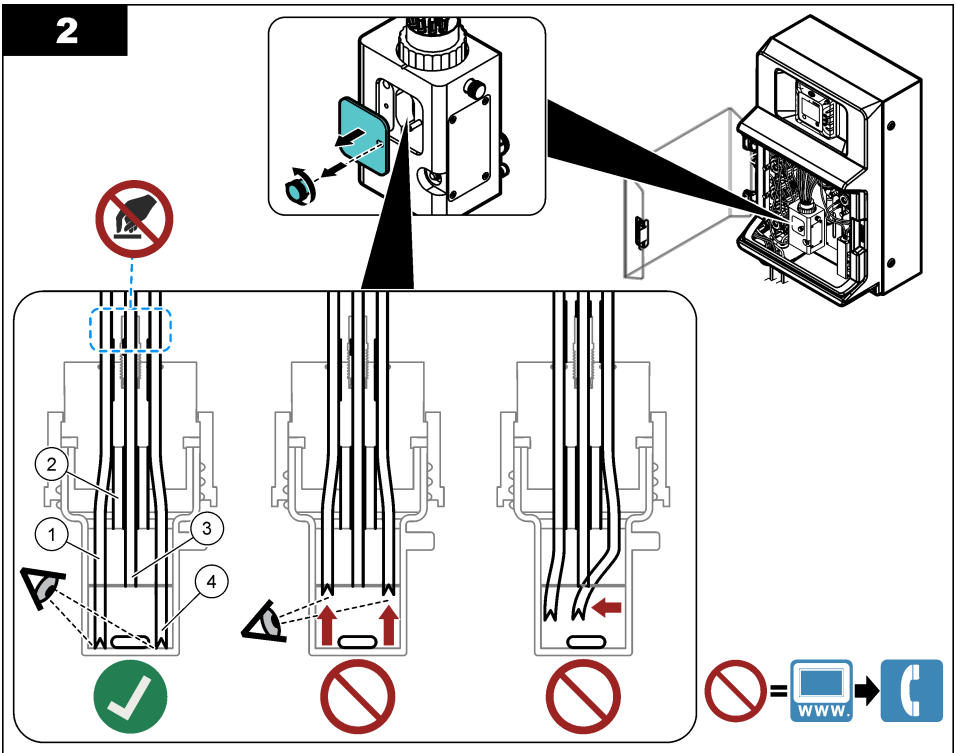

1 Drain tubing	3 Sample tubing
2 Reagents and vent tubing (top tubing)	4 Digester tubing


3

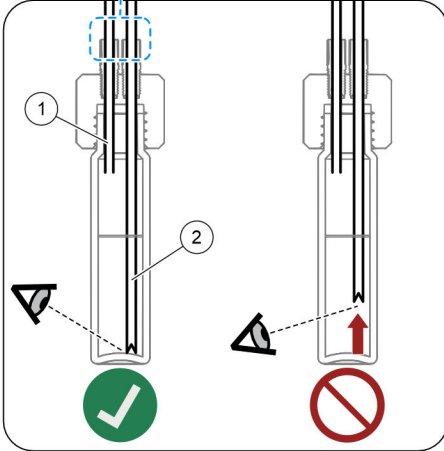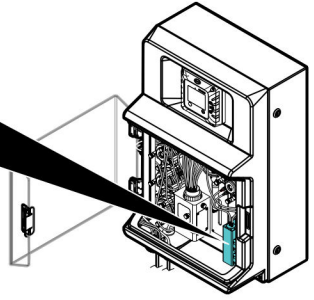

EN

1 Vent tubing

2 Digester tubing

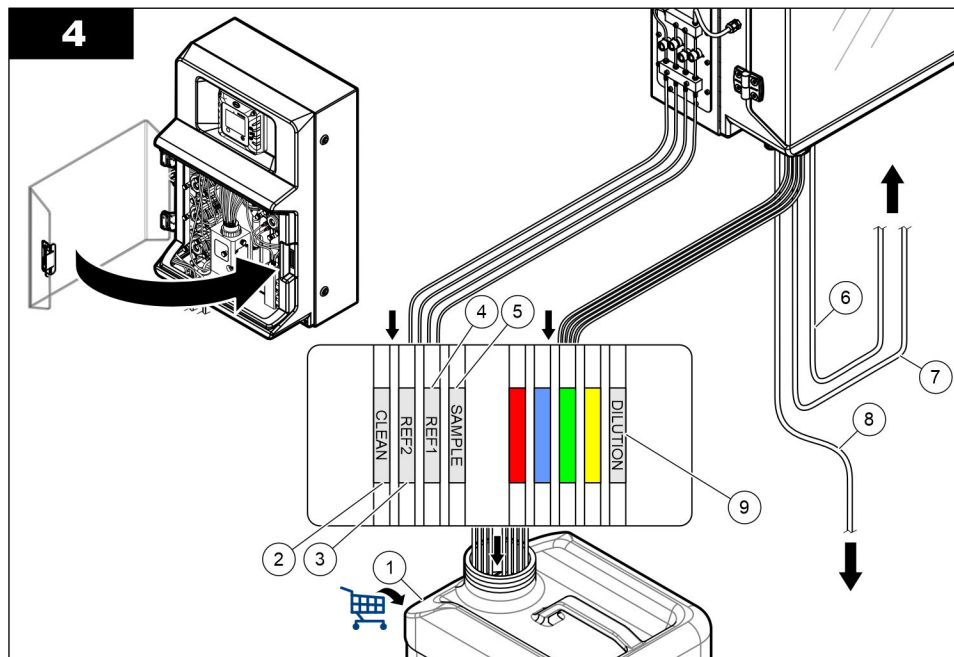

1 Deionized water	4 Reference 1 solution (REF1) tube	7 Vent digester
2 Cleaning solution tube	5 Sample inlet tube	8 Drain tubing
3 Reference 2 solution (REF2) tube	6 Vent tubing	9 Dilution and reagent micropump tubing

## Section 6 Startup

### 6.1 Initial startup

**Note:** Make sure that the mounting, tubing and electrical installations are fully completed before startup. Refer to [Installation](#) on page 7.

When the analyzer is set to on for the first time, a start-up assistant will help with the first steps to complete the setup. Complete all of the steps that follow to make sure that the analyzer is operating correctly.

**Note:** Make sure to use the correct reagents for the selected measuring range. Refer to the expanded user manual version online for more information.

1. Open the analyzer door. Refer to [Open the analyzer door](#) on page 8.
2. Set the power switch to the ON position. Refer to [Figure 9](#) on page 460.
3. Close the analyzer door with the supplied key.
4. Wait for the initialization procedure to complete.
5. Respond to the prompts on the display to select the language, time zone, date and time.  
To configure the other controller settings, refer to the SC4500 Controller documentation.
6. Tap the display to show the **EZ2700sc** menu.
7. Select **Device menu** to start the start-up assistant.  
The welcome screen shows.
8. Complete the steps shown on the display to select the applicable measurement range. Push **OK**.

9. If a filtration unit is installed, select **On**. If not, select **Off**.
10. Select the number of channels for the analyzer. Push **OK**.
11. If the configuration shown on the summary page is correct, push **OK**.  
The **EZ2700sc** main menu shows.
12. Continue with the component test. Refer to [Do the component tests](#) on page 17.

## 6.2 Do the component tests

### ▲ WARNING



Pinch hazard. Parts that move can pinch and cause injury. Do not touch moving parts.

Do the component tests before the analyzer is put into operation. Use the **Maintenance** menu to start the different analyzer functions to examine the component operation.

#### Pre-requisites:

- If the analyzer is in operational mode, select **Maintenance > Start maintenance mode**.
- Make sure that the sample, reagent and solution tubing are in a container of deionized water.  
Refer to [Plumb the analyzer for the component test](#) on page 13.

### 6.2.1 Examine the stirrer

1. Remove the light shield from the photometer unit. Refer to [Figure 13](#) on page 472.
2. Make sure that the stirrer is in the bottom of the sample vessel.  
*Note: Examine the stirrer during the priming procedure to make sure that the stirrer turns correctly. The priming procedure is started in [Examine the pumps and pinch valves](#) on page 17.*
3. Install the light shield on the photometer.

### 6.2.2 Examine the pumps and pinch valves

1. Examine the pumps and pinch valves operation to make sure that there are no leaks.
2. Make sure that the analysis vessel fills with deionized water. Refer to [Figure 14](#) on page 473.
3. Make sure that deionized water goes out the drain tubing.
4. Select **Maintenance > Start priming** and prime all of the liquids separately.  
If a leak occurs, examine all of the connections and refer to the expanded user manual version online for more information.
  - a. Select **Prime reference 1** and push **OK**.
  - b. Select **Prime reference 2** and push **OK**.
  - c. Select **Prime cleaning solution** and push **OK**.
  - d. Select **Prime rinsing** and push **OK**.
  - e. Select **Prime dispenser** and push **OK**.
  - f. Select **Prime channel > Prime all channels** and push **OK**.  
Each prime procedure is automatically stopped when the procedure is completed.

### 6.2.3 Examine the micropumps

Examine the micropumps for leaks and air bubbles.

1. Remove the light shield from the photometer.
2. Select **Maintenance > Start priming > Prime all reagents**.

3. Make sure that deionized water goes into the micropump through each of the the micropump (reagent) tubes. Then, into the analysis vessel continuously with no air bubbles. Refer to [Figure 15](#) on page 475.
4. If the micropumps do not operate correctly (bubbles in the tubing), use the syringe procedure to push deionized water into the applicable tubing to remove the bubbles. Refer to [Figure 16](#) on page 476.
5. Install the light shield on the photometer.

#### 6.2.4 Do a photometer check

Make sure that the external of the analysis vessel is clean before the photometer check so that the check can be completed successfully. To clean the analyzer components refer to the expanded user manual version online for more information.

1. Push the main menu icon, then select **Devices**.
2. Select **EZ2700sc**.
3. Scroll down to the bottom of the screen, then select **Device menu**.
4. Select **Maintenance > Photometer check**.
5. Push **OK** to start the measurement.  
When the dark calibration is complete, the result is shown on the display.
6. Push **OK** to continue.
7. Make sure that the "REF1" tubing is connected to a container filled with deionized water. Make sure that the light shield is installed. Refer to [Figure 18](#) on page 478.
8. Push **OK**.  
Wait until the analysis vessel is filled.
9. Use a screwdriver to adjust the voltage of the sensor output to 9 V. Refer to [Figure 17](#) on page 476.
10. Wait until the value of 9 V is shown on the screen. Then push **OK**.
11. Push **OK** to continue.

### 6.3 Do an input signal test

Do a test of the digital inputs before the analyzer is put into operation.

**Pre-requisites:** Connect the digital inputs to an external potential-free contact (24 VDC).

Do a digital input signal and analog output signal test as follows:

1. Push the main menu icon, then select **Devices**.
2. Select **EZ2700sc**.
3. Scroll down to the bottom of the screen, then select **Device menu**.
4. Select **Diagnostics > Signals**.  
The signals at the digital inputs show.
5. Compare the status of the digital inputs on the display to the voltages supplied to the digital inputs (24 V = On; 0 V = Off).

### 6.4 Do an output signal test

Do a test of the analog outputs before the analyzer is put into operation.

**Pre-requisites:** Configure the analog outputs (AO1–AO8, P101) to select the channel measurement represented by each analog output. Refer to the expanded user manual version online for more information.

Do an analog output signal test as follows:

1. Push the main menu icon.
2. Select **Outputs > mA outputs AOC > Test/Maintenance**.

Option	Description
<b>Function test</b>	Does a test on the outputs on the selected module.
<b>Output status</b>	Shows the condition of the outputs on the selected module.

3. Use a multi-meter to measure the mA value at each analog output.
4. Compare the mA value measured at the analog outputs to the expected mA values.

## 6.5 Set the channel sequence

Select the sequence in which the channels are measured, the number of times each channel is measured and the waiting time before a channel is measured. Enter a maximum of 16 lines with a maximum of 16 cycles each.

1. Push the main menu icon, then select **Devices**.
2. Select **EZ2700sc**.
3. Scroll down to the bottom of the screen, then select **Device menu**.
4. If the analyzer is in operational mode, select **Maintenance > Start maintenance mode**. Wait until the analyzer is in maintenance mode.
5. Select **Configuration > Channel sequence setup**.
6. Use the arrows on the side bar to select a position (number in the sequence), then push **OK** to configure that position.
7. Select an option.

Option	Description
<b>Select</b>	Selects the applicable channel or waiting time.
<b>Number of measurements</b>	Sets the number of measurements for a channel.
<b>Waiting time</b>	Sets the waiting time for the selected channel.

8. Push **OK** to save the changes.

## 6.6 Plumb the solutions and sample

### ▲ CAUTION



Chemical exposure hazard. Obey laboratory safety procedures and wear all of the personal protective equipment appropriate to the chemicals that are handled. Refer to the current safety data sheets (MSDS/SDS) for safety protocols.

### ▲ CAUTION



Chemical exposure hazard. Dispose of chemicals and wastes in accordance with local, regional and national regulations.

### ▲ CAUTION



Fire hazard. This product is not designed for use with flammable liquids.

The reagent containers are supplied with the analyzer. Refer to [Figure 18](#) on page 478. The containers for Reference 1 solution and Reference 2 solution and deionized water are supplied by the user. More containers can be purchased by the manufacturer.

Install the containers

- as near as possible to the analyzer
- 1 meter below the bottom of the analyzer

Refer to [Figure 18](#) on page 478 for the container installation.

The reagents and solutions are supplied by the user. Use only reagents supplied by a certified company or use manufacturer dedicated reagents. As an alternative, reagents can be prepared by the user. Follow the instructions in the Method & Reagent Sheet for the applicable model found on the manufacturer's website.

The tubing is factory installed. Read the label on each tube to identify the correct plumbing connection. Refer to the applicable Method & Reagent Sheet for the model found on the manufacturer's website for the correct reagents, solutions and standards.

1. After the component tests are done, install the "CLEAN" (cleaning solution), "REF1" (Reference 1 solution) and "REF2" (Reference 2 solution) tubing in the related containers. Refer to [Figure 18](#) on page 478.
2. Install each color-coded reagent tube in the reagent container with the same color on the label.
3. Plumb the sample source (or the sample outlet of the Moduplex panel or filter panel) to the sample inlet tube of the analyzer. Refer [Figure 18](#) on page 478.
4. Push the main menu icon, then select **Devices**.
5. Select **EZ2700sc**.
6. Scroll down to the bottom of the screen, then select **Device menu**.
7. Select **Maintenance > Start priming > Prime all**.

## 6.7 Do a validation before initial startup

Do a validation to make sure that the measurements are within the tolerance range. Refer to the expanded user manual version online for more information.

1. Push the main menu icon, then select **Devices**.
2. Select **EZ2700sc**.
3. Scroll down to the bottom of the screen, then select **Device menu**.
4. To start a validation, select **Calibration > Validation > Start validation**.  
The validation measures the deionized water in the Reference 2 bottle.
5. To show the results, select an option:
  - **Calibration > Validation > Validation history**
  - **Diagnostics > Historical data > Validation**

## 6.8 Start the analyzer

To start the analyzer:

1. Push the main menu icon, then select **Devices**.
2. Select **EZ2700sc**.
3. Scroll down to the bottom of the screen, then select **Device menu**.
4. Select **Maintenance > Start operational mode**.

# Inhaltsverzeichnis

- 1 [Zusätzliche Informationen](#) auf Seite 21
- 2 [Produktübersicht](#) auf Seite 21
- 3 [Spezifikationen](#) auf Seite 22
- 4 [Allgemeine Informationen](#) auf Seite 23
- 5 [Installation](#) auf Seite 25
- 6 [Inbetriebnahme](#) auf Seite 34

## Kapitel 1 Zusätzliche Informationen

Das Basis-Benutzerhandbuch enthält Informationen, die für die Inbetriebnahme ausreichend sind. Ein erweitertes Benutzerhandbuch ist online verfügbar und enthält zusätzliche Informationen.

DE

### ⚠ GEF AHR



Mehrere Gefahren! Weitere Informationen finden Sie in den jeweiligen Abschnitten des erweiterten Benutzerhandbuchs, wie unten gezeigt.

- Benutzeroberfläche und Navigation
- Durchführung einer Messung
- Wartung
- Fehlersuche und -behebung
- Ersatzteillisten

Scannen Sie die folgenden QR-Codes, um zum erweiterten Benutzerhandbuch zu gelangen.



Europäische Sprachen



Amerikanische und asiatische Sprachen

## Kapitel 2 Produktübersicht

Der Hoch-Analysator EZ2700sc ist ein Online-Analysator für Anwendungen in Industrie und Umweltschutz zur Messung eines Parameters in Wasserproben. Siehe [Abbildung 1](#) auf Seite 437, [Abbildung 2](#) auf Seite 441 und [Abbildung 3](#) auf Seite 445.

Der Analysator ist ein kolorimetrischer Online-Analysator für allgemeine Wasseranalysen (z. B. Nitrat, Phosphat). Der Analysator bietet Optionen für Fernstart, automatische Validierung, automatische Kalibrierung, automatische Reinigung und Modbus.

Das Probenwasser tritt durch den Probenschlauch in den Analysator ein. Die Pumpen, Ventile und Spritzen im Analysator transportieren die Probe und die Reagenzien zur Messzelle auf dem Analysemodul. Nach Abschluss der Analyse im Analysegefäß leitet der Analysator die Probe durch den Ablaufschlauch aus. Die Analyseergebnisse werden im Display des SC4500 Controllers angezeigt. Der SC4500 Controller speichert die Analysatordaten (Datenprotokoll, Ereignisprotokoll, Einstellungsprotokoll und Wartungsprotokoll). Betreiben und konfigurieren Sie den Analysator mit dem SC4500 Controller.

Um die Anzahl der Probenströme (Kanäle) zu erhöhen, die der Analysator messen kann (2, 4 oder 8), erwerben Sie das Mod duplex Multistream Modul mit dem Analysator.

Zur Vorkonditionierung der Probe (Filtration, Absetzen) erwerben Sie das Filtrationsmodul EZ9010, EZ9020, EZ9150, EZ9200 oder EZ9250 mit dem Analysator.

# Kapitel 3 Spezifikationen

Änderungen vorbehalten.

Spezifikationen	Details
Größe (B x H x T)	460 x 688 x 340 mm
Gehäuse	IP44; ABS, PMMA und beschichteter Stahl
Display	IP66; 3,5 Zoll TFT-Farbdisplay mit kapazitivem Touchpad
Gewicht	40 kg (88 lb)
Spannungsversorgung	100 bis 240 VAC ± 10 %, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	240 VA maximal
Einsatzhöhe	Maximal 2000 m (6560 Fuß)
Überspannungskategorie	II
Umgebungsbedingungen	Nur im Innenbereich
Verschmutzungsgrad	2
Betriebstemperatur	10 bis 30 °C, relative Luftfeuchtigkeit 5 bis 95 %, nicht kondensierend
Lagertemperatur	-20 bis 60 °C, maximal 95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Probenzuläufe	Einer
Probedruck	Mittels externem Überlaufgefäß (offen zum atmosphärischen Druck)
Durchflussgeschwindigkeit der Probe	100 bis 300 mL/min
Probertemperatur	10 bis 30 °C
Probenqualität	< 100 µm Partikel, < 0,1 g/L maximal Trübung < 50 NTU
Luftspülung für korrosive Umgebungen	0,2 bar (20 kPa); trockene und saubere Luft
Abfluss	Barometerdruck, frei liegender Auslass, mind. ø 32 mm
Erdungsanschluss	Trockener und sauberer Erdungsstab mit niedriger Impedanz (< 1 Ω) mit Erdungskabel > 2,5 mm <sup>2</sup> (13 AWG)
Analogausgänge	Maximal acht Analogausgänge mit 0 - 20 mA (oder 4 - 20 mA) <i>Hinweis: Die Analogausgänge liefern den Schleifenstrom. Die Kontakte des SCADA- oder SPS-Systems können nicht mit Strom versorgt werden.</i>
Digitaleingänge	Sieben Digitaleingänge: Zwei Digitaleingänge für den Fernstart. Die übrigen Digitaleingänge sind für zukünftige Verwendungszwecke vorgesehen.
Digitalausgänge	Vier bestromte Digitalausgänge für die Ventile und Pumpen des EZ9150 Moduls; acht bestromte Digitalausgänge für die Ventile des Moduplex Moduls; 24 VDC, 500 mA.
Relais	Fünf potentialfreie Kontakte (FCT), maximale Last 24 VDC; 0,5 A (ohmsche Last)
Ethernet-Anschlüsse	Clarus Ethernet-Verbindung und Modbus TCP/IP Ethernet-Anschluss; LAN-Version; 10/100 MBit/s oder Profinet oder Ethernet IP
RS485-Kommunikation	Profibus DP oder Modbus RTU

<sup>2</sup> Weitere Informationen zur Ethernet-Konfiguration und Modbus-Konfiguration finden Sie in der Dokumentation zum SC4500 Controller.

Spezifikationen	Details
Zertifizierungen	CE- und ETL-zertifiziert gemäß UL- und CSA-Sicherheitsstandards, UKCA
Gewährleistung	1 Jahr (EU: 2 Jahre)

## Kapitel 4 Allgemeine Informationen

Der Hersteller haftet in keinem Fall für Schäden, die aus einer unsachgemäßen Verwendung des Produkts oder der Nichteinhaltung der Anweisungen in der Bedienungsanleitung resultieren. Der Hersteller behält sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung das Recht auf Verbesserungen an diesem Handbuch und den hierin beschriebenen Produkten vor. Überarbeitete Ausgaben der Bedienungsanleitung sind auf der Hersteller-Webseite erhältlich.

### 4.1 Sicherheitshinweise

Der Hersteller ist nicht für Schäden verantwortlich, die durch Fehlanwendung oder Missbrauch dieses Produkts entstehen, einschließlich, aber ohne Beschränkung auf direkte, zufällige oder Folgeschäden, und lehnt jegliche Haftung im gesetzlich zulässigen Umfang ab. Der Benutzer ist selbst dafür verantwortlich, schwerwiegende Anwendungsrisiken zu erkennen und erforderliche Maßnahmen durchzuführen, um die Prozesse im Fall von möglichen Gerätefehlern zu schützen.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig und vollständig durch, bevor Sie das Gerät auspacken, aufstellen und in Betrieb nehmen. Beachten Sie alle Gefahren- und Warnhinweise. Nichtbeachtung kann zu schweren Verletzungen des Bedieners oder Schäden am Gerät führen.

Wenn das Gerät in einer Weise verwendet wird, die nicht vom Hersteller vorgeschrieben ist, kann der Schutz, den das Gerät bietet, beeinträchtigt werden. Bauen Sie das Gerät nicht anders ein, als in der Bedienungsanleitung angegeben.

#### 4.1.1 Bedeutung von Gefahrenhinweisen

##### ▲ GEFÄHR

Kennzeichnet eine mögliche oder drohende Gefahrensituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt.

##### ▲ WARNUNG

Kennzeichnet eine mögliche oder drohende Gefahrensituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.

##### ▲ VORSICHT



Kennzeichnet eine mögliche Gefahrensituation, die zu leichteren Verletzungen führen kann.





##### ACHTUNG

Kennzeichnet eine Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, das Gerät beschädigen kann. Informationen, die besonders beachtet werden müssen.


#### 4.1.2 Warnhinweise

Lesen Sie alle am Gerät angebrachten Aufkleber und Hinweise. Nichtbeachtung kann Verletzungen oder Beschädigungen des Geräts zur Folge haben. Im Handbuch wird in Form von Warnhinweisen auf die am Gerät angebrachten Symbole verwiesen.

	Dies ist das Sicherheits-Warnsymbol. Befolgen Sie alle Sicherheitshinweise im Zusammenhang mit diesem Symbol, um Verletzungen zu vermeiden. Wenn es am Gerät angebracht ist, beachten Sie die Betriebs- oder Sicherheitsinformationen im Handbuch.
	Dieses Symbol weist auf Gefahren durch Chemikalien hin. Nur Personen, die im Umgang mit Chemikalien geschult und entsprechend qualifiziert sind, dürfen mit Chemikalien arbeiten oder Wartungsarbeiten an den chemischen Versorgungssystemen des Gerätes vornehmen.

	Dieses Symbol weist auf die Gefahr eines elektrischen Schlages hin, der tödlich sein kann.
	Dieses Symbol zeigt das Vorhandensein von Geräten an, die empfindlich auf elektrostatische Entladung reagieren. Es müssen Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, um die Geräte nicht zu beschädigen.
	Dieses Symbol weist darauf hin, dass das gekennzeichnete Teil an einen Erdungsschutzleiter angeschlossen werden muss. Wenn das Instrument nicht über einen Netzstecker an einem Kabel verfügt, verbinden Sie die Schutz Erde mit der Schutzleiterklemme.
	Elektrogeräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im normalen öffentlichen Abfallsystem entsorgt werden. Senden Sie Altgeräte an den Hersteller zurück. Dieser entsorgt die Geräte ohne Kosten für den Benutzer.

### 4.1.3 Chemische und biologische Sicherheit

⚠ GEF AHR	
	Chemische oder biologische Risiken. Wird das Gerät dazu verwendet, ein Verfahren und/oder eine chemische Zuleitung zu überwachen, für das vorgeschriebene Grenzwerte und Überwachungsvorschriften im Bereich der öffentlichen Sicherheit, der Gesundheit oder im Bereich der Lebensmittel- oder Getränkeherstellung bestimmt wurden, so unterliegt es der Verantwortung des Benutzers des Geräts, alle solche Bestimmungen zu kennen und diese einzuhalten und für ausreichende und entsprechende Vorsorgemaßnahmen zur Einhaltung der für den Fall einer Fehlfunktion des Geräts bestehenden Bestimmung zu sorgen.

## 4.2 In Abbildungen verwendete Zeichen

			
Vom Hersteller bereitgestellte Teile	Vom Benutzer bereitgestellte Teile	Anschauen	Schritte in umgekehrter Reihenfolge ausführen

				
Zwei Personen notwendig	Hören	Nur Finger verwenden	Kein Werkzeug verwenden	Nicht berühren

## 4.3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Hach Analysatoren der EZ-Serie sind für den Gebrauch durch Personen vorgesehen, die laufend Wasserqualitätsparameter in Proben aus Industrie- und Umwelthanwendungen messen. Die Hach Analysatoren der EZ-Serie behandeln oder verändern Wasser nicht und werden nicht zur Kontrolle von Verfahren verwendet.

## 4.4 Produktkomponenten

Stellen Sie sicher, dass Sie alle Teile erhalten haben. Siehe [Abbildung 4](#) auf Seite 449. Wenn Komponenten fehlen oder beschädigt sind, kontaktieren Sie bitte umgehend den Hersteller oder Verkäufer.

# Kapitel 5 Installation

## ⚠ GEFÄHR



Mehrere Gefahren. Nur qualifiziertes Personal sollte die in diesem Kapitel des Dokuments beschriebenen Aufgaben durchführen.

## 5.1 Installationsanleitungen

### ⚠ WARNUNG



Brandgefahr. Der Benutzer ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass die erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden, wenn das Gerät in einem Verfahren genutzt wird, bei dem brennbare Flüssigkeiten verwendet werden. Stellen Sie sicher, dass Sie die korrekten Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsprotokolle verwenden. Diese umfassen unter anderem die Kontrolle von ausgelaufenen Flüssigkeiten, korrekte Belüftung, Verwendung nur im Beisein des Bedieners sowie ständige Beaufsichtigung des Geräts, während es mit Strom versorgt wird.

### ⚠ VORSICHT



Gefahr durch Kontakt mit Chemikalien. Halten Sie sich an die Sicherheitsmaßnahmen im Labor, und tragen Sie Schutzkleidung entsprechend den Chemikalien, mit denen Sie arbeiten. Beachten Sie die Sicherheitsprotokolle in den aktuellen Material Sicherheitsdatenblättern (MSDS/SDB).

### ⚠ VORSICHT



Gefahr durch Kontakt mit Chemikalien. Entsorgen Sie Chemikalien und Abfälle gemäß lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften.

- Installieren Sie den Analysator in geschlossenen Räumen in einer ungefährlichen Umgebung.
- Installieren Sie den Analysator in einer Umgebung, die vor korrosiven Flüssigkeiten geschützt ist.
- Installieren Sie den Analysator an einen sauberen, trockenen, gut belüfteten und temperaturgeregelten Ort.
- Installieren Sie den Analysator so nahe wie möglich an der Entnahmestelle.
- Installieren Sie den Analysator nicht in direktem Sonnenlicht oder in der Nähe einer Wärmequelle.
- Achten Sie darauf, dass am Installationsort ausreichend Spielraum vorhanden ist, um die Leitungen verlegen und die elektrischen Verbindungen anschließen zu können.
- Vergewissern Sie sich, dass vor dem Analysator ausreichend Platz zum Öffnen der Analysatortür bleibt. Siehe [Maße des Analysators](#) auf Seite 26.
- Vergewissern Sie sich, dass die Umgebungsbedingungen den Betriebsspezifikationen entsprechen. Siehe [Spezifikationen](#) auf Seite 22.

Obwohl der Analysator nicht für die Verwendung mit entflammaren Proben entwickelt wurde, verwenden einige EZ-Analysatoren entflammare Reagenzien. Weitere Informationen zu den im Analysesystem verwendeten Reagenzien finden Sie im Dokument „Method & Reagent Sheet“ (Verfahren und Reagenzieninformationen) für das jeweilige EZ-Modell. Wenn der Analysator entflammare Reagenzien verwendet, beachten Sie die folgenden Sicherheitsvorschriften:

- Halten Sie den Analysator von Hitze, Funken und offenem Feuer fern.
- Essen, trinken oder rauchen Sie nicht in der Nähe des Analysators.
- Verwenden Sie ein lokales Entlüftungssystem.
- Verwenden Sie funken- und explosionsgeschützte Geräte und Beleuchtungssysteme.
- Verhindern Sie elektrostatische Entladungen. Siehe [Hinweise zur Vermeidung elektrostatischer Entladungen \(ESD\)](#) auf Seite 26.
- Reinigen und trocknen Sie das Gerät vor der Verwendung vollständig.
- Waschen Sie vor Pausen und nach Beenden der Arbeit Ihre Hände.
- Legen Sie kontaminierte Kleidung ab. Waschen Sie die Kleidung vor dem erneuten Tragen.

- Diese Flüssigkeiten müssen im Einklang mit den Anforderungen der lokalen Aufsichtsbehörden im Hinblick auf die Belastungsgrenzwerte behandelt werden.

## 5.2 Maße des Analysators

Informationen zu den Maßen des Analysators finden Sie in [Abbildung 5](#) auf Seite 454.

## 5.3 Mechanische Montage

### 5.3.1 Anbringen des Geräts an der Wand

#### ⚠ WARNUNG



Verletzungsgefahr. Vergewissern Sie sich, dass die Wandbefestigung das vierfache Gewicht der Ausrüstung tragen kann.

#### ⚠ WARNUNG



Verletzungsgefahr. Geräte oder Komponenten sind schwer. Bewegen oder installieren Sie diese nicht allein.

#### ⚠ WARNUNG



Verletzungsgefahr. Das Gerät ist schwer. Stellen Sie sicher, dass das Gerät fest an einer Wand, auf einem Tisch oder auf dem Boden montiert ist, um eine sichere Bedienung zu gewährleisten.

Verwenden Sie die mitgelieferten Montagehalterungen, um das Gerät aufrecht und waagrecht auf einer ebenen, senkrechten Wand zu befestigen. Siehe [Abbildung 6](#) auf Seite 456.

Installieren Sie das Gerät an einem Ort und in einer Position, an dem der Benutzer das Gerät leicht von der Stromquelle trennen kann.

Stellen Sie sicher, dass unter dem Analysator ausreichend Platz für das Anschließen der Flaschen vorhanden ist.

Das Befestigungsmaterial ist vom Benutzer zu stellen. Stellen Sie sicher, dass die Befestigung zur Wandmontage ausreichend Gewicht tragen kann (circa 160 kg). Das Befestigungsmaterial muss für die Eigenschaften der Wand zugelassen sein.

### 5.3.2 Öffnen Sie die Analysatortür

Verwenden Sie den mitgelieferten Schlüssel, um die zwei Verriegelungen an der Seite des Analysators zu entriegeln. Siehe [Abbildung 7](#) auf Seite 456. Stellen Sie sicher, dass die Tür vor dem Betrieb geschlossen wird, um die Umgebungsbedingungen und die Sicherheitsspezifikation im Gerät zu erhalten.

## 5.4 Elektrische Installation

### ⚠ GEFAHR



Lebensgefahr durch Stromschlag. Trennen Sie das Gerät immer von der Spannungsversorgung, bevor Sie elektrische Anschlüsse herstellen.

### 5.4.1 Hinweise zur Vermeidung elektrostatischer Entladungen (ESD)

#### ⚠ ACHTUNG



Möglicher Geräteschaden. Empfindliche interne elektronische Bauteile können durch statische Elektrizität beschädigt werden, wobei dann das Gerät mit verminderter Leistung funktioniert oder schließlich ganz ausfällt.

Befolgen Sie die Schritte in dieser Anleitung, um ESD-Schäden am Gerät zu vermeiden.

- Berühren Sie eine geerdete Metallfläche, wie beispielsweise des Gehäuses eines Geräts, einen Metallleiter oder ein Rohr, um statische Elektrizität vom Körper abzuleiten.
- Vermeiden Sie übermäßige Bewegung. Verwenden Sie zum Transport von Komponenten, die gegen statische Aufladungen empfindlich sind, Antistatikfolie oder antistatische Behälter.
- Tragen Sie ein Armband, das mit einem geerdeten Leiter verbunden ist.
- Arbeiten Sie in einem elektrostatisch sicheren Bereich mit antistatischen Fußbodenbelägen und Arbeitsunterlagen

### 5.4.2 Zuführung der Elektroleitungen

Führen Sie die Kabel der externen Geräte durch die Kabelverschraubungen. Siehe [Abbildung 8](#) auf Seite 457. Belassen Sie die Stopfen in den nicht genutzten Kabelverschraubungen.

[Abbildung 9](#) auf Seite 460 zeigt die Komponenten im Analysator. Als Netzschalter ist ein Leitungsschutzschalter installiert. Bei Auftreten eines Überstroms (z.B. bei Kurzschluss) oder einer Überspannung trennt dieser Schutzschalter den Analysator automatisch vom Wechselstromnetz.

### 5.4.3 Anschließen externer Geräte

Schließen Sie die externen Geräte, die mit dem Analysator verwendet werden, an die Signal- und Regelungsklemmen im Analysator an. Siehe [Abbildung 10](#) auf Seite 463 und [Tabelle 1](#) auf Seite 27.

**Tabelle 1 Signal- und Regelungsklemmen – Beschreibungen**

Pin	Beschreibung
AO1–AO8 (P101)	Acht Analogausgänge zur Steuerung externer Geräte. Weitere Informationen finden Sie online in der erweiterten Version des Benutzerhandbuchs.
FCT1 - FCT5 (P102)	Fünf Relais (potentialfreie Kontakte). Die maximale Ladung beträgt 24 VDC, 0,5 A. <ul style="list-style-type: none"> <li>• FCT1 – Funktionsstörungsalarm</li> <li>• FCT2 – Wartungsalarm</li> <li>• FCT3 – Analysator bereit</li> <li>• FCT4 und FCT5 – für die zukünftige Verwendung</li> </ul>
DI1–DI7 (P103)	Sieben Digitaleingänge zur Fernsteuerung des Analysators. <sup>5</sup> Schließen Sie die Digitaleingänge an einen externen potentialfreien Kontakt (24 VDC) an, damit der Analysator eine Messung für einen Kanal startet. <ul style="list-style-type: none"> <li>• DI1 – Fernstart für Kanal 1</li> <li>• DI2 – Fernstart für Kanal 2</li> <li>• DI3 bis DI7 – für die zukünftige Verwendung</li> </ul>
FB1–FB4 (P104)	Profibus DP oder Modbus RTU (RS485) Steckverbinder <b>Profibus DP:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FB1 – A1 (Eingang)</li> <li>• FB2 – A2 (Ausgang)</li> <li>• FB3 – B1 (Eingang)</li> <li>• FB4 – B2 (Ausgang)</li> <li>• SHL – Abschirmung</li> </ul> <b>Modbus RTU:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FB1 – D (+)</li> <li>• FB2 – D (-)</li> <li>• FB3 – nicht verwendet</li> <li>• FB4 – nicht verwendet</li> <li>• SHL – Abschirmung</li> </ul> Anweisungen zur Modbus-Konfiguration und Telegramm-Tags finden Sie in der Dokumentation zum SC4500 Controller.

<sup>5</sup> Wenn sich der Analysator im Wartungsmodus befindet, ist die Fernsteuerung deaktiviert.

**Tabelle 1 Signal- und Regelungsklemmen – Beschreibungen (fortgesetzt)**

Pin	Beschreibung
24 VDC / 1 A (P105)	24 V Gleichstromversorgung für EZ9010 und EZ9020 Filtrationsmodule
STR1–STR8 (P106)	Acht Digitalausgänge für das optionale Mod duplex Modul. Schließen Sie die blanken Kabel der einzelnen Kanalventile am Mod duplex Modul an die entsprechenden STR-Anschlüsse an. <ul style="list-style-type: none"> <li>• STR1 – Kanal 1</li> <li>• STR2 – Kanal 2</li> <li>• ...</li> <li>• STR8 – Kanal 8</li> </ul>
EXT9–EXT12 (P107)	Vier Digitalausgänge für das optionale EZ9150 Filtrationsmod ul. Schließen Sie die elektrischen Ventile und die Pumpe über die EXT-Anschlüsse an das EZ9150 Filtrationsmod ul an. <ul style="list-style-type: none"> <li>• EXT9 – Spülventil</li> <li>• EXT10 – Rückspülventil</li> <li>• EXT11 – Abflussüberlaufventil</li> <li>• EXT12 – Filtrationspumpe</li> </ul>
D01–D06 (P108 und P109)	Sechs Pneumatikventilausgänge für das EZ9150 Mod ul <ul style="list-style-type: none"> <li>• D01 – Probenzulaufventil</li> <li>• D02 – Abflussüberlaufventil</li> <li>• D03 – Ventil Kanal 1</li> <li>• D04 – Ventil Kanal 2</li> <li>• D05 – Ventil Kanal 3</li> <li>• D06 – Ventil Kanal 4</li> </ul>

#### 5.4.4 Anschluss an die Netzstromversorgung


<b>⚠ GEFAHR</b>	
	Elektrische Gefahren und Brandgefahr. Stellen Sie sicher, dass das mitgelieferte Kabel und der nichtverriegelnde Stecker den Vorschriften des jeweiligen Landes entsprechen.

- Stellen Sie sicher, dass in der Netzzuleitung ein Leistungsschalter mit ausreichender Kapazität installiert ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Leistungsschalter oder ein Notschalter in der Nähe des Analysators installiert ist, damit der Analysator bei Bedarf sofort von der Stromversorgung getrennt werden kann.
- Beachten Sie beim Anschließen des Geräts alle geltenden elektrotechnischen Vorschriften.
- Montieren Sie das mitgelieferte Netzkabel durch die Kabelverschraubung an der Seite des Analysators.
- Ziehen Sie die Kabelverschraubung fest, um das Netzkabel zu sichern und um die Umgebungsbedingungen des Gehäuses zu wahren.

Schließen Sie den Analysator mit dem mitgelieferten Netzkabel an die Netzstromversorgung an. Siehe **Tabelle 2** auf Seite 29 und **Abbildung 11** auf Seite 468.

<b>ACHTUNG</b>			
Schalten Sie den Netzschalter nicht ein. Schließen Sie erst alle Elektro- und Schlauchleitungen an, bevor Sie den Analysator in Betrieb nehmen. Bei Nichteinhaltung kann der Analysator beschädigt werden.			


**Tabelle 2 Verdrahtungsinformationen – Netzstromversorgung**

Anschlussklemme	Beschreibung	Kabelfarbe-Nordamerika und Kanada	Kabelfarbe-EU
L	Phase/Außenleiter (L)	Schwarz (1)	Braun
N	Neutralleiter (N)	Weiß (2)	Blau
	Schutzleiter (PE)	Grün mit gelbem Streifen	Grün mit gelbem Streifen

DE

## 5.5 Montage der Schläuche

### 5.5.1 Richtlinien für die Probenahme


<b>⚠ VORSICHT</b>	
	Brandgefahr. Dieses Produkt ist nicht für den Gebrauch mit entzündbaren Proben geeignet.


Für das bestmögliche Betriebsverhalten des Geräts wählen Sie einen geeigneten, repräsentativen Probenahmepunkt. Die Probe muss für das gesamte System repräsentativ sein.

- Stellen Sie sicher, dass der Probendurchfluss höher ist als der Fluss zum Analysator.
- Wenn der Analysator die Probe mithilfe einer Peristaltikpumpe in das Analysegefäß befördert, stellen Sie sicher, dass die Probenleitung unter Barometerdruck steht.
- Stellen Sie sicher, dass die Probenleitung Proben aus einem kleinen Überlaufgefäß in der Nähe des Analysators erfasst.
- Verwenden Sie die mitgelieferte Probenleitung. Die Länge der Probenleitung darf nicht verändert werden.

Das Probenmaterial im Überlaufgefäß muss ständig durch frisches Material ausgetauscht werden. Wenn die Feststoffteilchen in der Probe zu groß sind, wird zudem eine Filtration des Probenmaterials empfohlen.

### 5.5.2 Richtlinien zur Abflussleitung

<b>⚠ WARNUNG</b>	
	Brandgefahr. Der Benutzer ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass die erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden, wenn das Gerät in einem Verfahren genutzt wird, bei dem brennbare Flüssigkeiten verwendet werden. Stellen Sie sicher, dass Sie die korrekten Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsprotokolle verwenden. Diese umfassen unter anderem die Kontrolle von ausgelaufenen Flüssigkeiten, korrekte Belüftung, Verwendung nur im Beisein des Bedieners sowie ständige Beaufsichtigung des Geräts, während es mit Strom versorgt wird.

<b>⚠ VORSICHT</b>	
	Gefahr durch Kontakt mit Chemikalien. Entsorgen Sie Chemikalien und Abfälle gemäß lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften.

## ACHTUNG

Schließen Sie Abflussleitungen nicht an andere Leitungen an. Andernfalls kann ein Gegendruck erzeugt und der Analysator beschädigt werden. Stellen Sie sicher, dass die Abflussleitung im Freien endet.

## ACHTUNG

Zur Vermeidung eines Gegendrucks und von Beschädigungen am Analysator stellen Sie sicher, dass der Analysator höher als der genutzte Abwasserabfluss des Standorts steht und die Abflussleitung ein konstantes Gefälle aufweist. Montieren Sie die Abflussleitungen so, dass sie über eine Leitungslänge von 0,3 m ein Gefälle von mindestens 2,54 cm aufweisen.

DE

Über die Abflussleitung lässt der Analysator nach Beendigung der Analyse die Probe und die Reagenzien ab. Die korrekte Installation der Abflussleitungen ist von grundlegender Bedeutung. Nur so wird sichergestellt, dass die Flüssigkeiten vollständig aus dem Gerät abgelassen werden. Bei unsachgemäßer Installation können Flüssigkeiten zurück in das Gerät gelangen und Schäden verursachen. Für die Abflussleitung ist ein Bodeneinlauf oder Beckenabfluss ausreichend. Der empfohlene Außendurchmesser für die Abflussleitung beträgt 32 mm. Siehe [Abbildung 12](#) auf Seite 470.

- Halten Sie die Abflussleitungen so kurz wie möglich.
- Stellen Sie sicher, dass der Abfluss tiefer als der Analysator liegt.
- Stellen Sie sicher, dass Abflussleitungen ein konstantes Gefälle aufweisen.
- Stellen Sie sicher, dass Abflussleitungen keine scharfen Biegungen vollziehen und nicht abgeklemt werden.
- Stellen Sie sicher, dass Abflussleitungen im Freien enden und dass sich in den Abflussleitungen kein Druck aufbauen kann.
- Stellen Sie sicher, dass Abflussleitungen im Aufstellungsraum geschlossen sind.
- Abflussleitungen dürfen nicht blockiert oder in Wasser getaucht sein.

Außerdem wird empfohlen, in der Nähe des Analysators einen Wasseranschluss zu installieren. Dadurch können das Abflussbecken und die Abflussschläuche regelmäßig mit sauberem Wasser gespült werden, um Verstopfungen durch Kristallisierung zu vermeiden.

Weitere Informationen zu den im Analysesystem verwendeten Reagenzien finden Sie im Dokument „Method & Reagent Sheet“ (Verfahren und Reagenzieninformationen) für das jeweilige EZ-Modell. Wenn der Analysator entflammare Reagenzien verwendet, beachten Sie die folgenden Sicherheitsvorschriften:

- Schließen Sie die Ablaufleitung nicht an einen Bodenablauf an.
- Entsorgen Sie die Flüssigkeit entsprechend der geltenden staatlichen, bundesstaatlichen oder lokalen Vorschriften.

### 5.5.3 Richtlinien für die Entlüftungsleitung

#### ⚠️ WARNUNG



Brandgefahr. Der Benutzer ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass die erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden, wenn das Gerät in einem Verfahren genutzt wird, bei dem brennbare Flüssigkeiten verwendet werden. Stellen Sie sicher, dass Sie die korrekten Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsprotokolle verwenden. Diese umfassen unter anderem die Kontrolle von ausgelaufenen Flüssigkeiten, korrekte Belüftung, Verwendung nur im Beisein des Bedieners sowie ständige Beaufsichtigung des Geräts, während es mit Strom versorgt wird.

#### ⚠️ VORSICHT



Gefahr durch Kontakt mit Chemikalien. Entsorgen Sie Chemikalien und Abfälle gemäß lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften.

## ACHTUNG

Schließen Sie die Entlüftungsleitung (Gasauslassanschluss) nicht an andere Leitungen an. Andernfalls kann ein Gegendruck erzeugt und der Analysator beschädigt werden. Stellen Sie sicher, dass die Entlüftungsleitung im Freien am Gebäudeäußeren endet.

## ACHTUNG

Zur Vermeidung eines Gegendrucks und von Beschädigungen am Analysator stellen Sie sicher, dass der Analysator höher als die genutzte(n) Entlüftung(en) des Standorts steht und die Entlüftungsleitung ein konstantes Gefälle aufweist. Montieren Sie die Entlüftungsleitung so, dass sie über eine Leitungslänge von 0,3 m ein Gefälle von mindestens 2,54 cm aufweisen.

Der Analysator verwendet die Entlüftungsleitung, um das Analysegefäß auf dem atmosphärischen Druck zu halten. Die korrekte Installation der Entlüftungsleitung ist wichtig, um sicherzustellen, dass während des Pumpenbetriebs keine Flüssigkeit aus der Entlüftungsleitung in das Analysegefäß gelangt. Bei unsachgemäßer Installation kann Gas zurück in den Analysator gelangen und Schäden verursachen. Der empfohlene Außendurchmesser für das Abgasrohr der Entlüftungsleitung beträgt 32 mm. Siehe [Abbildung 12](#) auf Seite 470.

- Halten Sie die Entlüftungsleitung so kurz wie möglich.
- Stellen Sie sicher, dass die Entlüftungsleitung ein konstantes Gefälle nach unten aufweist.
- Stellen Sie sicher, dass die Entlüftungsleitung keine scharfen Biegungen aufweist und nicht abgeklemt wird.
- Stellen Sie sicher, dass die Entlüftungsleitung im Aufstellungsraum geschlossen ist und dass kein Druck vorherrscht.
- Stellen Sie sicher, dass die Entlüftungsleitung immer höher als der Abfluss liegt.
- Die Entlüftungsleitung darf nicht blockiert oder in Wasser getaucht sein.

Wenn der Analysator entflammbare Reagenzien verwendet, beachten Sie die folgenden Sicherheitsvorschriften:

- Schließen Sie die Entlüftungsleitung nicht an einen Bodenablauf an.
- Entsorgen Sie die Flüssigkeit entsprechend der geltenden staatlichen, bundesstaatlichen oder lokalen Vorschriften.

### 5.5.4 Anschließen des Analysators für den Komponententest



#### ▲ VORSICHT



Brandgefahr. Dieses Produkt ist nicht für den Gebrauch mit entzündbaren Flüssigkeiten geeignet.

Bevor der Analysator mit allen Reagenzien in Betrieb genommen wird, muss ein Komponententest mit deionisiertem Wasser durchgeführt werden. Beachten Sie dabei die dargestellten Schritte sowie [Durchführen der Komponententests](#) auf Seite 35.

1. Montieren Sie die vier Quetschventilschläuche wie in dem im Folgenden beschriebenen Schritt 1 dargestellt.
  - a. Drücken Sie den schwarzen Knopf und drücken Sie dann die Schläuche in das Ventil.
  - b. Lassen Sie den Knopf los, wenn der Schlauch korrekt montiert ist.
2. Stellen Sie sicher, dass der Ablaufschlauch ordnungsgemäß im Probengefäß installiert ist. Berücksichtigen Sie dabei den folgenden bebilderten Schritt 2.
3. Stellen Sie sicher, dass der Aufschlussgefäßschlauch ordnungsgemäß im Aufschlussgefäß installiert ist. Berücksichtigen Sie dabei den folgenden bebilderten Schritt 3.
4. Schließen Sie zur Durchführung eines Komponententests alle Flüssigkeitsschläuche des Analysators an eine große Flasche entionisiertes Wasser an. Berücksichtigen Sie dabei den folgenden bebilderten Schritt 3. Die Schläuche sind werkseitig vorinstalliert.

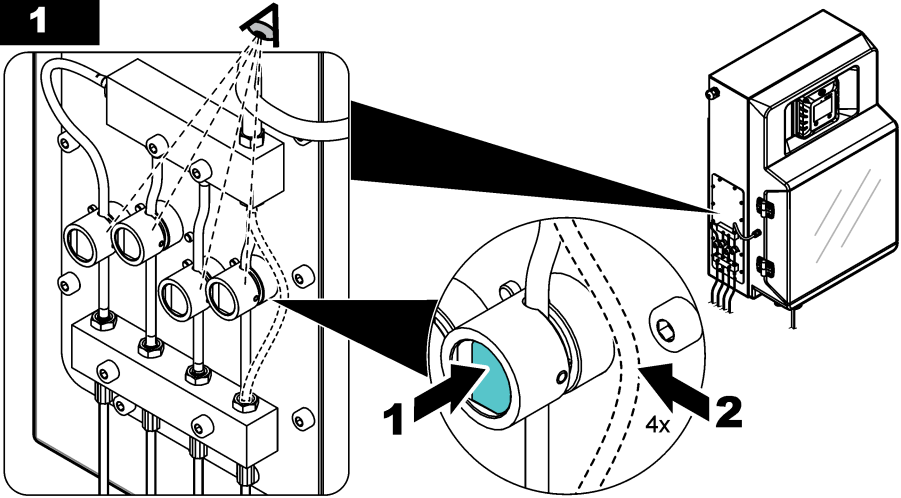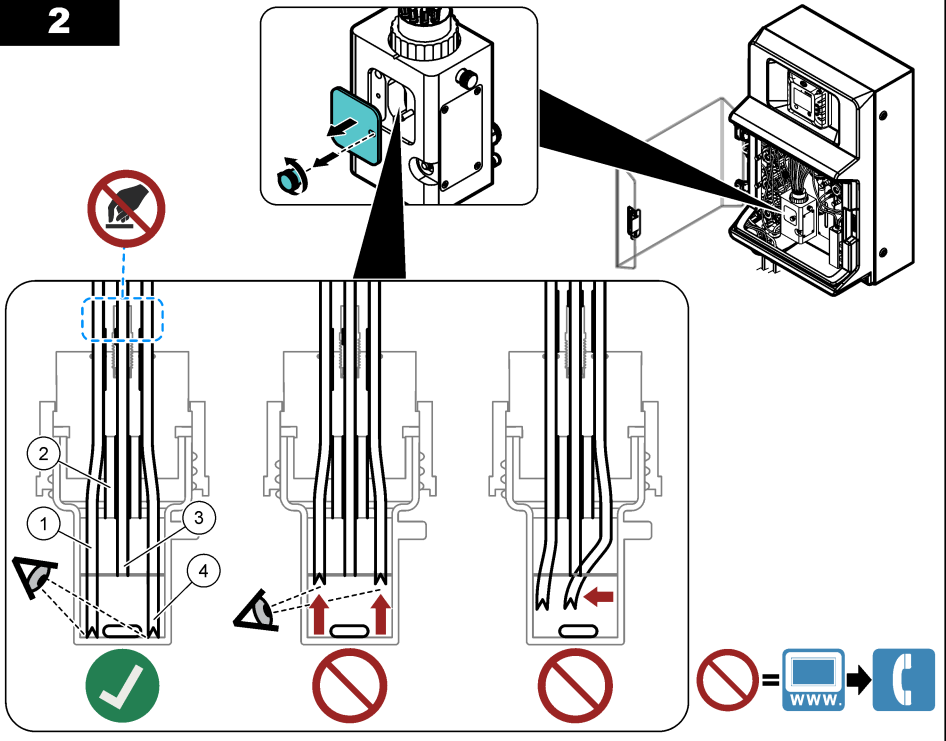**1****2**


1 Ablaufschlauch

3 Probenschlauch

2 Schläuche für Reagenzien und Entlüftung (obere Schläuche)

4 Aufschlussgefäßschlauch

3

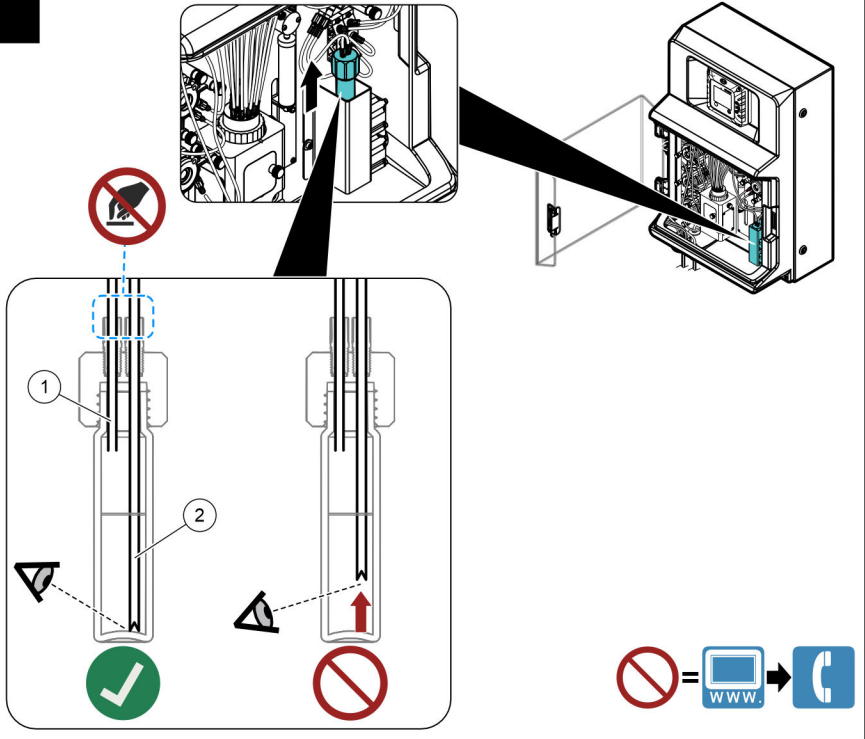


1 Entlüftungsschlauch

2 Anschlussgefäßschlauch

DE

4

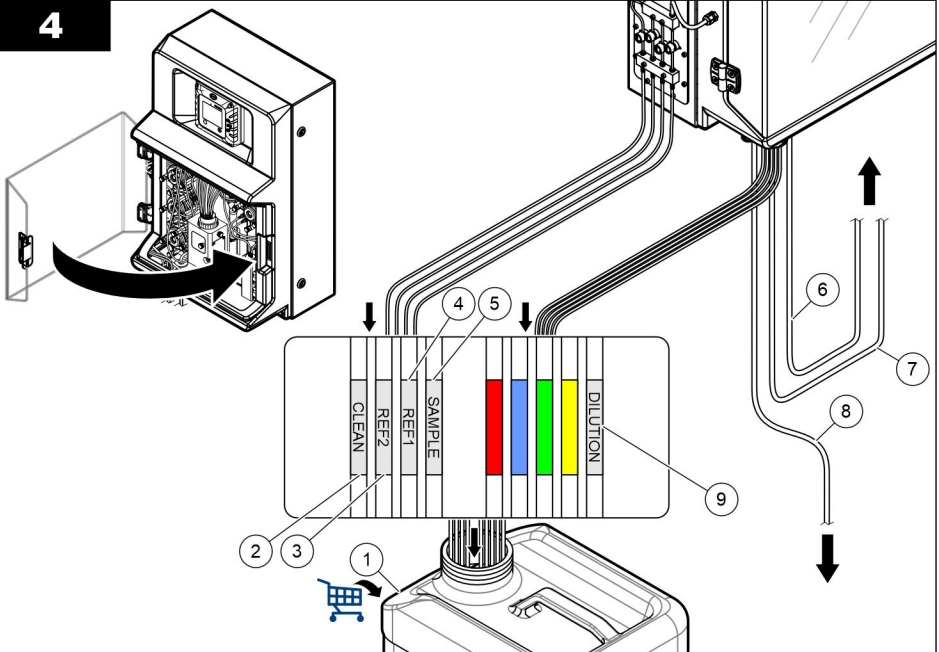

1 Entionisiertes Wasser	4 Schlauch für Referenzlösung 1 (REF1)	7 Entlüftung Aufschlussgefäß
2 Schlauch für Reinigungslösung	5 Probenzulaufschlauch	8 Ablaufschlauch
3 Schlauch für Referenzlösung 2 (REF2)	6 Entlüftungsschlauch	9 Mikropumpenschläuche für Verdünnung und Reagenz

## Kapitel 6 Inbetriebnahme

### 6.1 Erste Inbetriebnahme

**Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass die Montage, das Verlegen der Schläuche und die elektrischen Installationen vor dem Start vollständig abgeschlossen sind. Siehe [Installation](#) auf Seite 25.

Wenn der Analysator zum ersten Mal eingeschaltet wird, führt ein Startassistent durch die ersten Schritte der Einrichtung. Führen Sie alle nachfolgenden Schritte aus, um sicherzustellen, dass der Analysator ordnungsgemäß funktioniert.

**Hinweis:** Vergewissern Sie sich, dass für den ausgewählten Messbereich die richtigen Reagenzien verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie online in der erweiterten Version des Benutzerhandbuchs.

1. Öffnen Sie die Analysatortür. Siehe [Öffnen Sie die Analysatortür](#) auf Seite 26.
2. Schalten Sie den Netzschalter auf die EIN Position. Siehe [Abbildung 9](#) auf Seite 460.
3. Schließen Sie die Analysatortür mit dem mitgelieferten Schlüssel.
4. Warten Sie, bis der Initialisierungsvorgang abgeschlossen ist.
5. Befolgen Sie zur Auswahl von Sprache, Zeitzone, Datum und Uhrzeit die Anweisungen auf dem Display.

Informationen zum Konfigurieren der weiteren Controller-Einstellungen finden Sie in der Dokumentation zum SC4500 Controller.

6. Tippen Sie auf das Display, um das Menü **EZ2700sc** anzuzeigen.
7. Wählen Sie **Gerätemenü**, um den Startassistenten zu starten.

Der Begrüßungsbildschirm wird angezeigt.

8. Führen Sie die auf dem Display angezeigten Schritte aus, um den richtigen Messbereich auszuwählen. Drücken Sie **OK**.
9. Wenn eine Filtrationseinheit installiert ist, wählen Sie **Ein**. Ist dies nicht der Fall, wählen Sie **Aus**.
10. Wählen Sie die Anzahl der Kanäle für den Analysator aus. Drücken Sie **OK**.
11. Wenn die auf der Übersichtsseite angezeigte Konfiguration korrekt ist, drücken Sie **OK**. Das Hauptmenü des **EZ2700sc** wird angezeigt.
12. Fahren Sie mit dem Komponententest fort. Siehe [Durchführen der Komponententests](#) auf Seite 35.

DE

## 6.2 Durchführen der Komponententests

### ⚠ WARNUNG



Klemmgefahr. Bewegliche Teile bergen Klemmgefahr und können Verletzungen verursachen. Berühren Sie keine beweglichen Teile.

Führen Sie die Komponententests vor Inbetriebnahme des Analysators durch. Verwenden Sie das Menü **Wartung**, um die verschiedenen Analysatorfunktionen zur Prüfung des korrekten Betriebs der Komponenten zu starten.

#### Anforderungen:

- Wenn sich der Analysator im Betriebsmodus befindet, wählen Sie **Wartung** > **Wartungsmodus starten**.
- Stellen Sie sicher, dass sich die Schläuche für Proben, Reagenzien und Lösungen in einem Behälter mit entionisiertem Wasser befinden. Siehe [Anschließen des Analysators für den Komponententest](#) auf Seite 31.

### 6.2.1 Überprüfen des Rührers

1. Entfernen Sie den Lichtschutz von der Photometereinheit. Siehe [Abbildung 13](#) auf Seite 472.
2. Stellen Sie sicher, dass der Rührer den Boden des Gefäßes erreicht.  
*Hinweis: Überprüfen Sie den Rührer während des Vorpumpvorgangs, um sicherzustellen, dass er sich korrekt dreht. Der Vorpumpvorgang wird in [Überprüfen der Pumpen und Quetschventile](#) auf Seite 35 gestartet.*
3. Montieren Sie den Lichtschutz am Photometer.

### 6.2.2 Überprüfen der Pumpen und Quetschventile

1. Überprüfen Sie die Funktion der Pumpen und Quetschventile, um sicherzustellen, dass keine Undichtigkeiten vorhanden sind.
2. Stellen Sie sicher, dass sich das Analysegefäß mit entionisiertem Wasser füllt. Siehe [Abbildung 14](#) auf Seite 473.
3. Stellen Sie sicher, dass entionisiertes Wasser aus den Ablaufschläuchen austritt.
4. Wählen Sie **Wartung** > **Vorpumpen starten** und pumpen Sie alle Flüssigkeiten separat vor.  
Wenn eine Undichtigkeit auftritt, überprüfen Sie alle Anschlüsse. Weitere Informationen finden Sie online in der erweiterten Version des Benutzerhandbuchs.
  - a. Wählen Sie **Prime reference 1 (Referenz 1 vorpumpen)** aus, und drücken Sie **OK**.
  - b. Wählen Sie **Prime reference 2 (Referenz 2 vorpumpen)** aus, und drücken Sie **OK**.
  - c. Wählen Sie **Prime cleaning solution (Reinigungslösung vorpumpen)** aus, und drücken Sie **OK**.
  - d. Wählen Sie **Prime rinsing (Spülen vorbereiten)** aus, und drücken Sie **OK**.
  - e. Wählen Sie **Prime dispenser (Dispenser vorbereiten)** aus, und drücken Sie **OK**.
  - f. Wählen Sie **Prime channel (Kanal vorbereiten)** > **Prime all channels (Alle Kanäle vorbereiten)** aus, und drücken Sie **OK**.

Jeder Vorpumpvorgang wird automatisch angehalten, wenn der Vorgang abgeschlossen ist.

### 6.2.3 Überprüfen der Mikropumpen

Überprüfen Sie die Mikropumpen auf Undichtigkeiten und Luftblasen.

1. Entfernen Sie den Lichtschutz vom Photometer.
2. Wählen Sie **Wartung > Vorpumpen starten > Alle Reagenzien vorpumpen** aus.
3. Stellen Sie sicher, dass durch jeden Mikropumpenschlauch (Reagenzschlauch) entionisiertes Wasser in die Mikropumpe gelangt. Und anschließend ununterbrochen ohne Luftblasen in das Analysegefäß. Siehe [Abbildung 15](#) auf Seite 475.
4. Wenn die Mikropumpen nicht ordnungsgemäß funktionieren (Blasen im Schlauch), drücken Sie mit der Spritze entionisiertes Wasser in den betroffenen Schlauch, damit die Blasen entfernt werden. Siehe [Abbildung 16](#) auf Seite 476.
5. Montieren Sie den Lichtschutz am Photometer.

### 6.2.4 Durchführen eines Photometertests

Stellen Sie sicher, dass die Außenseite des Analysegefäßes vor dem Photometertest sauber ist, damit der Test erfolgreich abgeschlossen werden kann. Weitere Informationen zum Reinigen der Komponenten des Analysators finden Sie online in der erweiterten Version des Benutzerhandbuchs.

1. Drücken Sie das Symbol für das Hauptmenü, und wählen Sie dann die Option **Geräte**.
2. Wählen Sie **EZ2700sc** aus.
3. Scrollen Sie zum unteren Bildschirmrand, und wählen Sie dann **Gerätemenü**.
4. Wählen Sie **Wartung > Photometertest** aus.
5. Drücken Sie **OK**, um die Messung zu beginnen.  
Nach Abschluss der Kalibrierung des Dunkelwerts wird das Ergebnis auf dem Display angezeigt.
6. Drücken Sie zum Fortfahren **OK**.
7. Stellen Sie sicher, dass der Schlauch „REF1“ an einen Behälter mit deionisiertem Wasser angeschlossen ist. Prüfen Sie, ob der Lichtschutz installiert ist. Siehe [Abbildung 18](#) auf Seite 478.
8. Drücken Sie **OK**.  
Warten Sie, bis das Analysegefäß gefüllt ist.
9. Stellen Sie mit einem Schraubendreher die Spannung des Sensorausgangs auf 9 V ein. Siehe [Abbildung 17](#) auf Seite 476.
10. Warten Sie, bis der Wert 9 V auf dem Bildschirm angezeigt wird. Drücken Sie dann **OK**.
11. Drücken Sie zum Fortfahren **OK**.

## 6.3 Ausführen eines Tests der Eingangssignale

Nehmen Sie einen Test der digitalen Eingänge vor, bevor der Analysator in Betrieb genommen wird.

**Anforderungen:** Schließen Sie die Digitaleingänge an einen externen potenzialfreien Kontakt (24 V Gleichspannung) an.

Testen Sie das digitale Eingangssignal und das analoge Ausgangssignal wie folgt:

1. Drücken Sie das Symbol für das Hauptmenü, und wählen Sie dann die Option **Devices (Geräte)** aus.
2. Wählen Sie **EZ2700sc** aus.
3. Scrollen Sie zum unteren Bildschirmrand, und wählen Sie dann **Gerätemenü**.
4. Wählen Sie **Diagnose > Signale**.  
Die Signale an den Digitaleingängen werden angezeigt.
5. Vergleichen Sie den Status der Digitaleingänge auf dem Display mit den Spannungen, die an den Digitaleingängen anliegen (24 V = Ein; 0 V = Aus).

## 6.4 Ausführen eines Tests der Ausgangssignale

Nehmen Sie einen Test der digitalen Ausgänge vor, bevor der Analysator in Betrieb genommen wird.

**Anforderungen:** Konfigurieren Sie die Analogausgänge (AO1 - AO8, P101), um die Messung des Kanals auszuwählen, die von jedem Analogausgang dargestellt wird. Weitere Informationen finden Sie online in der erweiterten Version des Benutzerhandbuchs.

Testen Sie das analoge Ausgangssignal wie folgt:

1. Drücken Sie das Hauptmenü-Symbol.
2. Wählen Sie **Outputs (Ausgänge) > mA outputs AOC (mA-Ausgänge AOC) > Test/Maintenance (Test/Wartung)** aus.

Option	Beschreibung
<b>Funktionstest</b>	Führt einen Test an den Ausgängen des ausgewählten Moduls durch.
<b>Ausgang-Status</b>	Zeigt den Status der Ausgänge des ausgewählten Moduls an.

3. Messen Sie mit einem Multimeter den mA-Wert an jedem Analogausgang.
4. Vergleichen Sie den an den Analogausgängen gemessenen mA-Wert mit den erwarteten mA-Werten.

## 6.5 Festlegen der Kanalreihenfolge


Wählen Sie die Reihenfolge, in der die Kanäle gemessen werden, die Anzahl der Messungen jedes Kanals und die Wartezeit vor der Messung eines Kanals. Geben Sie maximal 16 Positionen mit jeweils maximal 16 Zyklen ein.

1. Drücken Sie das Symbol für das Hauptmenü, und wählen Sie dann die Option **Geräte**.
2. Wählen Sie **EZ2700sc** aus.
3. Scrollen Sie zum unteren Bildschirmrand, und wählen Sie dann **Gerätemenü**.
4. Wenn sich der Analysator im Betriebsmodus befindet, wählen Sie **Wartung > Wartungsmodus starten**.  
Warten Sie, bis sich der Analysator im Wartungsmodus befindet.
5. Wählen Sie **Konfiguration > Einrichten der Kanalreihenfolge**.
6. Wählen Sie mit den Pfeilen der Seitenleiste eine Position aus (Zahl in der Sequenz), und drücken Sie dann **OK**, um diese Position zu konfigurieren.
7. Eine Option auswählen.

Option	Beschreibung
<b>Auswählen</b>	Wählt den entsprechenden Kanal oder die Wartezeit aus.
<b>Anzahl der Messungen</b>	Legt die Anzahl der Messungen für einen Kanal fest.
<b>Wartezeit</b>	Stellt die Wartezeit für den gewählten Kanal ein.

8. Drücken Sie auf **OK**, um die Änderungen zu speichern.

## 6.6 Anschließen der Lösungen und der Probe

<b>▲ VORSICHT</b>	
	Gefahr durch Kontakt mit Chemikalien. Halten Sie sich an die Sicherheitsmaßnahmen im Labor, und tragen Sie Schutzkleidung entsprechend den Chemikalien, mit denen Sie arbeiten. Beachten Sie die Sicherheitsprotokolle in den aktuellen Material Sicherheitsdatenblättern (MSDS/SDB).

## ⚠ VORSICHT



Gefahr durch Kontakt mit Chemikalien. Entsorgen Sie Chemikalien und Abfälle gemäß lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften.

## ⚠ VORSICHT



Brandgefahr. Dieses Produkt ist nicht für den Gebrauch mit entzündbaren Flüssigkeiten geeignet.

Die Reagenzbehälter sind im Lieferumfang des Analysators enthalten. Siehe [Abbildung 18](#) auf Seite 478. Die Behälter für die Lösungen von Referenz 1 und Referenz 2 sowie für entionisiertes Wasser werden vom Benutzer bereitgestellt. Weitere Behälter können vom Hersteller erworben werden.

Installieren Sie die Container

- so nah wie möglich am Analysesystem
- 1 Meter unter der Unterseite des Analysators

Informationen zum Einsetzen der Behälter finden Sie in [Abbildung 18](#) auf Seite 478.

Reagenzien und Lösungen werden vom Benutzer bereitgestellt. Verwenden Sie nur Reagenzien, die von einem zertifizierten Unternehmen geliefert werden, oder verwenden Sie herstellereigene Reagenzien. Alternativ können Reagenzien vom Benutzer vorbereitet werden. Befolgen Sie die Anweisungen im Dokument „Method & Reagent Sheet“ (Verfahren und Reagenzieninformationen) für das jeweilige Modell auf der Website des Herstellers.

Die Leitungen sind werkseitig installiert. Anhand der Schlauchbeschriftungen können Sie erkennen, an welchen Schlauch was anzuschließen ist. Informationen zu den richtigen Reagenzien, Lösungen und Standards finden Sie im Dokument „Method & Reagent Sheet“ (Verfahren und Reagenzieninformationen) für das jeweilige Modell auf der Website des Herstellers.

1. Installieren Sie nach Durchführung der Komponententests die Schläuche „CLEAN“ (Reinigungslösung), „REF1“ (Referenzlösung 1) und „REF2“ (Referenzlösung 2) an den entsprechenden Behältern. Siehe [Abbildung 18](#) auf Seite 478.
2. Setzen Sie jeden farbcodierten Reagenzienschlauch in den Reagenzbehälter mit der gleichen Etikettenfarbe ein.
3. Führen Sie die Probenquelle (oder den Probenabfluss des Mod duplex Moduls oder des Filtermoduls) in den Probenzulaufschlauch des Analysators ein. Siehe [Abbildung 18](#) auf Seite 478.
4. Drücken Sie das Symbol für das Hauptmenü, und wählen Sie dann die Option **Geräte**.
5. Wählen Sie **EZ2700sc** aus.
6. Scrollen Sie zum unteren Bildschirmrand, und wählen Sie dann **Gerätemenü**.
7. Wählen Sie **Wartung > Vorpumpen starten > Alle vorpumpen** aus.

## 6.7 Durchführen einer Validierung vor der ersten Inbetriebnahme

Führen Sie eine Validierung durch, um sicherzustellen, dass sich die Messwerte innerhalb des Toleranzbereichs befinden. Weitere Informationen finden Sie online in der erweiterten Version des Benutzerhandbuchs.

1. Drücken Sie das Symbol für das Hauptmenü, und wählen Sie dann die Option **Geräte**.
2. Wählen Sie **EZ2700sc** aus.
3. Scrollen Sie zum unteren Bildschirmrand, und wählen Sie dann **Gerätemenü**.
4. Um eine Validierung zu starten, wählen Sie **Kalibrierung > Validierung > Validierung starten**.

Die Validierung misst das deionisierte Wasser in Flasche Referenz 2.

5. Wählen Sie zum Anzeigen der Ergebnisse eine der folgenden Optionen aus:

- **Kalibrierung > Validierung > Validierungshistorie**
- **Diagnose > Verlaufsdaten > Validierung**

## 6.8 Starten des Analysators

So starten Sie den Analysator:

1. Drücken Sie das Symbol für das Hauptmenü, und wählen Sie dann die Option **Geräte**.
2. Wählen Sie **EZ2700sc** aus.
3. Scrollen Sie zum unteren Bildschirmrand, und wählen Sie dann **Gerätemenü**.
4. Wählen Sie **Wartung > Betriebsmodus starten** aus.

## Sommario

- |   |                                     |   |                                   |
|---|-------------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1 | Informazioni aggiuntive a pagina 40 | 4 | Informazioni generali a pagina 42 |
| 2 | Panoramica del prodotto a pagina 40 | 5 | Installazione a pagina 44         |
| 3 | Specifiche tecniche a pagina 41     | 6 | Avviamento a pagina 53            |

## Sezione 1 Informazioni aggiuntive

Il manuale di base per l'utente contiene informazioni sufficienti per la messa in funzione. Online è reperibile un manuale utente completo contenente ulteriori informazioni.

### ⚠ PERICOLO



Pericoli multipli! Ulteriori informazioni sono contenute nelle singole sezioni del manuale dell'utente completo, illustrate di seguito.

- Interfaccia utente e navigazione
- Funzionamento
- Manutenzione
- Risoluzione dei problemi
- Elenchi delle parti di ricambio

Scansionare i codici QR che seguono per accedere al manuale utente esteso.



Lingue europee



Lingue americane e asiatiche

## Sezione 2 Panoramica del prodotto

L'analizzatore Hach EZ2700sc è un analizzatore online che misura un parametro in campioni di acqua da applicazioni industriali e ambientali. Fare riferimento a [Figura 1](#) a pagina 438, [Figura 2](#) a pagina 442 e [Figura 3](#) a pagina 447.

L'analizzatore è un analizzatore colorimetrico online per l'analisi generica dell'acqua (ad esempio nitrato, fosfato, ). L'analizzatore dispone di opzioni per l'avvio a distanza, la convalida automatica, la calibrazione automatica, la pulizia automatica e Modbus.

Il campione entra nell'analizzatore attraverso il tubo. Le pompe, le valvole e le siringhe nell'analizzatore spostano il campione e i reagenti nella cella di misura sul pannello di analisi. Quando il processo di analisi nel contenitore è completato, l'analizzatore elimina il campione attraverso il tubo di scarico. I risultati delle analisi sono visualizzati sul display del Controller SC4500. Il controller SC4500 salva i dati dell'analizzatore (registro dati, registro eventi, registro impostazioni e registro assistenza). Utilizzare il controller SC4500 per azionare e configurare l'analizzatore.

Per aumentare il numero di flussi di campioni (canali) che l'analizzatore può misurare (2, 4 o 8), acquistare il pannello multiflusso Moduplex con l'analizzatore.

Per precondizionare il campione (filtrazione, sedimentazione), acquistare il pannello di filtrazione EZ9010, EZ9020, EZ9150, EZ9200 o EZ9250 con l'analizzatore.

## Sezione 3 Specifiche tecniche

Le specifiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso.

Specifiche	Dettagli
Dimensioni (L x A x P)	460 x 688 x 340 mm (18,1 x 27,1 x 13,4 pollici)
Alloggiamento	IP44; ABS, PMMA e acciaio rivestito
Display	IP66; display TFT a colori da 3,5" con touchpad capacitivo
Peso	40 kg (88 lb)
Requisiti di alimentazione	Da 100 a 240 V CA $\pm 10\%$ , 50/60 Hz
Consumo di energia	240 VA massimo
Altitudine	2000 m (6560 piedi) massimo
Categoria di sovratensione	II
Condizioni ambientali	Solo per uso in interni
Grado di inquinamento	2
Temperatura di esercizio	Da 10 a 30 °C (da 50 a 86 °F), dal 5 al 95% di umidità relativa, senza condensa, anticorrosione
Temperatura di stoccaggio	Da -20 a 60 °C (da -4 a 140 °F); 95% di umidità relativa massima, senza condensa
Ingressi campione	Uno
Pressione del campione	Dal serbatoio di troppo pieno esterno (aperto alla pressione atmosferica)
Portata campione	Da 100 a 300 mL/min
Temperatura campione	Da 10 a 30 °C (da 50 a 86 °F)
Qualità del campione	Particelle <100 $\mu\text{m}$ , <0,1 g/L massimo Torbidità < 50 NTU
Scarico dell'aria per ambienti corrosivi	0,2 bar (20 kPa o 3 psi); aria secca e pulita
Scarico	Pressione atmosferica, con sfiato, $\varnothing$ minimo 32 mm
Collegamento di messa a terra	Asta di messa a terra asciutta e pulita con bassa impedenza (< 1 $\Omega$ ) e filo di massa di > 2,5 mm <sup>2</sup> (13 AWG)
Uscite analogiche	Massimo otto uscite analogiche da 0-20 mA (o 4-20 mA) <b>Nota:</b> Le uscite analogiche alimentano l'alimentazione loop. Non è possibile fornire alimentazione ai contatti del sistema SCADA o PLC.
Ingressi digitali	Sette ingressi digitali Due ingressi digitali per l'avviamento a distanza. Gli ingressi digitali rimanenti sono destinati all'uso futuro.
Uscite digitali	Quattro uscite digitali eccitate per le valvole e le pompe del pannello EZ9150; otto uscite digitali eccitate per le valvole del pannello Moduplex; 24 V CC, 500 mA
Relè	Cinque contatti privi di potenziale (FCT), carico massimo 24 VCC, 0,5 A (carico resistivo)
Connessioni Ethernet	Connessione Ethernet Claros e connettore Ethernet Modbus TCP/IP; versione LAN; 10/100 Mbps, Profinet o Ethernet IP
Comunicazioni RS485	Profibus DP o Modbus RTU

<sup>2</sup> Per informazioni sulle configurazioni Ethernet e Modbus, fare riferimento alla documentazione del Controller SC4500.

Specifiche	Dettagli
Certificazioni	Certificazione CE, ETL in base agli standard di sicurezza UL e CSA, UKCA
Garanzia	1 anno (UE: 2 anni)

## Sezione 4 Informazioni generali

In nessun caso il produttore sarà responsabile per danni derivanti da un uso improprio del prodotto o dalla mancata osservanza delle istruzioni contenute nel manuale. Il produttore si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche al presente manuale e ai prodotti ivi descritti in qualsiasi momento senza alcuna notifica o obbligo preventivi. Le edizioni riviste sono presenti nel sito Web del produttore.

### 4.1 Informazioni sulla sicurezza

Il produttore non sarà ritenersi responsabile in caso di danni causati dall'applicazione errata o dall'uso errato di questo prodotto inclusi, a puro titolo esemplificativo e non limitativo, i danni diretti, incidentali e consequenziali; inoltre declina qualsiasi responsabilità per tali danni entro i limiti previsti dalle leggi vigenti. La responsabilità relativa all'identificazione dei rischi critici dell'applicazione e all'installazione di meccanismi appropriati per proteggere le attività in caso di eventuale malfunzionamento dell'apparecchiatura compete unicamente all'utilizzatore.

Prima di disimballare, installare o utilizzare l'apparecchio, si prega di leggere l'intero manuale. Si raccomanda di leggere con attenzione e rispettare le istruzioni riguardanti note di pericolosità. La non osservanza di tali indicazioni potrebbe comportare lesioni gravi all'operatore o danni all'apparecchio.

Se l'apparecchiatura viene utilizzata in modo diverso da quello specificato dal produttore, la protezione fornita dall'apparecchiatura può essere compromessa. Non utilizzare o installare l'apparecchiature con modalità differenti da quelle specificate nel presente manuale.

#### 4.1.1 Indicazioni e significato dei segnali di pericolo

##### ▲ PERICOLO

Indica una situazione di pericolo potenziale o imminente che, se non evitata, causa lesioni gravi anche mortali.

##### ▲ AVVERTENZA

Indica una situazione di pericolo potenziale o imminente che, se non evitata, potrebbe comportare lesioni gravi, anche mortali.

##### ▲ ATTENZIONE



Indica una situazione di pericolo potenziale che potrebbe comportare lesioni lievi o moderate.





##### AVVISO

Indica una situazione che, se non evitata, può danneggiare lo strumento. Informazioni che richiedono particolare attenzione da parte dell'utente.


#### 4.1.2 Etichette precauzionali

Leggere sempre tutte le indicazioni e le targhette di segnalazione applicate all'apparecchio. La mancata osservanza delle stesse può causare lesioni personali o danni allo strumento. Un simbolo sullo strumento è indicato nel manuale unitamente a una frase di avvertenza.









	Questo è il simbolo di allarme sicurezza. Seguire tutti i messaggi di sicurezza dopo questo simbolo per evitare potenziali lesioni. Se sullo strumento, fare riferimento al manuale delle istruzioni per il funzionamento e/o informazioni sulla sicurezza.
	Questo simbolo identifica un rischio di danno chimico e indica che solo individui qualificati e addestrati a lavorare con sostanze chimiche devono maneggiare sostanze chimiche o eseguire la manutenzione di sistemi di erogazione di sostanze chimiche associati all'apparecchiatura.

	Questo simbolo indica un rischio di scosse elettriche e/o elettrocuzione.
	Questo simbolo indica la presenza di dispositivi sensibili alle scariche elettrostatiche (ESD, Electrostatic Discharge) ed è pertanto necessario prestare la massima attenzione per non danneggiare l'apparecchiatura.
	Questo simbolo indica che l'elemento contrassegnato richiede una connessione a terra di protezione. Se lo strumento non dispone di spina di messa a terra, effettuare un collegamento di terra sul terminale del conduttore di protezione.
	Le apparecchiature elettriche contrassegnate con questo simbolo non possono essere smaltite attraverso sistemi domestici o pubblici europei. Restituire le vecchie apparecchiature al produttore il quale si occuperà gratuitamente del loro smaltimento.

### 4.1.3 Rischio chimico e biologico

<b>⚠ PERICOLO</b>	
	Rischi chimici o biologici. Se questo strumento viene utilizzato per monitorare un processo di trattamento e/o un sistema di alimentazione di sostanze chimiche per cui esistono limiti normativi e requisiti di controllo legati a sanità pubblica, sicurezza pubblica, attività di produzione o trasformazione di alimenti e bevande, l'utente dello strumento ha la responsabilità di conoscere e rispettare tutte le eventuali normative applicabili e di predisporre meccanismi adeguati e sufficienti ai fini del rispetto delle normative vigenti in caso di malfunzionamento dello strumento stesso.

### 4.2 Icone usate nelle illustrazioni

				
Parti fornite dal produttore	Parti fornite dall'utente	Osservare	Eseguire i passaggi in ordine inverso	
				
Impiegare due persone	Ascoltare	Utilizzare solo le dita	Non utilizzare strumenti	Non toccare

### 4.3 Uso previsto

Gli analizzatori della serie EZ di Hach sono destinati alla misurazione continua dei parametri di qualità dell'acqua in campioni da applicazioni industriali e ambientali. Gli analizzatori della serie EZ di Hach non trattano né alterano l'acqua e non vengono utilizzati per il controllo delle procedure.

### 4.4 Componenti del prodotto

Accertarsi che tutte le parti oggetto della fornitura siano state ricevute. [Figura 4](#) a pagina 451 In caso di parti mancanti o danneggiate, contattare immediatamente il produttore o il rappresentante vendite.

## Sezione 5 Installazione

### ⚠ PERICOLO



Pericoli multipli. Gli interventi descritti in questa sezione del documento devono essere eseguiti solo da personale qualificato.

### 5.1 Linee guida per l'installazione

#### ⚠ AVVERTENZA



Pericolo di incendio. È responsabilità dell'utente assicurarsi che siano state intraprese le misure di sicurezza necessarie per l'uso dell'apparecchiatura in combinazione con liquidi infiammabili. Attenersi scrupolosamente ai protocolli di sicurezza e alle precauzioni per l'utente corretti. Inclusi, ma non limitati a, controlli di perdite o fuoriuscite di liquidi, ventilazione corretta, verifica di utilizzo presidiato e che lo strumento non venga mai lasciato incustodito con l'alimentazione inserita.

#### ⚠ ATTENZIONE



Pericolo di esposizione ad agenti chimici. Rispettare le procedure di sicurezza del laboratorio e indossare tutte le apparecchiature protettive appropriate per le sostanze chimiche utilizzate. Fare riferimento alle attuali schede di sicurezza (MSDS/SDS) per i protocolli di sicurezza.

#### ⚠ ATTENZIONE



Pericolo di esposizione ad agenti chimici. Smaltire i prodotti chimici e i rifiuti conformemente alle normative locali, regionali e nazionali.

- Installare i componenti interni dell'analizzatore in un ambiente sicuro.
- Installare l'analizzatore in un ambiente protetto da fluidi corrosivi.
- Installare l'analizzatore in un ambiente pulito e asciutto, ben ventilato e a temperatura controllata.
- Installare l'analizzatore il più vicino possibile al punto di campionamento.
- Non installare l'analizzatore in punti soggetti ad illuminazione solare diretta o vicino a fonti di calore.
- Accertarsi che ci sia spazio sufficiente per allestire l'impianto idraulico e i collegamenti elettrici.
- Verificare che ci sia spazio sufficiente davanti all'analizzatore per l'apertura dello sportello. Fare riferimento a [Dimensioni dell'analizzatore](#) a pagina 45.
- Verificare che le condizioni dell'ambiente siano compatibili con le specifiche di funzionamento. Fare riferimento a [Specifiche tecniche](#) a pagina 41.

Sebbene l'analizzatore non sia progettato per l'utilizzo con campioni infiammabili, alcuni analizzatori EZ utilizzano reagenti infiammabili. Per ulteriori informazioni sui reagenti utilizzati nell'analizzatore, fare riferimento a Method & Reagent Sheet (Scheda Metodo e reagente) del modello della serie EZ applicabile. Se l'analizzatore utilizza reagenti infiammabili, attenersi alle precauzioni di sicurezza seguenti:


- Tenere l'analizzatore al riparo da calore, scintille e fiamme libere.
- Non mangiare, bere o fumare in prossimità dell'analizzatore.
- Utilizzare un sistema di ventilazione locale.
- Utilizzare apparecchi e un sistema di illuminazione antiscintilla e antideflagranti.
- Prevenire le scariche elettrostatiche. Fare riferimento a [Scariche elettrostatiche](#) a pagina 45.
- Pulire e asciugare completamente lo strumento prima dell'utilizzo.
- Lavarsi le mani prima delle pause e al termine del periodo di lavoro.
- Rimuovere gli indumenti contaminati. Lavare gli indumenti prima di riutilizzarli.
- Questi liquidi devono essere trattati in conformità ai requisiti degli enti regolatori locali sui limiti di esposizione consentiti.

## 5.2 Dimensioni dell'analizzatore


Fare riferimento alla [Figura 5](#) a pagina 454 per le dimensioni dell'analizzatore.

## 5.3 Installazione dei componenti meccanici

### 5.3.1 Fissaggio dello strumento a una parete

<b>⚠ AVVERTENZA</b>	
	Pericolo di lesioni personali. Verificare che il montaggio a parete sia in grado di sostenere un peso 4 volte superiore a quello dell'apparecchio.

<b>⚠ AVVERTENZA</b>	
	Pericolo di lesioni personali. Gli strumenti o i componenti sono pesanti. Per l'installazione o lo spostamento richiedere assistenza.

<b>⚠ AVVERTENZA</b>	
	Pericolo di lesioni personali. Oggetto pesante. Per un funzionamento sicuro, verificare che lo strumento sia fissato saldamente alla parete, al tavolo o al pavimento.

Utilizzare le staffe di montaggio fornite in dotazione per fissare lo strumento in posizione diritta e orizzontale su una superficie verticale liscia. Fare riferimento a [Figura 6](#) a pagina 456.

Installare lo strumento in una posizione dove l'utente può facilmente scollegarlo dalla fonte di alimentazione.

Accertarsi che sotto l'analizzatore ci sia spazio sufficiente per installare i flaconi.

Il materiale di montaggio è a carico dell'utente. Accertarsi che il fissaggio a parete abbia una capacità di carico sufficiente (circa 160 kg o 353 libbre). La bulloneria di montaggio deve essere approvata per le proprietà della parete.


### 5.3.2 Aprire lo sportello dell'analizzatore

Utilizzare la chiave fornita per sbloccare i due fermi sul lato dell'analizzatore. [Figura 7](#) a pagina 456  
Assicurarsi di chiudere lo sportello prima della messa in funzione per mantenere il livello di sicurezza e la classificazione ambientale dell'alloggiamento.

## 5.4 Electrical installation

<b>⚠ PERICOLO</b>	
	Pericolo di folgorazione. Quando si eseguono collegamenti elettrici, scollegare sempre l'alimentazione dello strumento.

### 5.4.1 Scariche elettrostatiche

<b>AVVISO</b>	
	Danno potenziale allo strumento. Componenti elettronici interni delicati possono essere danneggiati dall'elettricità statica, compromettendo le prestazioni o provocando guasti.

Attenersi ai passaggi della presente procedura per non danneggiare l'ESD dello strumento:

- Toccare una superficie in metallo con messa a terra, ad esempio il telaio di uno strumento o una tubatura metallica per scaricare l'elettricità statica.
- Evitare movimenti eccessivi. Trasportare i componenti sensibili alle scariche elettrostatiche in appositi contenitori o confezioni antistatiche.

- Indossare un bracciale antistatico collegato a un filo di messa a terra.
- Lavorare in un'area sicura dal punto di vista dell'elettricità statica con tappetini e tappetini da banco antistatici.

## 5.4.2 Accesso ai collegamenti elettrici

Inserire i cavi dei dispositivi esterni attraverso i pressacavi. [Figura 8](#) a pagina 458 Tenere chiusi i pressacavi non utilizzati.

[Figura 9](#) a pagina 461 mostra i componenti interni dell'analizzatore. L'interruttore di alimentazione è un interruttore automatico che interrompe automaticamente l'alimentazione alla linea elettrica CA in caso di sovracorrente (ad esempio un corto circuito) o sovratensione.

## 5.4.3 Collegamento dei dispositivi esterni

Collegare i dispositivi esterni che verranno utilizzati con l'analizzatore ai terminali di segnale e di controllo dell'analizzatore. Fare riferimento alla [Figura 10](#) a pagina 465 e alla [Tabella 1](#) a pagina 46.

**Tabella 1 Terminali di controllo e di segnale - Descrizioni**

Pin	Descrizione
AO1–AO8 (P101)	Otto uscite analogiche per il controllo di dispositivi esterni. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla versione online del manuale dell'utente completo.
FCT1–FCT5 (P102)	Cinque relè (contatti privi di potenziale). Il carico massimo è 24 V CC, 0,5 A. <ul style="list-style-type: none"> <li>• FCT1 - Allarme malfunzionamento</li> <li>• FCT2 - Allarme manutenzione</li> <li>• FCT3 - Analizzatore pronto</li> <li>• FCT4 e FCT5 - Per uso futuro</li> </ul>
DI1–DI7 (P103)	Sette ingressi digitali per controllare l'analizzatore a distanza <sup>5</sup> . Collegare gli ingressi digitali a un contatto esterno privo di potenziale (24 V CC) per attivare l'analizzatore per avviare una misurazione per un canale. <ul style="list-style-type: none"> <li>• DI1 - Avvio remoto per il canale 1</li> <li>• DI2 - Avvio remoto per il canale 2</li> <li>• Da DI3 a DI7 - Per uso futuro</li> </ul>
FB1–FB4 (P104)	Connettori Profibus DP o Modbus RTU (RS485) <p><b>Profibus DP:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FB1—A1 (ingresso)</li> <li>• FB2—A2 (uscita)</li> <li>• FB3—B1 (ingresso)</li> <li>• FB4—B2 (uscita)</li> <li>• SHL—Schermatura</li> </ul> <p><b>RTU Modbus:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FB1—D (+)</li> <li>• FB2—D (-)</li> <li>• FB3—Non utilizzato</li> <li>• FB4—Non utilizzato</li> <li>• SHL—Schermatura</li> </ul> <p>Fare riferimento alla documentazione del Controllore SC4500 per le istruzioni di configurazione di Modbus e i tag telegramma.</p>
24 V CC/1 A (P105)	Alimentatore CC da 24 V per unità di filtrazione EZ9010 e EZ9020

<sup>5</sup> Se l'analizzatore è in modalità di manutenzione, il controllo a distanza è disabilitato.

**Tabella 1 Terminali di controllo e di segnale - Descrizioni (continua)**

Pin	Descrizione
STR1–STR8 (P106)	<p>Otto uscite digitali per il pannello Moduplex opzionale. Collegare i fili scoperti di ciascuna valvola di canale sul pannello Moduplex ai relativi connettori STR.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• STR1—Canale 1</li> <li>• STR2—Canale 2</li> <li>• ...</li> <li>• STR8—Canale 8</li> </ul>
EXT9–EXT12 (P107)	<p>Quattro uscite digitali per il pannello di filtrazione EZ9150 opzionale. Collegare le valvole elettriche e la pompa sul pannello di filtrazione EZ9150 ai connettori EXT.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EXT9—Valvola di risciacquo</li> <li>• EXT10—Valvola di scarico</li> <li>• EXT11—Valvola portata eccessiva scarico</li> <li>• EXT12—Pompa di filtrazione</li> </ul>
D01–D06 (P108 e P109)	<p>Sei uscite valvole pneumatiche per il pannello EZ9150.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• D01 - Valvola ingresso campione</li> <li>• D02 - Valvola portata eccessiva scarico</li> <li>• D03 - Valvola canale 1</li> <li>• D04 - Valvola canale 2</li> <li>• D05 - Valvola canale 3</li> <li>• D06 - Valvola canale 4</li> </ul>

IT

#### 5.4.4 Collegamento all'alimentazione CA

### ⚠ PERICOLO



Pericolo di incendio e folgorazione. Verificare che il cavo fornito e la spina senza blocco soddisfino i requisiti relativi al codice paese.

- Verificare che sulla linea di alimentazione sia installato un interruttore automatico con sufficiente capacità di corrente elettrica.
- Verificare che vicino all'analizzatore sia installato un interruttore automatico o un interruttore di emergenza affinché, se necessario, l'analizzatore possa essere scollegato immediatamente dall'alimentazione.
- Collegare l'apparecchiatura in conformità alle normative elettriche locali, regionali o nazionali.
- Installare il cavo di alimentazione in dotazione attraverso il pressacavo sul lato dell'analizzatore.
- Serrare il pressacavo per fissare saldamente il cavo di alimentazione e mantenere la classificazione ambientale dell'alloggiamento.

Collegare l'analizzatore all'alimentazione CA utilizzando il relativo cavo in dotazione. Fare riferimento alla [Tabella 2](#) a pagina 48 e alla [Figura 11](#) a pagina 468.

## AVVISO

Non attivare l'interruttore dell'alimentazione. Completare tutti i collegamenti elettrici e idraulici prima di avviare l'analizzatore per non danneggiarlo.

**Tabella 2 Informazioni sul cablaggio - Alimentazione CA**

Terminale	Descrizione	Colore del cavo - Nord America e Canada	Colore del cavo UE
L	Alimentato/Linea (L)	Nero (1)	Marrone
N	Neutro (N)	Bianco (2)	Blu
	Messa a terra di protezione (PE)	Verde con banda gialla	Verde con banda gialla

## 5.5 Collegamenti idraulici

### 5.5.1 Linee guida sulla linea dei campioni

#### ⚠ ATTENZIONE



Pericolo di incendio. Questo prodotto non è progettato per l'uso con campioni infiammabili.

Affinché lo strumento possa dare risultati ottimali, scegliere un punto di campionamento appropriato e rappresentativo. Il campione deve essere rappresentativo di tutto l'impianto.

- Accertarsi che il flusso del campione sia maggiore del flusso diretto all'analizzatore.
- Accertarsi che la linea del campione si trovi alla pressione atmosferica se l'analizzatore utilizza una pompa peristaltica per spostare il campione nel contenitore per analisi.
- Accertarsi che la linea del campione raccolga il campione da un piccolo recipiente di troppopieno vicino all'analizzatore.
- Utilizzare la linea di campionamento fornita. Non modificare la lunghezza della linea di campionamento.

Il campione nel recipiente di troppopieno deve essere continuamente rinnovato. Se la dimensione dei solidi nel campione è troppo grande, si consiglia di filtrare il campione.

### 5.5.2 Linee guida per le tubazioni di scarico

#### ⚠ AVVERTENZA



Pericolo di incendio. È responsabilità dell'utente assicurarsi che siano state intraprese le misure di sicurezza necessarie per l'uso dell'apparecchiatura in combinazione con liquidi infiammabili. Attendersi scrupolosamente ai protocolli di sicurezza e alle precauzioni per l'utente corretti. Inclusi, ma non limitati a, controlli di perdite o fuoriuscite di liquidi, ventilazione corretta, verifica di utilizzo presidiato e che lo strumento non venga mai lasciato incustodito con l'alimentazione inserita.

#### ⚠ ATTENZIONE



Pericolo di esposizione ad agenti chimici. Smaltire i prodotti chimici e i rifiuti conformemente alle normative locali, regionali e nazionali.

## AVVISO

Non collegare le tubazioni di scarico ad altre tubazioni per evitare contropressione o altri danni dell'analizzatore. Verificare che le tubazioni di scarico siano aperte.

## AVVISO

Per evitare la contropressione e altri danni dell'analizzatore, accertarsi che quest'ultimo sia posizionato più in alto rispetto agli scarichi dell'impianto e che la tubazione di scarico sia sempre inclinata verso il basso. Installare le tubazioni di scarico con una pendenza verticale di almeno 2,54 cm (1 pollice) per ogni 0,3 m (1 ft) di lunghezza del tubo.

L'analizzatore utilizza la tubazione di scarico per rilasciare il campione e i reagenti dopo l'analisi. È importante montare correttamente le tubazioni di scarico per accertarsi che tutto il liquido venga eliminato dallo strumento. Un montaggio non corretto può causare il ritorno del liquido nello strumento e provocare danni. Per la tubazione di scarico è sufficiente uno scarico su pavimento o in un lavabo. Il diametro esterno consigliato per il tubo di scarico è di 32 mm. Fare riferimento a [Figura 12](#) a pagina 470.

- Accertarsi che le tubazioni di scarico siano quanto più corte possibile.
- Accertarsi che lo scarico si trovi più in basso dell'analizzatore.
- Accertarsi che le tubazioni di scarico abbiano una pendenza costante.
- Accertarsi che le tubazioni di scarico non siano disposte con curve strette o schiacciate.
- Accertarsi che le tubazioni di scarico siano aperte e che non sia presente pressione.
- Assicurarsi che le tubazioni di scarico siano chiuse all'ambiente della sala di installazione.
- Non bloccare o immergere la tubazione di scarico.

Si consiglia inoltre di utilizzare un raccordo dell'acqua vicino all'analizzatore in modo che il lavabo e il tubo di scarico siano lavati regolarmente con acqua pulita per impedirne il blocco dovuto alla cristallizzazione.

Per ulteriori informazioni sui reagenti utilizzati nell'analizzatore, fare riferimento a Method & Reagent Sheet (Scheda Metodo e reagente) del modello della serie EZ applicabile. Se l'analizzatore utilizza reagenti infiammabili, attenersi alle precauzioni di sicurezza seguenti:

- Non collegare la linea di scarico a uno scarico a pavimento.
- Smaltire i rifiuti secondo la normativa ambientale locale, statale e nazionale.

### 5.5.3 Linee guida per la tubazione di ventilazione

#### ⚠ AVVERTENZA



Pericolo di incendio. È responsabilità dell'utente assicurarsi che siano state intraprese le misure di sicurezza necessarie per l'uso dell'apparecchiatura in combinazione con liquidi infiammabili. Attenersi scrupolosamente ai protocolli di sicurezza e alle precauzioni per l'utente corretti. Inclusi, ma non limitati a, controlli di perdite o fuoriuscite di liquidi, ventilazione corretta, verifica di utilizzo presidiato e che lo strumento non venga mai lasciato incustodito con l'alimentazione inserita.

#### ⚠ ATTENZIONE



Pericolo di esposizione ad agenti chimici. Smaltire i prodotti chimici e i rifiuti conformemente alle normative locali, regionali e nazionali.

#### AVVISO

Non collegare la tubazione di ventilazione (porta dei gas di scarico) ad altre tubazioni per evitare contropressione o danni all'analizzatore. Assicurarsi che la tubazione di ventilazione sia aperta all'aria esterna all'edificio.

#### AVVISO

Per evitare la contropressione e altri danni all'analizzatore, accertarsi che quest'ultimo sia posizionato più in alto rispetto ai sistemi di ventilazione della struttura e che la tubazione di ventilazione sia sempre inclinata verso il basso. Installare la tubazione di ventilazione con una pendenza verticale di almeno 2,54 cm (1 pollice) ogni 0,3 m (1 piede) di lunghezza della tubazione.

L'analizzatore utilizza la tubazione di ventilazione per mantenere il contenitore per analisi alla pressione atmosferica. È importante installare correttamente la tubazione di ventilazione per assicurarsi che nessun liquido entri nel contenitore per analisi durante il funzionamento della pompa. Un montaggio non corretto può causare il ritorno del gas nello strumento e provocare danni. Il

di diametro esterno consigliato per la tubazione di testa della ventilazione è di 32 mm. Fare riferimento a [Figura 12](#) a pagina 470.

- Accertarsi che la tubazione di ventilazione sia quanto più corta possibile.
- Accertarsi che la tubazione di ventilazione abbia una pendenza costante.
- Accertarsi che sulla tubazione di ventilazione non siano presenti curve strette o schiacciamenti.
- Assicurarsi che la tubazione di ventilazione sia chiusa all'ambiente della sala di installazione e a pressione zero.
- Assicurarsi che la tubazione di ventilazione sia sempre più alta dello scarico.
- Non bloccare o immergere la tubazione di ventilazione.

Se l'analizzatore utilizza reagenti infiammabili, attenersi alle precauzioni di sicurezza seguenti:

- Non collegare la tubazione di ventilazione a uno scarico a pavimento.
- Smaltire i rifiuti secondo la normativa ambientale locale, statale e nazionale.

#### 5.5.4 Collegamento dell'analizzatore per il test dei componenti



### ⚠ ATTENZIONE



Pericolo di incendio. Questo prodotto non è stato concepito per l'uso con liquidi infiammabili.

Prima di mettere in funzione l'analizzatore con tutti i reagenti, è necessario eseguire un test dei componenti con acqua deionizzata. Fare riferimento alla procedura illustrata e alla sezione [Esegui i test dei componenti](#) a pagina 54.




1. Montare i quattro tubi delle valvole a pinza come mostrato nel passo 1 della figura che segue.
  - a. Premere il pulsante nero, quindi spingere il tubo nella valvola.
  - b. Rilasciare il pulsante non appena il tubo è installato correttamente.
2. Assicurarsi che il tubo di scarico sia installato correttamente nel contenitore per campioni. Fare riferimento al passaggio 2 illustrato di seguito.
3. Assicurarsi che il tubo del digestore sia installato correttamente nel contenitore del digestore. Fare riferimento al passaggio 3 illustrato di seguito.
4. Collegare tutti i tubi del liquido dell'analizzatore a un flacone grande di acqua deionizzata per effettuare un test dei componenti. Fare riferimento al passaggio 3 illustrato di seguito. Il tubo è installato in fabbrica.

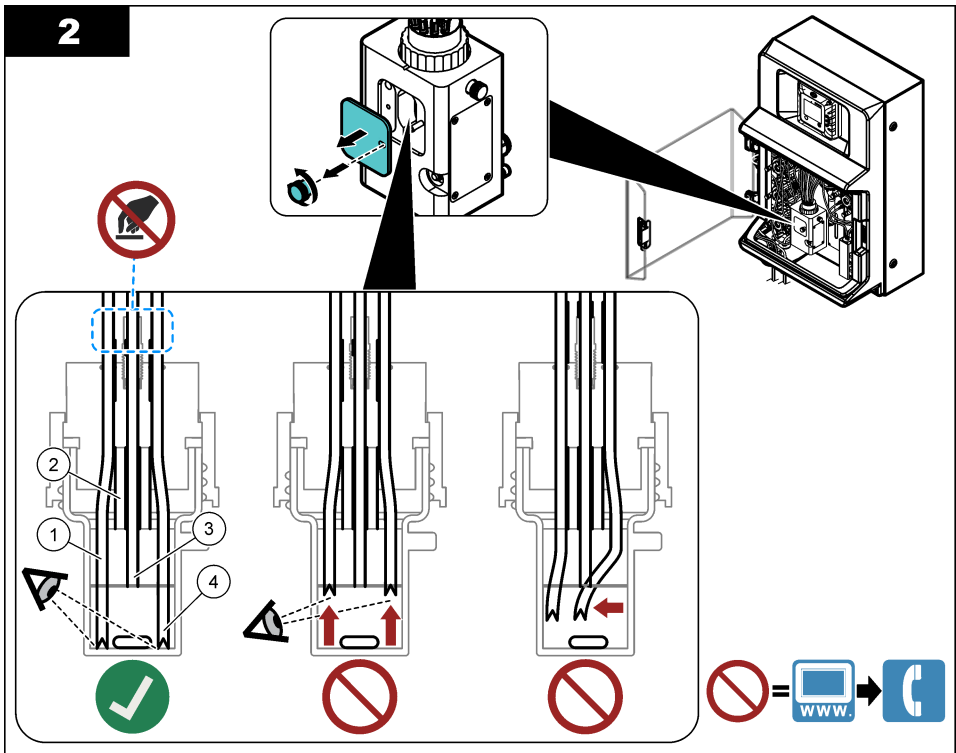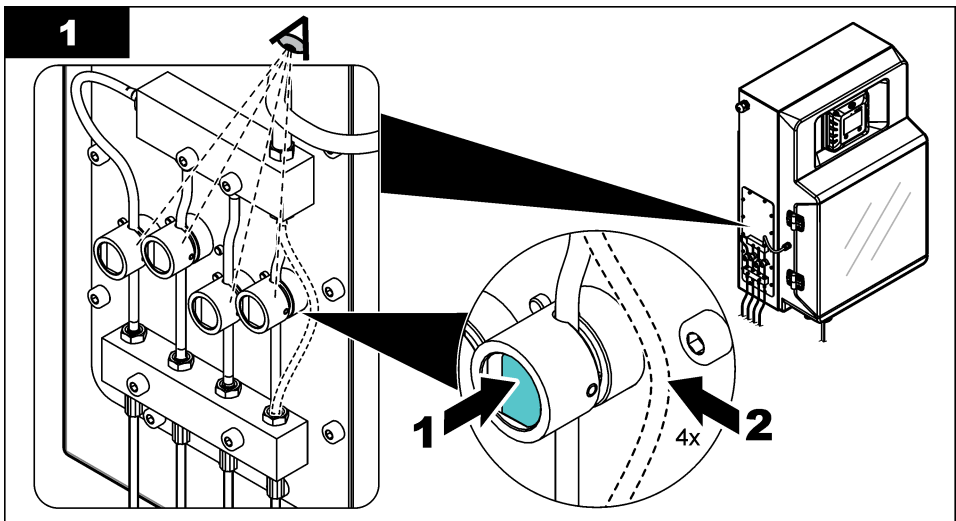

1 Tubo di scarico	3 Tubo del campione
2 Tubo reagenti e sfiato (tubo superiore)	4 Tubo del digestore

3


IT

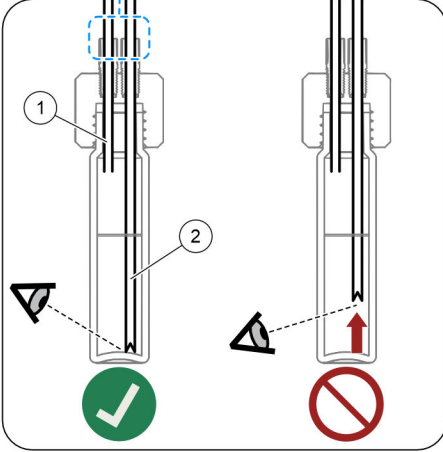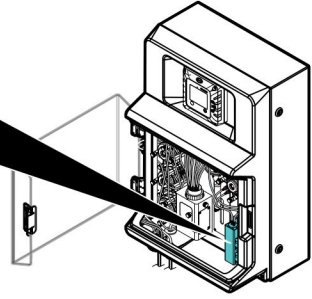

1 Tubo di sfiato

2 Tubo del digestore

4

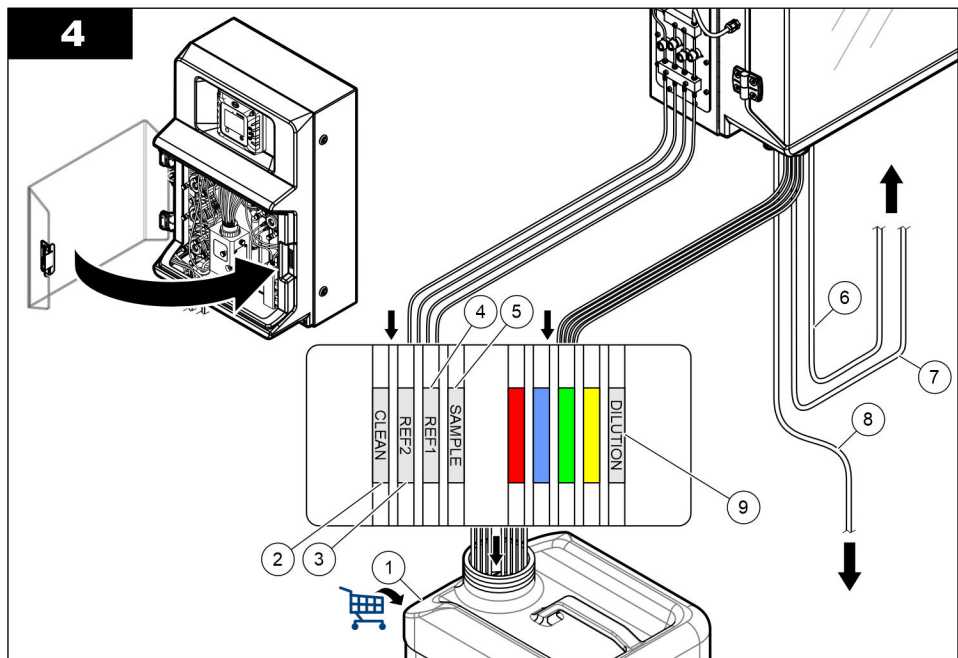

1 Acqua deionizzata	4 Tubo della soluzione di riferimento 1 (REF1)	7 Digestore di sfiato
2 Pulizia del tubo della soluzione	5 Tubo di ingresso campione	8 Tubo di scarico
3 Tubo della soluzione di riferimento 2 (REF2)	6 Tubo di sfiato	9 Tubi di diluizione e delle micropompe del reagente

## Sezione 6 Avviamento

### 6.1 Avvio iniziale

**Nota:** Assicurarsi che il montaggio, i tubi e le installazioni elettriche siano completamente sistemati prima dell'avvio. Fare riferimento a [Installazione](#) a pagina 44.

Quando l'analizzatore viene impostato su acceso per la prima volta, un assistente all'avvio aiuterà nelle prime fasi del completamento dell'impostazione. Completare tutte le fasi che seguono per assicurarsi che l'analizzatore funzioni correttamente.

**Nota:** utilizzare i reagenti corretti per intervallo di misurazione selezionato. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla versione online del manuale dell'utente completo.

1. Aprire lo sportello dell'analizzatore. Fare riferimento a [Aprire lo sportello dell'analizzatore](#) a pagina 45.
2. Portare l'interruttore di alimentazione sulla posizione ON. [Figura 9](#) a pagina 461
3. Chiudere lo sportello dell'analizzatore con la chiave in dotazione.
4. Attendere il completamento della procedura di inizializzazione.
5. Rispondere ai prompt visualizzati sul display per selezionare la lingua, il fuso orario, la data e l'ora.

Per configurare le altre impostazioni del controller, fare riferimento alla documentazione del controller SC4500.

6. Toccare il display per visualizzare il menu **EZ2700sc**.

7. Selezionare **Menu dispositivo** per avviare l'assistente all'avvio. Viene visualizzata la schermata di benvenuto.
8. Completare i passaggi mostrati sul display per selezionare l'intervallo di misurazione applicabile. Premere **OK**.
9. Se è installata un'unità di filtrazione, selezionare **Accesso**. In caso contrario, selezionare **Spento**.
10. Selezionare il numero di canali per l'analizzatore. Premere **OK**.
11. Se la configurazione mostrata nella pagina di riepilogo è corretta, premere **OK**. Viene visualizzato il menu principale di **EZ2700sc**.
12. Continuare con il test dei componenti. [Eseguire i test dei componenti](#) a pagina 54

## 6.2 Eseguire i test dei componenti

### ⚠ AVVERTENZA



Pericolo di schiacciamento. Gli organi mobili possono causare lesioni dovute a schiacciamento. Non toccare gli organi mobili.

Prima di mettere in funzione l'analizzatore, eseguire i test dei componenti. Utilizzare il menu **Manutenzione** per avviare le diverse funzioni dell'analizzatore ed esaminare il funzionamento dei componenti.

#### Prerequisiti:

- Se l'analizzatore è in modalità operativa, selezionare **Manutenzione > Start maintenance mode (Avvia modalità di manutenzione)**.
- Assicurarsi che il campione, il reagente e i tubi della soluzione si trovino in un contenitore di acqua deionizzata. [Collegamento dell'analizzatore per il test dei componenti](#) a pagina 50

#### 6.2.1 Esame dell'agitatore

1. Rimuovere lo schermo antiluce dall'unità fotometro. [Figura 13](#) a pagina 472
2. Accertarsi che l'agitatore si trovi sul fondo del contenitore del campione.  
*Nota: Esaminare l'agitatore durante la procedura di adescamento per assicurarsi che ruoti correttamente. La procedura di adescamento viene avviata in [Esame delle pompe e delle valvole a pinza](#) a pagina 54.*
3. Installare lo schermo antiluce sul fotometro.

#### 6.2.2 Esame delle pompe e delle valvole a pinza

1. Esaminare il funzionamento delle pompe e delle valvole a pinza per accertarsi che non siano presenti perdite.
2. Verificare che il contenitore per analisi si riempia di acqua deionizzata. [Figura 14](#) a pagina 474
3. Verificare che l'acqua deionizzata fuoriesca dal tubo di scarico.
4. Selezionare **Manutenzione > Start priming (Avvio del condizionamento)** ed eseguire separatamente l'adescamento di tutti i liquidi.

In caso di perdite, esaminare tutti i collegamenti e fare riferimento alla versione online del manuale dell'utente completo per ulteriori informazioni.

- a. Selezionare **Prime reference 1 (Carica riferimento 1)** e premere **OK**.
- b. Selezionare **Prime reference 2 (Carica riferimento 2)** e premere **OK**.
- c. Selezionare **Prime cleaning solution (Carica soluzione detergente)** e premere **OK**.
- d. Selezionare **Prime rinsing (Prepara risciacquo)** e premere **OK**.
- e. Selezionare **Prime dispenser (Prepara erogatore)** e premere **OK**.
- f. Selezionare **Prime channel (Adescamento canale) > Prime all channels (Adescamento di tutti i canali)** e premere **OK**.  
Ogni procedura di adescamento viene interrotta automaticamente al termine della procedura.

### 6.2.3 Esame delle micropompe

Esaminare le micropompe per verificare che non vi siano perdite o bolle d'aria.

1. Rimuovere lo schermo antilucente dal fotometro.
2. Selezionare **Manutenzione > Start priming (Avvio del condizionamento) > Prime all reagents (Carica tutti i reagenti)**.
3. Assicurarsi che l'acqua deionizzata arrivi alla micropompa attraverso ciascuno dei tubi della micropompa (reagente) e poi nel contenitore per analisi in modo continuo senza bolle d'aria. [Figura 15](#) a pagina 475
4. Se le micropompe non funzionano correttamente (bolle nei tubi), utilizzare la procedura con siringa per spingere l'acqua deionizzata nei tubi pertinenti per rimuovere le bolle. [Figura 16](#) a pagina 476
5. Installare lo schermo antilucente sul fotometro.

### 6.2.4 Eseguire un controllo del fotometro

Assicurarsi che la parte esterna del contenitore per analisi sia pulita prima del controllo del fotometro affinché il controllo possa essere completato correttamente. Per ulteriori informazioni sulla pulizia dei componenti dell'analizzatore, fare riferimento alla versione online del manuale dell'utente completo.

1. Premere l'icona del menu principale e poi selezionare **Dispositivi**.
2. Selezionare **EZ2700sc**.
3. Scorrere verso il basso fino in fondo alla schermata e poi selezionare il **Menu dispositivo**.
4. Selezionare **Manutenzione > Controllo del fotometro**.
5. Premere **OK** per avviare la misurazione.  
Al termine della calibrazione del valore scuro, il risultato viene visualizzato sul display.
6. Premere **OK** per continuare.
7. Accertarsi che il tubo "REF1" sia collegato a un contenitore riempito con acqua deionizzata. Assicurarsi che lo schermo antilucente sia installato. [Figura 18](#) a pagina 478
8. Premere **OK**.  
Attendere che il contenitore per analisi sia pieno.
9. Utilizzare un cacciavite per regolare la tensione di uscita del sensore a 9 V. Fare riferimento alla [Figura 17](#) a pagina 476.
10. Attendere che sullo schermo venga visualizzato il valore di 9 V. Quindi, premere **OK**.
11. Premere **OK** per continuare.

## 6.3 Prova del segnale di ingresso

Prima di mettere in funzione l'analizzatore, eseguire una prova degli ingressi digitali.

**Prerequisiti:** Collegare gli ingressi digitali a un contatto esterno privo di potenziale (24 V CC).

Eseguire il test del segnale di ingresso digitale e del segnale di uscita analogica come segue:

1. Premere l'icona del menu principale e poi selezionare **Devices (Dispositivi)**.
2. Selezionare **EZ2700sc**.
3. Scorrere verso il basso fino in fondo alla schermata e poi selezionare il **Menu dispositivo**.
4. Selezionare **Diagnostics (Diagnostica) > Segnali**.  
Vengono visualizzati i segnali relativi agli ingressi digitali.
5. Confrontare lo stato degli ingressi digitali sul display con le tensioni fornite agli ingressi digitali (24 V = Acceso; 0 V = Spento).

## 6.4 Prova del segnale di uscita

Prima di mettere in funzione l'analizzatore, eseguire una prova delle uscite analogiche.

**Prerequisiti:** Configurare le uscite analogiche (AO1–AO8, P101) per selezionare la misurazione del canale rappresentata da ogni uscita analogica. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla versione online del manuale dell'utente completo.

Eseguire una prova del segnale di uscita analogica come segue:

1. Premere l'icona del menu principale.
2. Selezionare **Outputs (Uscite) > mA outputs AOC (AOC uscite mA) > Test/Maintenance (Test/Manutenzione)**.

Opzione	Descrizione
<b>Function test (Test prog. funzioni)</b>	Consente di eseguire una prova delle uscite sul modulo selezionato.
<b>Output status (Stato uscita)</b>	Consente di visualizzare la condizione delle uscite sul modulo selezionato.

3. Utilizzare un multimetro per misurare il valore mA per ogni uscita analogica.
4. Confrontare il valore mA misurato sulle uscite analogiche con i valori mA previsti.

## 6.5 Impostazione della sequenza dei canali

Selezionare la sequenza di misurazione dei canali, il numero di volte in cui ogni canale viene misurato e il tempo di attesa prima che venga misurato un canale. Immettere 16 voci al massimo con un massimo di 16 cicli ciascuna.

1. Premere l'icona del menu principale e poi selezionare **Dispositivi**.
2. Selezionare **EZ2700sc**.
3. Scorrere verso il basso fino in fondo alla schermata e poi selezionare il **Menu dispositivo**.
4. Se l'analizzatore è in modalità operativa, selezionare **Manutenzione > Start maintenance mode (Avvia modalità di manutenzione)**.  
Attendere che l'analizzatore sia in modalità di manutenzione.
5. Selezionare **Configurazione > Impostazione della sequenza dei canali**.
6. Utilizzare le frecce sulla barra laterale per selezionare una posizione (numero nella sequenza) e poi premere **OK** per configurarla.
7. Selezionare un'opzione.

Opzione	Descrizione
<b>Seleziona</b>	Consente di selezionare il canale o il tempo di attesa applicabile.
<b>Number of measurements (Numero di misure)</b>	Consente di impostare il numero di misurazioni effettuate per un canale.
<b>Waiting time (Tempo di attesa)</b>	Consente di impostare il tempo di attesa per il canale selezionato.

8. Premere **OK** per applicare le modifiche.

## 6.6 Collegare le soluzioni e il campione

### ⚠ ATTENZIONE



Pericolo di esposizione ad agenti chimici. Rispettare le procedure di sicurezza del laboratorio e indossare tutte le apparecchiature protettive appropriate per le sostanze chimiche utilizzate. Fare riferimento alle attuali schede di sicurezza (MSDS/SDS) per i protocolli di sicurezza.

### ⚠ ATTENZIONE



Pericolo di esposizione ad agenti chimici. Smaltire i prodotti chimici e i rifiuti conformemente alle normative locali, regionali e nazionali.

## ⚠ ATTENZIONE



Pericolo di incendio. Questo prodotto non è stato concepito per l'uso con liquidi infiammabili.

I contenitori dei reagenti vengono forniti con l'analizzatore. Fare riferimento alla [Figura 18](#) a pagina 478. I contenitori per la soluzione Reference 1 (Riferimento 1) e la soluzione Reference 2 (Riferimento 2) e per l'acqua deionizzata sono forniti dall'utente. Il produttore può acquistare altri contenitori.

Installare i contenitori

- il più vicino possibile all'analizzatore
- 1 metro sotto la parte inferiore dell'analizzatore

Per l'installazione del contenitore, fare riferimento alla [Figura 18](#) a pagina 478.

Reagenti e soluzioni sono forniti dall'utente. Utilizzare solo reagenti forniti da un'azienda certificata o specifici del produttore. In alternativa, i reagenti possono essere preparati dall'utente. Seguire le istruzioni contenute nella Method & Reagent Sheet (Scheda Metodo e reagente) per il modello applicabile, disponibile sul sito Web del produttore.

Il tubo è installato in fabbrica. Leggere l'etichetta su ciascun tubo per identificare il collegamento idraulico corretto. Per informazioni su reagenti, soluzioni e standard corretti, fare riferimento alla Method & Reagent Sheet (Scheda Metodo e reagente) applicabile per il modello disponibile sul sito Web del produttore.

1. Dopo aver eseguito i test dei componenti, installare i tubi "CLEAN" (soluzione detergente), "REF1" (soluzione di riferimento 1) e "REF2" (soluzione di riferimento 2) nei relativi contenitori. [Figura 18](#) a pagina 478
2. Installare ogni provetta di reagente con codifica a colori nel contenitore del reagente con lo stesso colore sull'etichetta.
3. Collegare la fonte di campionamento (o l'uscita del campione del pannello Moduplex o del pannello del filtro) al tubo di ingresso del campione dell'analizzatore. Fare riferimento a [Figura 18](#) a pagina 478.
4. Premere l'icona del menu principale e poi selezionare **Dispositivi**.
5. Selezionare **EZ2700sc**.
6. Scorrere verso il basso fino in fondo alla schermata e poi selezionare il **Menu dispositivo**.
7. Selezionare **Manutenzione > Start priming (Avvio del condizionamento) > Prima su tutti**.

## 6.7 Esecuzione di una convalida prima dell'avvio iniziale

Eseguire una convalida per assicurarsi che le misurazioni siano ancora comprese nella gamma di tolleranza. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla versione online del manuale dell'utente completo.

1. Premere l'icona del menu principale e poi selezionare **Dispositivi**.
2. Selezionare **EZ2700sc**.
3. Scorrere verso il basso fino in fondo alla schermata e poi selezionare il **Menu dispositivo**.
4. Per avviare una validazione, selezionare **Calibrazione > Validation (Convalida) > Avvio della validazione**.

La convalida misura l'acqua deionizzata nel flacone di riferimento 2.

5. Per visualizzare i risultati, selezionare un'opzione:
  - **Calibrazione > Validation (Convalida) > Validation history (Storico delle validazioni)**
  - **Diagnostics (Diagnostica) > Dati cronologici > Validation (Convalida)**

## 6.8 Avvio dell'analizzatore

Per avviare l'analizzatore:

1. Premere l'icona del menu principale e poi selezionare **Dispositivi**.
2. Selezionare **EZ2700sc**.
3. Scorrere verso il basso fino in fondo alla schermata e poi selezionare il **Menu dispositivo**.
4. Selezionare **Manutenzione > Start operational mode (Avvia modalità operativa)**.

## Table des matières

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1 Informations supplémentaires à la page 59 | 4 Généralités à la page 61    |
| 2 Présentation du produit à la page 59      | 5 Installation à la page 63   |
| 3 Spécifications à la page 60               | 6 Mise en marche à la page 72 |

## Section 1 Informations supplémentaires

Le manuel d'utilisation simplifié contient suffisamment d'informations pour pouvoir procéder à la mise en service. Le manuel d'utilisation détaillé est accessible en ligne et contient davantage d'informations.

FR

### ▲ DANGER



Dangers multiples ! Vous trouverez de plus amples informations dans les sections respectives du manuel d'utilisation détaillé, lesquelles sont indiquées ci-dessous.

- Interface utilisateur et navigation
- Fonctionnement
- Entretien
- Dépannage
- Listes de pièces de rechange

Scannez les codes QR suivants pour accéder au manuel d'utilisation détaillé.



Langues européennes



Langues américaines et asiatiques

## Section 2 Présentation du produit

L'analyseur EZ2700sc Hach est un analyseur en ligne qui mesure un paramètre dans des échantillons d'eau prélevés dans les applications industrielles et environnementales. Reportez-vous à [Figure 1](#) à la page 438, [Figure 2](#) à la page 442 et [Figure 3](#) à la page 446.

L'analyseur est un analyseur colorimétrique en ligne pour l'analyse générale de l'eau (p. ex. les nitrates, les phosphates). L'analyseur dispose d'options de démarrage à distance, de validation automatique, d'étalonnage automatique, de nettoyage automatique et de Modbus.

L'eau de l'échantillon pénètre dans l'analyseur par le tuyau d'échantillon. Les pompes, les vannes et les seringues dans l'analyseur déplacent l'échantillon et les réactifs vers la cellule de mesure sur le panneau d'analyse. Lorsque l'analyse de la cuve est terminée, l'analyseur rejette l'échantillon par le tuyau de vidange. Les résultats de l'analyse s'affichent sur l'écran du transmetteur SC4500. Le transmetteur SC4500 enregistre les données de l'analyseur (journaux de données, des événements, des paramètres et de service). Le transmetteur SC4500 permet d'utiliser et de configurer l'analyseur.

Pour augmenter le nombre de flux d'échantillons (canaux) que l'analyseur peut mesurer (2, 4 ou 8), achetez le panneau à flux multiples Moduplex avec l'analyseur.

Pour préconditionner l'échantillon (filtration, décantation), achetez le panneau de filtration EZ9010, EZ9020, EZ9150, EZ9200 or EZ9250 avec l'analyseur.

## Section 3 Spécifications

Ces spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.

Spécification	Détails
Dimensions (L x H x P)	460 x 688 x 340 mm (18,1 x 27,1 x 13,4 pouces)
Boîtier	IP44 ; ABS, PMMA et acier revêtu
Affichage	IP66, écran couleur TFT 3,5 pouces avec pavé tactile capacitif
Poids	40 kg (88 lb)
Alimentation électrique	De 100 à 240 V AC $\pm 10$ %, 50/60 Hz
Consommation électrique	240 VA maximum
Altitude	2 000 m (6 560 ft) maximum
Catégorie de surtension	II
Conditions environnementales	Utilisation intérieure seulement
Niveau de pollution	2
Température de fonctionnement	10 à 30 °C (50 à 86 °F) ; 5 à 95 % d'humidité relative, sans condensation, non corrosif
Température de stockage	-20 à 60 °C (-4 à 140 °F), 98 % d'humidité relative sans condensation maximum
Entrées d'échantillon	Une
Pression d'échantillon	Par la cuve de trop-plein externe (ouverte à la pression atmosphérique)
Débit de l'échantillon	100 à 300 mL/min
Température de l'échantillon	10 à 30 °C (50 à 86 °F)
Qualité d'échantillon	Particules < 100 $\mu\text{m}$ , < 0,1 g/L maximum Turbidité < 50 NTU
Purge d'air pour les environnements corrosifs	0,2 bar (20 kPa ou 3 psi) ; air sec et propre
Evacuation	Pression atmosphérique, ventilée, $\varnothing$ 32 mm minimum
Raccordement à la terre	Pôle de mise à la terre sec et propre avec une impédance faible (< 1 $\Omega$ ) avec un câble de terre > 2,5 mm <sup>2</sup> (13 AWG)
Sorties analogiques	Huit sorties analogiques 0 à 20 mA (ou 4 à 20 mA) au maximum <b>Remarque</b> : Les sorties analogiques alimentent la boucle. Il est impossible d'alimenter les contacts du système SCADA ou PLC.
Entrées numériques	Sept entrées numériques : deux entrées numériques pour le démarrage à distance. Les entrées numériques restantes sont destinées à un usage ultérieur.
Sorties numériques	Quatre sorties numériques sous tension pour les vannes et les pompes du panneau EZ9150 ; huit sorties numériques sous tension pour les vannes du panneau Moduplex ; 24 VCC, 500 mA.
Relais	Cinq contacts sans potentiel (FCT), charge maximale 24 V CC, 0,5 A (charge résistive)
Connexions Ethernet	Connexion Ethernet Claros et connecteur Ethernet Modbus TCP/IP ; version LAN ; 10/100 Mbps, ou Profinet ou IP Ethernet

<sup>2</sup> Pour plus d'informations sur la configuration Ethernet et la configuration Modbus, reportez-vous à la documentation du transmetteur SC4500.

Spécification	Détails
Communications RS485	Profibus DP ou Modbus RTU
Certifications	CE, Certification ETL conforme aux normes de sécurité UL et CSA, UKCA
Garantie	1 an (UE : 2 ans)

## Section 4 Généralités

En aucun cas le fabricant ne pourra être tenu responsable des dommages résultant d'une utilisation incorrecte du produit ou du non-respect des instructions du manuel. Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications à ce manuel et aux produits décrits, à tout moment, sans avertissement ni obligation. Les éditions révisées se trouvent sur le site Internet du fabricant.

### 4.1 Consignes de sécurité

Le fabricant décline toute responsabilité quant aux dégâts liés à une application ou un usage inappropriés de ce produit, y compris, sans toutefois s'y limiter, des dommages directs ou indirects, ainsi que des dommages consécutifs, et rejette toute responsabilité quant à ces dommages dans la mesure où la loi applicable le permet. L'utilisateur est seul responsable de la vérification des risques d'application critiques et de la mise en place de mécanismes de protection des processus en cas de défaillance de l'équipement.

Lisez la totalité du manuel avant de déballer, d'installer ou d'utiliser cet appareil. Soyez particulièrement attentif à toutes les précautions et mises en garde. Le non-respect de cette procédure peut conduire à des blessures graves de l'opérateur ou à des dégâts matériels.

Si l'équipement est utilisé d'une manière qui n'est pas spécifiée par le fabricant, la protection fournie par l'équipement peut être altérée. Ne pas utiliser ou installer cet équipement autrement qu'indiqué dans le présent manuel.

#### 4.1.1 Informations sur les risques d'utilisation

##### ▲ DANGER

Indique une situation de danger potentiel ou imminent qui, si elle n'est pas évitée, entraîne des blessures graves, voire mortelles.

##### ▲ AVERTISSEMENT

Indique une situation de danger potentiel ou imminent qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

##### ▲ ATTENTION



Indique une situation de danger potentiel qui peut entraîner des blessures mineures ou légères.





##### AVIS

Indique une situation qui, si elle n'est pas évitée, peut occasionner l'endommagement du matériel. Informations nécessitant une attention particulière.


#### 4.1.2 Etiquettes de mise en garde

Lisez toutes les informations et toutes les étiquettes apposées sur l'appareil. Des personnes peuvent se blesser et le matériel peut être endommagé si ces instructions ne sont pas respectées. Tout symbole sur l'appareil renvoie à une instruction de mise en garde dans le manuel.

	Ceci est le symbole d'alerte de sécurité. Respectez tous les messages de sécurité qui suivent ce symbole afin d'éviter tout risque de blessure. S'ils sont apposés sur l'appareil, se référer au manuel d'utilisation pour connaître le fonctionnement ou les informations de sécurité.
	Ce symbole identifie un risque chimique et indique que seules les personnes qualifiées et formées pour travailler avec des produits chimiques sont autorisées à les manipuler ou à réaliser des opérations de maintenance sur les systèmes associés à l'équipement et utilisant des produits chimiques.






	Ce symbole indique qu'il existe un risque de choc électrique et/ou d'électrocution.
	Ce symbole indique la présence d'appareils sensibles aux décharges électrostatiques et indique que des précautions doivent être prises afin d'éviter d'endommager l'équipement.
	Ce symbole indique que l'élément marqué nécessite une connexion de protection à la terre. Si l'appareil n'est pas fourni avec une mise à la terre sur un cordon, effectuez la mise à la terre de protection sur la borne de conducteur de protection.
	Le matériel électrique portant ce symbole ne doit pas être mis au rebut dans les réseaux domestiques ou publics européens. Retournez le matériel usé ou en fin de vie au fabricant pour une mise au rebut sans frais pour l'utilisateur.

### 4.1.3 Sécurité chimique et biologique

<b>⚠ DANGER</b>	
	Dangers chimiques ou biologiques. Si cet instrument est utilisé pour la surveillance d'un procédé de traitement et/ou d'un système de dosage de réactifs chimiques auxquels s'appliquent des limites réglementaires et des normes de surveillance motivées par des préoccupations de santé et de sécurité publiques ou de fabrication et de transformation d'aliments ou de boissons, il est de la responsabilité de l'utilisateur de cet instrument de connaître et d'appliquer les normes en vigueur et d'avoir à sa disposition suffisamment de mécanismes pour s'assurer du bon respect de ces normes dans l'éventualité d'un dysfonctionnement de l'appareil.

## 4.2 Icônes utilisées dans les images

			
Pièces fournies par le fabricant	Pièces fournies par l'utilisateur	Regarder	Effectuer les étapes en sens inverse

				
Deux personnes nécessaires	Ecouter	Utiliser uniquement les doigts	Ne pas utiliser d'outils	Ne pas toucher

## 4.3 Usage prévu

Les analyseurs EZ de Hach sont destinés à être utilisés par des personnes qui doivent mesurer en continu plusieurs paramètres de qualité de l'eau dans des échantillons provenant d'applications industrielles et environnementales. Les analyseurs EZ de Hach ne traitent pas ou ne modifient pas l'eau et ne sont pas utilisés pour contrôler les procédures.

## 4.4 Liste de colisage

Assurez-vous d'avoir bien reçu tous les composants. Consultez la section [Figure 4](#) à la page 451. Si un élément est absent ou endommagé, contactez immédiatement le fabricant ou un représentant.

## Section 5 Installation

### ▲ DANGER



Dangers multiples. Seul le personnel qualifié doit effectuer les tâches détaillées dans cette section du document.

### 5.1 Conseils d'installation

#### ▲ AVERTISSEMENT



Risque d'incendie. L'utilisateur doit s'assurer de prendre les précautions nécessaires lors de l'utilisation de l'équipement avec des méthodes impliquant des liquides inflammables. Veillez à respecter les précautions d'utilisation et les protocoles de sécurité adéquats. Cela inclut, sans y être limité, le contrôle de tout déversement et de toute fuite, une ventilation appropriée, une utilisation contrôlée et la surveillance continue de l'instrument lorsqu'il est sous tension.

#### ▲ ATTENTION



Risque d'exposition chimique. Respectez les procédures de sécurité du laboratoire et portez tous les équipements de protection personnelle adaptés aux produits chimiques que vous manipulez. Consultez les fiches de données de sécurité (MSDS/SDS) à jour pour connaître les protocoles de sécurité applicables.

#### ▲ ATTENTION



Risque d'exposition chimique. Mettez au rebut les substances chimiques et les déchets conformément aux réglementations locales, régionales et nationales.

- Installez l'analyseur dans un environnement non dangereux, à l'intérieur.
- Installez l'analyseur dans un environnement protégé des liquides corrosifs.
- Installez l'analyseur dans un endroit propre, sec, bien ventilé et à température contrôlée.
- Installez l'analyseur le plus près possible du point d'échantillonnage.
- N'exposez pas l'analyseur aux rayons directs du soleil et ne l'installez pas à proximité d'une source de chaleur.
- Veillez à laisser suffisamment d'espace autour pour réaliser des raccordements de tuyauterie et électriques.
- Veillez à laisser suffisamment d'espace devant l'analyseur pour pouvoir ouvrir la porte. Consultez la section [Dimensions de l'analyseur](#) à la page 64.
- Assurez-vous que les conditions ambiantes sont conformes aux spécifications d'exploitation. Consultez la section [Spécifications](#) à la page 60.

Bien que l'analyseur ne soit pas conçu pour être utilisé avec des échantillons inflammables, certains analyseurs EZ utilisent des réactifs inflammables. Reportez-vous à la Method & Reagent Sheet (Fiche Méthode et réactif) applicable aux modèles de la série EZ pour obtenir plus d'informations sur les réactifs utilisés dans l'analyseur. Si l'analyseur utilise des réactifs inflammables, veillez à respecter les précautions de sécurité suivantes :

- tenez l'analyseur à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes nues ;
- ne mangez, ne buvez ou ne fumez pas à proximité de l'analyseur ;
- utilisez un système de ventilation d'échappement local ;
- utilisez des appareils à l'épreuve des étincelles et des déflagrations, ainsi qu'un système d'éclairage ;
- évitez les décharges électrostatiques. Consultez la section [Remarques relatives aux décharges électrostatiques \(ESD\)](#) à la page 64.
- nettoyez et séchez entièrement l'instrument avant utilisation ;
- lavez-vous les mains avant les pauses et à la fin de la période de travail ;
- retirez vos vêtements contaminés ; lavez vos les vêtements avant leur réutilisation ;

- la manipulation de ces liquides doit s'effectuer conformément aux exigences des organismes notifiés locaux et aux limites d'exposition autorisées.

## 5.2 Dimensions de l'analyseur

Consultez la section [Figure 5](#) à la page 454 pour connaître les dimensions de l'analyseur.

## 5.3 Installation mécanique

### 5.3.1 Montage de l'instrument sur un mur

#### ▲ AVERTISSEMENT



Risque de blessures corporelles. Vérifiez que le montage mural est capable de supporter 4 fois le poids de l'équipement.

#### ▲ AVERTISSEMENT



Risque de blessures corporelles. Les instruments ou les composants sont lourds. Ne pas installer ou déplacer seul.

#### ▲ AVERTISSEMENT



Risque de blessures corporelles. Cet objet est très lourd. Assurez-vous que l'instrument est correctement fixé au mur, à la table ou au sol pour garantir une utilisation en toute sécurité.

Utilisez les étriers de fixation fournis pour installer l'instrument en position verticale sur un mur plat et vertical. Consultez la section [Figure 6](#) à la page 456.

Installez l'instrument dans un endroit où l'utilisateur peut facilement le débrancher de la source d'alimentation.

Veillez à conserver un espace suffisant sous l'analyseur pour installer les flacons.

La visserie de montage est fournie par l'utilisateur. Assurez-vous que la capacité de charge de la fixation murale est suffisante (environ 160 kg ou 353 lbs). La visserie de montage doit être approuvée pour les propriétés du mur.

### 5.3.2 Ouverture de la porte de l'analyseur

Utilisez la clé fournie pour déverrouiller les deux verrous sur le côté de l'analyseur. Consultez la section [Figure 7](#) à la page 456. Assurez-vous de fermer la porte avant d'utiliser l'appareil afin de conserver l'indice environnemental du boîtier et l'indice de sécurité.

## 5.4 Installation électrique

### ▲ DANGER



Risque d'électrocution. Débranchez systématiquement l'alimentation de l'appareil avant tout branchement électrique.

### 5.4.1 Remarques relatives aux décharges électrostatiques (ESD)

#### AVIS



Dégât potentiel sur l'appareil. Les composants électroniques internes de l'appareil peuvent être endommagés par l'électricité statique, qui risque d'altérer ses performances et son fonctionnement.

Reportez-vous aux étapes décrites dans cette procédure pour éviter d'endommager l'appareil par des décharges électrostatiques.

- Touchez une surface métallique reliée à la terre (par exemple, le châssis d'un appareil, un conduit ou un tuyau métallique) pour décharger l'électricité statique de votre corps.
- Évitez tout mouvement excessif. Transportez les composants sensibles à l'électricité statique dans des conteneurs ou des emballages antistatiques.
- Portez un bracelet spécial relié à la terre par un fil.
- Travaillez dans une zone à protection antistatique avec des tapis de sol et des sous-mains antistatiques.

### 5.4.2 Entrées électriques

Passez les câbles des périphériques externes dans les passe-câbles. Consultez la section [Figure 8](#) à la page 458. Conservez les prises dans les passe-câbles qui ne sont pas utilisés.

La [Figure 9](#) à la page 461 montre les composants à l'intérieur de l'analyseur. L'interrupteur marche/arrêt est un disjoncteur qui coupe automatiquement l'alimentation principale de la ligne d'alimentation CA si une surintensité (un court-circuit par exemple) ou une surtension se produit.

### 5.4.3 Connexion des périphériques externes

Connectez les périphériques externes qui seront utilisés avec l'analyseur aux entrées de signal et de commande de l'analyseur. Reportez-vous aux sections [Figure 10](#) à la page 464 et [Tableau 1](#) à la page 65.

**Tableau 1 Entrées de signal et de commande—Descriptions**


Broche	Description
AO1–AO8 (P101)	Huit sorties analogiques pour contrôler des périphériques externes. Reportez-vous à la version détaillée du manuel d'utilisation en ligne pour en savoir plus.
FCT1–FCT5 (P102)	Cinq relais (contacts sans potentiel). La charge maximale est de 24 VCC, 0,5 A. <ul style="list-style-type: none"> <li>• FCT1—Alarme de dysfonctionnement</li> <li>• FCT2—Alarme de maintenance</li> <li>• FCT3—Analyseur prêt</li> <li>• FCT4 et FCT5—Pour utilisation ultérieure</li> </ul>
DI1–DI7 (P103)	Sept entrées numériques pour contrôler l'analyseur à distance <sup>5</sup> Connectez les entrées numériques à un contact externe sans potentiel (24 VCC) pour amener l'analyseur à démarrer une mesure pour un canal. <ul style="list-style-type: none"> <li>• DI1—Démarrage à distance pour le canal 1</li> <li>• DI2—Démarrage à distance pour le canal 2</li> <li>• DI3 à DI7—Pour utilisation ultérieure</li> </ul>

<sup>5</sup> Si l'analyseur est en mode maintenance, la commande à distance est désactivée.

**Tableau 1 Entrées de signal et de commande—Descriptions (suite)**

Broche	Description
FB1–FB4 (P104)	<p>Connecteurs Profibus DP ou Modbus RTU (RS485)</p> <p><b>Profibus DP :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FB1—A1 (entrée)</li> <li>• FB2—A2 (sortie)</li> <li>• FB3—B1 (entrée)</li> <li>• FB4—B2 (sortie)</li> <li>• SHL—Blindage</li> </ul> <p><b>Modbus RTU :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FB1—D (+)</li> <li>• FB2—D (-)</li> <li>• FB3—non utilisé</li> <li>• FB4—non utilisé</li> <li>• SHL—Blindage</li> </ul> <p>Reportez-vous à la documentation du transmetteur SC4500 pour les instructions de configuration Modbus et les étiquettes de Telegram.</p>
24 VCC/1A (P105)	Alimentation 24 VCC pour les unités de filtration EZ9010 et EZ9020
STR1–STR8 (P106)	<p>Huit sorties numériques pour le panneau Moduplex en option. Connectez les fils dénudés de chaque vanne de canal du panneau Moduplex aux connecteurs STR correspondants.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• STR1—Canal 1</li> <li>• STR2—Canal 2</li> <li>• ...</li> <li>• STR8—Canal 8</li> </ul>
EXT9–EXT12 (P107)	<p>Quatre sorties numériques pour le panneau de filtration EZ9150 en option. Connectez les vannes électriques et la pompe du panneau de filtration EZ9150 aux connecteurs EXT.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EXT9—Vanne de rinçage</li> <li>• EXT10—Vanne de rinçage à contre-courant</li> <li>• EXT11—Vanne de trop-plein de vidange</li> <li>• EXT12—Pompe de filtration</li> </ul>
D01–D06 (P108 et P109)	<p>Six sorties de vanne pneumatique pour le panneau EZ9150.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• D01—Vanne d'entrée d'échantillon</li> <li>• D02—Vanne de vidange de trop-plein</li> <li>• D03—Vanne de canal 1</li> <li>• D04—Vanne de canal 2</li> <li>• D05—Vanne de canal 3</li> <li>• D06—Vanne de canal 4</li> </ul>

#### 5.4.4 Branchement sur l'alimentation CA

<b>▲ DANGER</b>	
	Risque d'incendie et de choc électrique. Assurez-vous que le cordon et la fiche non verrouillable fournis sont conformes aux normes du pays concerné.

- Assurez-vous qu'un disjoncteur d'une capacité suffisante est installé sur la ligne d'alimentation.


- Assurez-vous que le disjoncteur ou un interrupteur d'urgence est installé près de l'analyseur afin que l'analyseur puisse être immédiatement déconnecté de l'alimentation électrique si nécessaire.
- Raccordez l'équipement conformément aux codes électriques locaux ou nationaux.
- Faites passer le cordon d'alimentation fourni par le passe-câble situé sur le côté de l'analyseur.
- Serrez le passe-câble pour sécuriser le cordon d'alimentation et maintenir l'indice environnemental du boîtier.

Branchez l'analyseur sur le secteur à l'aide du cordon d'alimentation CA fourni. Consultez les sections [Tableau 2](#) à la page 67 et [Figure 11](#) à la page 468.

## AVIS

Ne mettez pas l'interrupteur d'alimentation en position marche. Effectuez tous les raccordements électriques et de tuyauterie avant le démarrage, sous peine d'endommager l'analyseur.

**Tableau 2 Informations de câblage : alimentation AC**

Borne	Description	Couleur du câble - Amérique du Nord et Canada	Couleur du câble - UE
L	Phase (L)	Noir (1)	Marron
N	Neutre (N)	Blanc (2)	Bleu
	Mise à la terre de protection (PE)	Vert avec des bandes jaunes	Vert avec des bandes jaunes

## 5.5 Plomberie

### 5.5.1 Directives de conduite d'échantillonnage

#### ⚠ ATTENTION



Risque d'incendie. Ce produit n'est pas adapté à l'utilisation avec des échantillons inflammables.

Choisissez un point d'échantillonnage adapté et représentatif pour garantir le fonctionnement optimal de l'instrument. L'échantillon doit être représentatif de l'ensemble du système.

- Assurez-vous que le débit d'échantillonnage est plus élevé que le débit vers l'analyseur.
- Assurez-vous que la conduite d'échantillonnage est à la pression atmosphérique si l'analyseur utilise une pompe péristaltique pour déplacer l'échantillon dans la cuve d'analyse.
- Assurez-vous que la conduite d'échantillonnage collecte l'échantillon d'une petite cuve de trop-plein près de l'analyseur.
- Utilisez la ligne d'échantillonnage fournie. Ne modifiez pas la longueur de la ligne d'échantillonnage.

L'échantillon dans la cuve de trop-plein doit être continuellement renouvelé. Si les solides dans l'échantillon sont trop gros, il est recommandé de filtrer l'échantillon.

### 5.5.2 Instructions des conduites d'évacuation

#### ⚠ AVERTISSEMENT



Risque d'incendie. L'utilisateur doit s'assurer de prendre les précautions nécessaires lors de l'utilisation de l'équipement avec des méthodes impliquant des liquides inflammables. Veillez à respecter les précautions d'utilisation et les protocoles de sécurité adéquats. Cela inclut, sans y être limité, le contrôle de tout déversement et de toute fuite, une ventilation appropriée, une utilisation contrôlée et la surveillance continue de l'instrument lorsqu'il est sous tension.

## ⚠ ATTENTION



Risque d'exposition chimique. Mettez au rebut les substances chimiques et les déchets conformément aux réglementations locales, régionales et nationales.

## AVIS

Ne raccordez pas les conduites d'évacuation aux autres conduites afin d'éviter l'accumulation de contre-pression ou d'endommager l'analyseur. Veillez à ce que les conduites d'évacuation débouchent à l'air libre.

## AVIS

Pour éviter tout risque de contre-pression ou d'endommagement de l'analyseur, l'analyseur doit être installé à une hauteur supérieure aux bouches d'évacuation utilisées et la conduite d'évacuation doit suivre une pente descendante régulière. Installez les conduites d'évacuation avec un décalage vertical de 2,54 cm (1") ou plus vers le bas tous les 0,3 m (1 pi) de longueur de tuyau.

L'analyseur utilise la conduite d'évacuation pour évacuer l'échantillon et les réactifs après l'analyse. Il est important d'installer correctement les conduites d'évacuation afin de s'assurer que tout le liquide est éliminé de l'instrument. Une installation incorrecte peut entraîner le retour du liquide dans l'instrument et causer des dommages. Un plancher ou un évier est suffisant pour la conduite d'évacuation. Le diamètre externe recommandé pour le tuyau d'évacuation est de 32 mm. Consultez la section [Figure 12](#) à la page 470.

- Faites les conduites d'évacuation aussi courtes que possible.
- Assurez-vous que la bouche d'évacuation est plus basse que l'analyseur.
- Assurez-vous que les conduites d'évacuation ont une pente constante vers le bas.
- Assurez-vous que les conduites d'évacuation ne sont ni pliées ni pincées.
- Assurez-vous que les conduites d'évacuation sont à découvert et ne sont pas sous pression.
- Assurez-vous que les conduites de vidange sont isolées de la température ambiante du local d'installation.
- Ne pas bloquer ou immerger la conduite d'évacuation.

Un raccord d'eau est également recommandé près de l'analyseur afin que l'évier et le tuyau d'évacuation soient régulièrement rincés avec de l'eau propre pour éviter les obstructions par cristallisation.

Reportez-vous à la Method & Reagent Sheet (Fiche Méthode et réactif) applicable aux modèles de la série EZ pour obtenir plus d'informations sur les réactifs utilisés dans l'analyseur. Si l'analyseur utilise des réactifs inflammables, veillez à respecter les précautions de sécurité suivantes :

- ne raccordez pas la conduite de vidange à un drain de plancher ;
- éliminez les déchets conformément aux réglementations locales, d'état et nationales en matière de protection de l'environnement.

### 5.5.3 Consignes relatives à la conduite d'aération

## ⚠ AVERTISSEMENT



Risque d'incendie. L'utilisateur doit s'assurer de prendre les précautions nécessaires lors de l'utilisation de l'équipement avec des méthodes impliquant des liquides inflammables. Veillez à respecter les précautions d'utilisation et les protocoles de sécurité adéquats. Cela inclut, sans y être limité, le contrôle de tout déversement et de toute fuite, une ventilation appropriée, une utilisation contrôlée et la surveillance continue de l'instrument lorsqu'il est sous tension.

## ⚠ ATTENTION



Risque d'exposition chimique. Mettez au rebut les substances chimiques et les déchets conformément aux réglementations locales, régionales et nationales.

## AVIS

Ne raccordez pas la conduite d'aération (évacuation des gaz d'échappement) aux autres conduites afin d'éviter l'accumulation de contre-pression ou d'endommager l'analyseur. Assurez-vous que la conduite d'aération est ouverte à l'extérieur du bâtiment.

## AVIS

Pour éviter tout risque de contre-pression ou d'endommagement de l'analyseur, l'analyseur doit être installé à une hauteur supérieure aux bouches d'aération utilisées et la conduite d'aération doit suivre une pente descendante régulière. Installez la conduite d'aération avec un décalage vertical de 2,54 cm (1") ou plus vers le bas tous les 0,3 m (1 pi) de longueur de tuyau.

L'analyseur utilise la conduite d'aération pour maintenir la cuve d'analyse à la pression atmosphérique. Il est important d'installer correctement la conduite d'aération pour s'assurer qu'aucun liquide ne pénètre dans la cuve d'analyse par la conduite d'aération pendant le fonctionnement de la pompe. Une installation incorrecte peut entraîner un retour de gaz dans l'analyseur et l'endommager. Le diamètre extérieur recommandé pour le tube d'en-tête de la conduite d'aération est de 32 mm. Consultez la section [Figure 12](#) à la page 470.

- La conduite d'aération doit être aussi courte que possible.
- Assurez-vous que la conduite d'aération est en pente constante vers le bas.
- Assurez-vous que la conduite d'aération n'est ni trop courbée ni pincée.
- Assurez-vous que la conduite d'aération est isolée de l'environnement ambiant du local d'installation et qu'elle présente une pression nulle.
- Assurez-vous que la conduite d'aération est toujours plus haute que l'évacuation.
- Ne bloquez pas ou n'immergez pas la conduite d'aération.

Si l'analyseur utilise des réactifs inflammables, veillez à respecter les précautions de sécurité suivantes :

- ne raccordez pas la conduite d'aération à un drain de plancher ;
- éliminez les déchets conformément aux réglementations locales, d'état et nationales en matière de protection de l'environnement.

### 5.5.4 Raccordement de l'analyseur pour le test des composants



#### ⚠ ATTENTION



Risque d'incendie. Ce produit n'est pas adapté à l'utilisation avec des liquides inflammables.

Avant que l'analyseur avec tous ses réactifs soit mis en fonctionnement, un test des composants avec de l'eau désionisée doit être réalisé. Reportez-vous aux étapes illustrées et à la section [Tests des composants](#) à la page 73.

1. Installez les quatre tuyaux de la vanne à pincement comme indiqué dans l'illustration de l'étape 1 qui suit.
  - a. Appuyez sur le bouton noir, puis introduisez le tuyau dans la vanne.
  - b. Relâchez le bouton lorsque le tuyau est correctement installé.
2. Assurez-vous que les tuyaux de vidange sont correctement installés dans la cuve d'échantillon. Reportez-vous à l'illustration de l'étape 2 ci-après.
3. Assurez-vous que les tuyaux de digesteur sont correctement installés dans la cuve d'échantillon. Reportez-vous à l'illustration de l'étape 3 ci-après.
4. Raccordez tous les tuyaux de liquide de l'analyseur à un grand flacon d'eau désionisée pour tester les composants. Reportez-vous à l'illustration de l'étape 3 ci-après. Les tuyaux sont installés en usine.

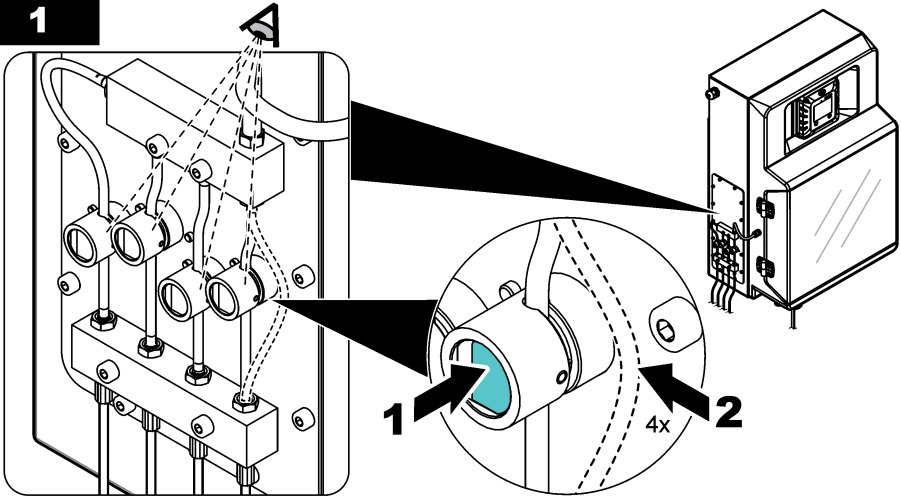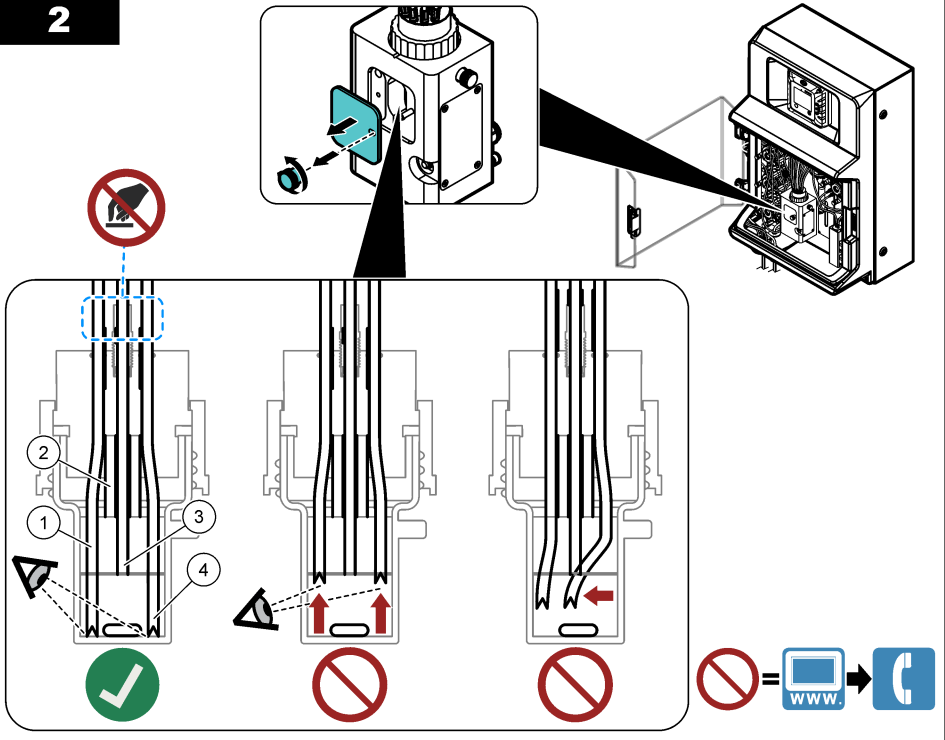**1****2**




1 Tuyau d'évacuation

3 Tuyau d'échantillon

2 Tuyaux de réactifs et d'aération (tuyau supérieur)

4 Tuyau de digesteur

3

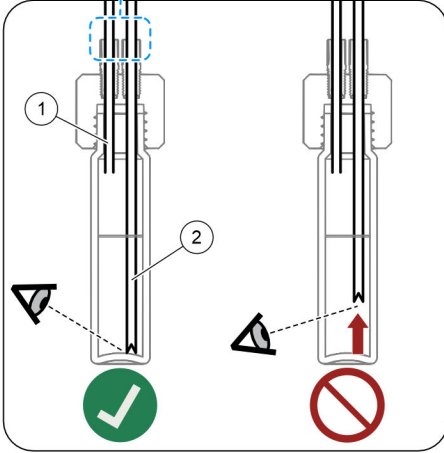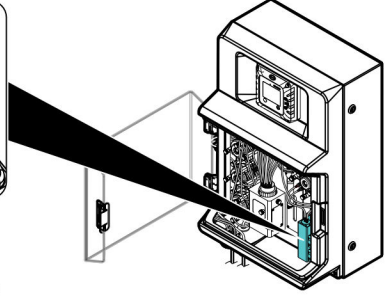


FR

1 Tuyau d'aération

2 Tuyau de digesteur

4

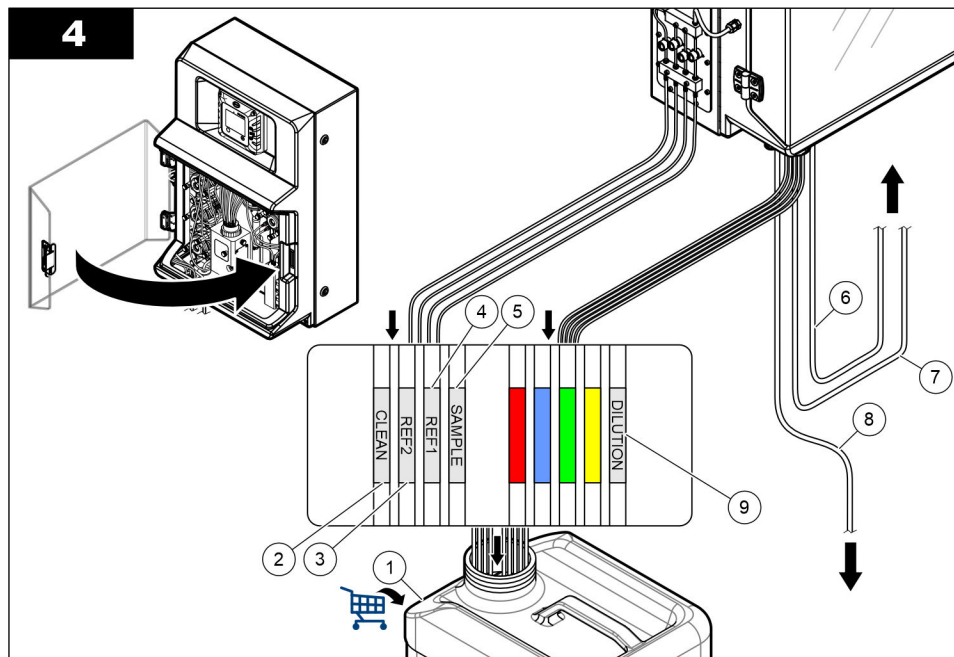

1 Eau désionisée	4 Tuyau de solution de référence 1 (REF1)	7 Mise à l'air libre du digesteur
2 Tuyau de solution de nettoyage	5 Tube d'entrée d'échantillon	8 Tuyau d'évacuation
3 Tuyau de solution de référence 2 (REF2)	6 Tuyau d'aération	9 Tuyaux de micropompe de dilution et de réactif

## Section 6 Mise en marche

### 6.1 Démarrage initial

**Remarque :** Assurez-vous que le montage, la tuyauterie et les installations électriques sont entièrement terminés avant de procéder au démarrage. Consultez la section [Installation](#) à la page 63.

Lorsque l'analyseur est mis en marche pour la première fois, un assistant de démarrage aidera à effectuer les premières étapes pour procéder à la configuration. Effectuez toutes les étapes suivantes pour vous assurer que l'analyseur fonctionne correctement.

**Remarque :** Veillez à utiliser les réactifs appropriés pour la gamme de mesure sélectionnée. Reportez-vous à la version détaillée du manuel d'utilisation en ligne pour en savoir plus.

- Ouvrez la porte de l'analyseur. Consultez la section [Ouverture de la porte de l'analyseur](#) à la page 64.
- Mettez l'interrupteur d'alimentation en position marche. Consultez la section [Figure 9](#) à la page 461.
- Fermez la porte de l'analyseur avec la clé fournie.
- Patiencez jusqu'à la fin de la procédure d'initialisation.
- Suivez les invites à l'écran pour sélectionner la langue, le fuseau horaire, la date et l'heure.  
Pour configurer les autres paramètres du transmetteur, reportez-vous à la documentation du transmetteur SC4500.
- Appuyez sur l'écran pour afficher le menu **EZ2700sc**.

7. Sélectionnez **Device menu (Menu de l'appareil)** pour faire démarrer l'assistant. L'écran d'accueil s'affiche.
8. Effectuez les étapes affichées à l'écran pour sélectionner la plage de mesure applicable. Appuyez sur **OK**.
9. Si une unité de filtration est installée, sélectionnez **Activé**. Sinon, sélectionnez **Désactivé**.
10. Sélectionnez le nombre de canaux pour l'analyseur. Appuyez sur **OK**.
11. Si la configuration affichée sur la page de résumé est correcte, appuyez sur **OK**. Le menu principal **EZ2700sc** s'affiche.
12. Poursuivez avec le test des composants. Consultez la section [Tests des composants](#) à la page 73.

## 6.2 Tests des composants

### ⚠ AVERTISSEMENT



Risque de pincement. Les pièces mobiles peuvent être à l'origine de pincements et provoquer des blessures. Ne touchez pas les pièces mobiles.

Effectuez les tests des composants avant la mise en marche de l'analyseur. Utilisez le menu **Entretien** pour lancer les différentes fonctions de l'analyseur afin d'examiner le fonctionnement des composants.

#### Prérequis :

- Si l'analyseur est en mode de fonctionnement, sélectionnez **Entretien > Start maintenance mode (Démarrer le mode maintenance)**.
- Assurez-vous que les tuyaux de l'échantillon, du réactif et de la solution se trouvent dans un récipient contenant de l'eau désionisée. Consultez la section [Raccordement de l'analyseur pour le test des composants](#) à la page 69.

#### 6.2.1 Examen de l'agitateur

1. Retirez l'écran protecteur de lumière de l'unité photométrique. Consultez la section [Figure 13](#) à la page 472.
2. Assurez-vous que l'agitateur est au fond de la cuve d'échantillon.  
*Remarque : Examinez l'agitateur pendant la procédure d'amorçage pour vous assurer qu'il tourne correctement. La procédure d'amorçage est abordée dans [Examen des pompes et des vannes à pincement](#) à la page 73.*
3. Installez l'écran protecteur de lumière sur le photomètre.

#### 6.2.2 Examen des pompes et des vannes à pincement

1. Examinez le fonctionnement des pompes et des vannes à pincement pour vous assurer qu'il n'y a pas de fuites.
2. Assurez-vous que la cuve d'analyse se remplit d'eau désionisée. Consultez la section [Figure 14](#) à la page 474.
3. Veillez à ce que l'eau désionisée soit évacuée par le tuyau de vidange.
4. Sélectionnez **Entretien > Start priming (Démarrer l'amorçage)** et amorcez tous les liquides séparément.

Si une fuite se produit, examinez tous les raccords et reportez-vous à la version détaillée du manuel d'utilisation en ligne pour en savoir plus.

- a. Sélectionnez **Amorcer la référence 1** et appuyez sur **OK**.
- b. Sélectionnez **Amorcer la référence 2** et appuyez sur **OK**.
- c. Sélectionnez **Amorcer la solution de nettoyage** et appuyez sur **OK**.
- d. Sélectionnez **Amorcer le rinçage** et appuyez sur **OK**.

- e. Sélectionnez **Amorcer le distributeur** et appuyez sur **OK**.
- f. Sélectionnez **Amorcer le canal** > **Amorcer tous les canaux** et appuyez sur **OK**.  
Chaque procédure d'amorçage s'arrête automatiquement une fois terminée.

### 6.2.3 Examen des micropompes

Examinez les micropompes pour détecter d'éventuelles fuites ou bulles d'air.

1. Retirez l'écran protecteur de lumière du photomètre.
2. Sélectionnez **Entretien** > **Start priming (Démarrer l'amorçage)** > **Amorcer tous les réactifs**.
3. Veillez à ce que l'eau désionisée pénètre dans la micropompe par chacun des tuyaux (de réactif) de la micropompe, puis dans la cuve d'analyse, en continu et sans bulles d'air. Consultez la section [Figure 15](#) à la page 475.
4. Si les micropompes ne fonctionnent pas correctement (bulles dans les tuyaux), utilisez la procédure de la seringue pour pousser de l'eau désionisée dans les tuyaux concernés afin d'éliminer les bulles. Consultez la section [Figure 16](#) à la page 476.
5. Installez l'écran protecteur de lumière sur le photomètre.

### 6.2.4 Procédure de contrôle du photomètre

Assurez-vous que la surface externe de la cuve d'analyse est propre avant le contrôle du photomètre afin de pouvoir procéder à celui-ci correctement. Pour plus d'informations sur le nettoyage des composants de l'analyseur, reportez-vous à la version détaillée du manuel d'utilisation, disponible en ligne.

1. Appuyez sur l'icône de menu principal, puis sélectionnez **Devices (Appareils)**.
2. Sélectionnez **EZ2700sc**.
3. Descendez jusqu'en bas de l'écran, puis sélectionnez **Device menu (Menu de l'appareil)**.
4. Sélectionnez **Entretien** > **Contrôle du photomètre**.
5. Appuyez sur **OK** pour démarrer la mesure.  
Lorsque l'étalonnage de la valeur sombre est terminé, le résultat s'affiche à l'écran.
6. Appuyez sur **OK** pour continuer.
7. Assurez-vous que le tuyau « REF1 » est relié à un récipient rempli d'eau désionisée. Assurez-vous que l'écran protecteur de lumière est installé. Consultez la section [Figure 18](#) à la page 478.
8. Appuyez sur **OK**.  
Attendez que la cuve d'analyse soit remplie.
9. Utilisez un tournevis pour régler la tension de la sortie du capteur à 9 V. Reportez-vous à [Figure 17](#) à la page 476.
10. Attendez que la valeur 9 V s'affiche à l'écran. Ensuite, appuyez sur **OK**.
11. Appuyez sur **OK** pour continuer.

## 6.3 Procédure de test de signal d'entrée

Procédez à un test des entrées numériques avant d'utiliser l'analyseur.

**Prérequis** : branchez les entrées numériques à un contact externe libre de potentiel (24 VCC).

Testez le signal d'entrée numérique et le signal de sortie analogique comme suit :

1. Appuyez sur l'icône du menu principal, puis sélectionnez **Appareils**.
2. Sélectionnez **EZ2700sc**.
3. Descendez jusqu'en bas de l'écran, puis sélectionnez **Device menu (Menu de l'appareil)**.
4. Sélectionnez **Diagnostics (Diagnostics)** > **Signaux**.

Les signaux des entrées numériques s'affichent.

5. Comparez le statut des entrées numériques sur l'écran aux tensions fournies aux entrées numériques (24 V = Activé ; 0 V = Désactivé).

## 6.4 Procédure de test de signal de sortie

Procédez à un test des sorties analogiques avant d'utiliser l'analyseur.

**Prérequis** : configurez les sorties analogiques (AO1–AO8, P101) pour sélectionner la mesure du canal représentée par chaque sortie analogique. Reportez-vous à la version détaillée du manuel d'utilisation en ligne pour en savoir plus.

Testez le signal de sortie analogique comme suit :

1. Appuyez sur l'icône du menu principal.
2. Sélectionnez **Sorties > Sorties mA AOC > Test/Maintenance**.

Option	Description
Vérification du fonctionnement	Effectue un test sur les sorties du module sélectionné.
Etat de la sortie	Affiche l'état des sorties du module sélectionné.

3. Utilisez un multimètre pour mesurer la valeur en mA à chaque sortie analogique.
4. Comparez la valeur mA mesurée aux sorties analogiques aux valeurs mA attendues.

## 6.5 Réglage de la séquence de canaux


Sélectionnez la séquence selon laquelle les canaux sont mesurés, le nombre de fois que chaque canal est mesuré et le délai d'attente avant qu'un canal ne soit mesuré. Saisissez un maximum de 16 lignes avec un maximum de 16 cycles chacune.

1. Appuyez sur l'icône de menu principal, puis sélectionnez **Devices (Appareils)**.
2. Sélectionnez **EZ2700sc**.
3. Descendez jusqu'en bas de l'écran, puis sélectionnez **Device menu (Menu de l'appareil)**.
4. Si l'analyseur est en mode de fonctionnement, sélectionnez **Entretien > Start maintenance mode (Démarrer le mode maintenance)**.  
Patientez jusqu'à ce que l'analyseur soit en mode de maintenance.
5. Sélectionnez **Configuration > Configuration de la séquence de canaux**.
6. Utilisez les flèches de la barre latérale pour sélectionner une position (numéro dans la séquence), puis appuyez sur **OK** pour configurer cette position.
7. Sélectionnez une option.

Option	Description
Sélectionner	Sélectionne le canal ou le délai d'attente applicable.
Number of measurements (Nombre de mesures)	Définit le nombre de mesures pour un canal.
Délai d'attente	Définit le délai d'attente pour le canal sélectionné.

8. Appuyer sur **OK** pour enregistrer les modifications.

## 6.6 Branchement des solutions et de l'échantillon

▲ ATTENTION	
	Risque d'exposition chimique. Respectez les procédures de sécurité du laboratoire et portez tous les équipements de protection personnelle adaptés aux produits chimiques que vous manipulez. Consultez les fiches de données de sécurité (MSDS/SDS) à jour pour connaître les protocoles de sécurité applicables.

## ⚠ ATTENTION



Risque d'exposition chimique. Mettez au rebut les substances chimiques et les déchets conformément aux réglementations locales, régionales et nationales.

## ⚠ ATTENTION



Risque d'incendie. Ce produit n'est pas adapté à l'utilisation avec des liquides inflammables.

Les récipients de réactif sont fournis avec l'analyseur. Consultez la section [Figure 18](#) à la page 478. Les récipients pour la solution Référence 1 et la solution Référence 2 ainsi que l'eau déionisée doivent être fournis par l'utilisateur. Il est possible d'acheter des récipients supplémentaires auprès du fabricant.

Installez les récipients

- aussi près que possible de l'analyseur
- 1 mètre sous le fond de l'analyseur

Reportez-vous à [Figure 18](#) à la page 478 pour l'installation du récipient.

Les réactifs et les solutions doivent être fournis par l'utilisateur. Utilisez uniquement des réactifs fournis par une société certifiée ou utilisez des réactifs spécifiques au fabricant. Les réactifs peuvent également être préparés par l'utilisateur. Suivez les instructions de la Method & Reagent Sheet (Fiche Méthode et réactif) applicable au modèle, disponible sur le site Web du fabricant.

Les tuyaux sont installés en usine. Lire l'étiquette sur chaque tuyau pour identifier le bon raccord de tuyauterie. Reportez-vous à la Method & Reagent Sheet (Fiche Méthode et réactif) applicable au modèle disponible sur le site Web du fabricant pour connaître les réactifs, solutions et étalons appropriés.

1. Une fois les tests des composants effectués, installez les tuyaux « CLEAN » (solution de nettoyage), « REF1 » (solution de référence 1) et « REF2 » (solution de référence 2) dans les récipients correspondants. Consultez la section [Figure 18](#) à la page 478.
2. Installez chaque tuyau de réactif codé par couleur dans le récipient de réactif étiqueté de la couleur correspondante.
3. Raccordez la source d'échantillon (ou la sortie d'échantillon du panneau Moduplex ou du panneau du filtre) au tuyau d'entrée d'échantillon de l'analyseur. Reportez-vous à la [Figure 18](#) à la page 478.
4. Appuyez sur l'icône de menu principal, puis sélectionnez **Devices (Appareils)**.
5. Sélectionnez **EZ2700sc**.
6. Descendez jusqu'en bas de l'écran, puis sélectionnez **Device menu (Menu de l'appareil)**.
7. Sélectionnez **Entretien > Start priming (Démarrer l'amorçage) > Amorcer tous**.

## 6.7 Effectuer une validation avant le démarrage initial

Effectuez une validation pour vous assurer que les mesures se situent dans la plage de tolérance. Reportez-vous à la version détaillée du manuel d'utilisation en ligne pour en savoir plus.

1. Appuyez sur l'icône de menu principal, puis sélectionnez **Devices (Appareils)**.
2. Sélectionnez **EZ2700sc**.
3. Descendez jusqu'en bas de l'écran, puis sélectionnez **Device menu (Menu de l'appareil)**.
4. Pour lancer une validation, sélectionnez **Etalonnage > Validation (Validation) > Démarrer la validation**.

La validation mesure l'eau désionisée dans le flacon de Référence 2.

5. Pour afficher les résultats, sélectionnez une option :

- **Etalonnage > Validation (Validation) > Validation history (Historique de validation)**
- **Diagnostics (Diagnostics) > Historique > Validation (Validation)**

## 6.8 Démarrez l'analyseur

Pour démarrer l'analyseur :

1. Appuyez sur l'icône de menu principal, puis sélectionnez **Devices (Appareils)**.
2. Sélectionnez **EZ2700sc**.
3. Descendez jusqu'en bas de l'écran, puis sélectionnez **Device menu (Menu de l'appareil)**.
4. Sélectionnez **Entretien > Start operational mode (Démarrer le mode de fonctionnement)**.

FR

## Tabla de contenidos

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| 1 Información adicional en la página 78            | 4 Información general en la página 80 |
| 2 Descripción general del producto en la página 78 | 5 Instalación en la página 82         |
| 3 Especificaciones en la página 79                 | 6 Puesta en marcha en la página 91    |

## Sección 1 Información adicional

El manual básico del usuario contiene información suficiente para la puesta en marcha. Hay disponible en Internet un manual del usuario ampliado que contiene información adicional.

### ⚠ PELIGRO



Peligros diversos. Encontrará más información en las secciones individuales del manual del usuario ampliado que se muestran a continuación.

- Interfaz del usuario y navegación
- Funcionamiento
- Mantenimiento
- Solución de problemas
- Listas de piezas de repuesto

Escanee los códigos QR que aparecen a continuación para ir al manual de usuario ampliado.



Lenguas europeas



Idiomas americanos y asiáticos

## Sección 2 Descripción general del producto

El analizador EZ2700sc de Hach es un analizador en línea que mide un parámetro en muestras de agua de aplicaciones industriales. Consulte [Figura 1](#) en la página 438, [Figura 2](#) en la página 441 y [Figura 3](#) en la página 446.

Se trata de un analizador colorimétrico en línea para el análisis general de agua (p. ej., nitrato, fosfato). El analizador tiene opciones para arranque remoto, validación automática, calibración automática, limpieza automática y Modbus.

El agua de muestra entra en el analizador a través del tubo de muestra. Las bombas, válvulas y jeringas del analizador transportan la muestra y los reactivos a la celda de medición del panel de analítica. Una vez completado el proceso de análisis en el vaso, el analizador desecha la muestra por el tubo de drenaje. Los resultados del análisis se muestran en la pantalla del controlador SC4500. El controlador SC4500 guarda los datos del analizador (registro de datos, eventos, configuración y servicio). Utilice el controlador SC4500 para utilizar y configurar el analizador.

Para aumentar el número de corrientes de muestra (canales) que el analizador puede medir (2, 4 u 8), adquiera el panel de varias corrientes Moduplex con el analizador.

Para preacondicionar la muestra (filtración, sedimentación), adquiera el panel de filtración EZ9010, EZ9020, EZ9150, EZ9200 o EZ9250 con el analizador.

## Sección 3 Especificaciones

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Especificación	Detalles
Dimensiones (An. x Al. x Pr.)	460 x 688 x 340 mm (18,1 x 27,1 x 13,4 pulg.)
Carcasa	IP44, ABS, PMMA y acero revestido
Pantalla	IP66, pantalla TFT a color de 3,5 pulgadas con pantalla táctil capacitiva
Peso	40 kg (88 lb)
Requisitos de alimentación	De 100 a 240 V CA, $\pm 10\%$ , 50/60 Hz
Consumo de energía	240 VA máximo
Altitud	2000 m (6560 pies) máximo
Categoría de sobretensión	II
Condiciones ambientales	Sólo para uso en interiores
Grado de contaminación	2
Temperatura de funcionamiento	10 a 30 °C (50 a 86 °F), del 5 al 95 % de humedad relativa, sin condensación, sin corrosión
Temperatura de almacenamiento	De -20 a 60 °C (de -4 a 140 °F); humedad relativa máxima del 95 %, sin condensación
Entradas de muestra	Una
Presión de la muestra	Mediante un recipiente de rebose externo (abierto a la presión atmosférica)
Caudal de muestra	De 100 a 300 mL/min
Temperatura de la muestra	De 10 a 30 °C (50 a 86 °F)
Calidad de la muestra	Partículas < 100 $\mu\text{m}$ , < 0,1 g/L como máximo Turbidez < 50 NTU
Purga de aire para entornos corrosivos	0,2 bar (20 kPa o 3 psi); aire seco y limpio
Drenaje	Presión atmosférica, ventilado, $\varnothing$ mínimo: 32 mm
Conexión a tierra	Polo de conexión a tierra de baja impedancia (< 1 $\Omega$ ) seco y limpio, con un cable de tierra de > 2,5 mm <sup>2</sup> (13 AWG)
Salidas analógicas	Ocho salidas analógicas de 0-20 mA (o 4-20 mA) como máximo <i>Nota: Las salidas analógicas suministran la alimentación en bucle. La alimentación no puede suministrarse a los contactos del sistema SCADA o PLC.</i>
Entradas digitales	Siete entradas digitales: Dos entradas digitales para arranque remoto. Las entradas digitales restantes son para uso futuro.
Salidas digitales	Cuatro salidas digitales energizadas para las válvulas y las bombas del panel EZ9150; ocho salidas digitales energizadas para las válvulas del panel Mod duplex; 24 V CC, 500 mA.
Relés	Cinco contactos libres de tensión (FCT), carga máxima: 24 V CC, 0,5 A (carga resistiva)
Conexiones Ethernet	Conexión Ethernet Claros y conector Ethernet Modbus TCP/IP; versión LAN; 10/100 Mbps, o Profinet o Ethernet IP

ES

<sup>2</sup> Para obtener información sobre la configuración de Ethernet y Modbus, consulte la documentación del controlador SC4500.

Especificación	Detalles
Comunicaciones RS485	Profibus DP o Modbus RTU
Certificaciones	Certificación CE y ETL conforme a las normas de seguridad UL y CSA, UKCA
Garantía	1 año (UE: 2 años)

## Sección 4 Información general

El fabricante no será responsable en ningún caso de los daños resultantes de un uso inadecuado del producto o del incumplimiento de las instrucciones del manual. El fabricante se reserva el derecho a modificar este manual y los productos que describen en cualquier momento, sin aviso ni obligación. Las ediciones revisadas se encuentran en la página web del fabricante.

### 4.1 Información de seguridad

El fabricante no es responsable de ningún daño debido a un mal uso de este producto incluyendo, sin limitación, daños directos, fortuitos o circunstanciales y reclamaciones sobre los daños que no estén recogidos en la legislación vigente. El usuario es el responsable de la identificación de los riesgos críticos y de tener los mecanismos adecuados de protección de los procesos en caso de un posible mal funcionamiento del equipo.

Sírvase leer todo el manual antes de desembalar, instalar o trabajar con este equipo. Preste especial atención a todas las indicaciones de peligro y advertencia. El no hacerlo puede provocar heridas graves al usuario o daños al equipo.

Si el equipo se utiliza de una manera no especificada por el fabricante, la protección proporcionada por el equipo puede verse afectada. No use o instale este equipo de una manera diferente a la explicada en este manual.

#### 4.1.1 Uso de la información relativa a riesgos

##### ▲ PELIGRO

Indica una situación potencial o de riesgo inminente que, de no evitarse, provocará la muerte o lesiones graves.

##### ▲ ADVERTENCIA

Indica una situación potencial o inminentemente peligrosa que, de no evitarse, podría provocar la muerte o lesiones graves.

##### ▲ PRECAUCIÓN

Indica una situación potencialmente peligrosa que podría provocar una lesión menor o moderada.

##### AVISO

Indica una situación que, si no se evita, puede provocar daños en el instrumento. Información que requiere especial énfasis.

#### 4.1.2 Etiquetas de precaución





Lea todas las etiquetas y rótulos adheridos al instrumento. En caso contrario, podrían producirse heridas personales o daños en el instrumento. El símbolo que aparezca en el instrumento se comentará en el manual con una declaración de precaución.




Este es un símbolo de alerta de seguridad. Obedezca todos los mensajes de seguridad que se muestran junto con este símbolo para evitar posibles lesiones. Si se encuentran sobre el instrumento, consulte el manual de instrucciones para obtener información de funcionamiento o seguridad.



Este símbolo identifica un peligro químico e indica que el trabajo se debe ejecutar exclusivamente por personal cualificado y entrenados en el manejo de productos químicos, el cual debe realizar también los trabajos de mantenimiento en el sistema de alimentación de productos químicos asociado con este equipo.

	Este símbolo indica que hay riesgo de descarga eléctrica y/o electrocución.
	Este símbolo indica la presencia de dispositivos susceptibles a descargas electrostáticas. Asimismo, indica que se debe tener cuidado para evitar que el equipo sufra daño.
	Este símbolo indica que el objeto marcado requiere una toma a tierra de seguridad. Si el instrumento no se suministra con un cable con enchufe de toma a tierra, realice la conexión a tierra de protección al terminal conductor de seguridad.
	En Europa, el equipo eléctrico marcado con este símbolo no se debe desechar mediante el servicio de recogida de basura doméstica o pública. Devuelva los equipos viejos o que hayan alcanzado el término de su vida útil al fabricante para su eliminación sin cargo para el usuario.

### 4.1.3 Seguridad química y biológica

<b>⚠ PELIGRO</b>	
	Peligro químico o biológico. Si este instrumento se usa para controlar un proceso de tratamiento y/o un sistema de suministro químico para el que existan límites normativos y requisitos de control relacionados con la salud pública, la seguridad pública, la fabricación o procesamiento de alimentos o bebidas, es responsabilidad del usuario de este instrumento conocer y cumplir toda normativa aplicable y disponer de mecanismos adecuados y suficientes que satisfagan las normativas vigentes en caso de mal funcionamiento del equipo.

### 4.2 Iconos usados en las ilustraciones

			
Piezas suministradas por el fabricante	Piezas suministradas por el usuario	Observe	Realice los pasos en orden inverso
			
Requiere dos personas	Escuche	Use solo los dedos	No use herramientas
			
			No tocar

### 4.3 Uso previsto

Los analizadores de la serie EZ de Hach están diseñados para que los utilicen las personas encargadas de la medición continua de parámetros de calidad del agua en muestras de aplicaciones industriales y medioambientales. Los analizadores de la serie EZ de Hach no tratan ni alteran el agua y tampoco se utilizan para el control de procedimientos.

### 4.4 Componentes del producto

Asegúrese de que ha recibido todos los componentes. Consulte [Figura 4](#) en la página 450. Si faltan artículos o están dañados, contacte con el fabricante o el representante de ventas inmediatamente.

## Sección 5 Instalación

### ▲ PELIGRO



Peligros diversos. Solo el personal cualificado debe realizar las tareas descritas en esta sección del documento.

### 5.1 Instrucciones de instalación

#### ▲ ADVERTENCIA



Peligro de incendio. El usuario es responsable de asegurarse de que se adoptan las precauciones necesarias cuando se utiliza el equipo con métodos que contienen líquidos inflamables. Asegúrese de cumplir las precauciones de usuario y los protocolos de seguridad adecuados. Esto incluye, pero no se limita a controles de derrames y fugas, ventilación adecuada, uso atendido del equipo y el deber de no dejar nunca el instrumento sin vigilancia mientras esté encendido.

#### ▲ PRECAUCIÓN



Peligro por exposición a productos químicos. Respete los procedimientos de seguridad del laboratorio y utilice el equipo de protección personal adecuado para las sustancias químicas que vaya a manipular. Consulte los protocolos de seguridad en las hojas de datos de seguridad actuales (MSDS/SDS).

#### ▲ PRECAUCIÓN



Peligro por exposición a productos químicos. Deshágase de los productos químicos y los residuos de acuerdo con las normativas locales, regionales y nacionales.

- Instale el analizador en interiores, en un lugar que no presente riesgos.
- Instale el analizador en un entorno protegido de los fluidos corrosivos.
- Instale el analizador en una zona limpia, seca, bien ventilada y en la que la temperatura esté controlada.
- Instale el analizador tan cerca del punto de muestreo como sea posible.
- No instale el analizador en un lugar expuesto a la luz solar directa o cerca de una fuente de calor.
- Asegúrese de que haya una separación suficiente para conectar los tubos y las conexiones eléctricas.
- Asegúrese de dejar espacio suficiente en la parte delantera del analizador para abrir la puerta del analizador. Consulte [Dimensiones del analizador](#) en la página 83.
- Asegúrese de que las condiciones medioambientales se adecúan a las especificaciones de funcionamiento. Consulte [Especificaciones](#) en la página 79.

Aunque el analizador no está diseñado para utilizarse con muestras inflamables, algunos analizadores EZ utilizan reactivos inflamables. Consulte la hoja Method & Reagent Sheet del modelo correspondiente de la serie EZ para obtener más información sobre los reactivos utilizados en el analizador. Si el analizador utiliza reactivos inflamables, asegúrese de cumplir con las precauciones de seguridad que se indican a continuación:

- Mantenga el analizador alejado del calor, de las chispas y de las llamas abiertas.
- No coma, beba ni fume cerca del analizador.
- Utilice un sistema de ventilación de extracción local.
- Utilice dispositivos y sistemas de iluminación a prueba de explosiones y chispas.
- Evite las descargas electrostáticas. Consulte [Indicaciones para la descarga electrostática](#) en la página 83.
- Limpie y seque por completo el instrumento antes de utilizarlo.
- Lávese las manos antes de los descansos y al final de la jornada laboral.
- Quítense la ropa contaminada. Lave la ropa antes de volver a utilizarla.




- Estos fluidos deben manipularse de acuerdo con las normativas de los organismos reguladores locales sobre los límites de exposición permitidos.

## 5.2 Dimensiones del analizador

Consulte [Figura 5](#) en la página 454 para conocer las dimensiones del analizador.

## 5.3 Instalación mecánica

### 5.3.1 Colocación del instrumento en pared

<b>⚠ ADVERTENCIA</b>	
	Peligro de lesión personal. Asegúrese de que el soporte de pared puede soportar un peso 4 veces superior al del equipo.
<b>⚠ ADVERTENCIA</b>	
	Peligro de lesión personal. Los instrumentos o los componentes son pesados. Pida ayuda para instalarlos o moverlos.
<b>⚠ ADVERTENCIA</b>	
	Peligro de lesión personal. El objeto es pesado. Asegúrese de que el instrumento queda bien fijado a una pared, mesa o al suelo para que el funcionamiento sea seguro.

Utilice los soportes de montaje suministrados para fijar el instrumento en posición vertical y nivelado sobre una superficie plana vertical. Consulte [Figura 6](#) en la página 456.

Instale el instrumento en una ubicación y posición en la que el usuario pueda desconectarlo fácilmente de la fuente de alimentación.

Asegúrese de que haya suficiente espacio debajo del analizador para colocar las botellas.

La tornillería de montaje la proporciona el usuario. Asegúrese de que la sujeción tenga suficiente capacidad para soportar la carga (aproximadamente 160 kg o 353 lb). Los componentes de montaje deben estar aprobados para las propiedades de la pared.

### 5.3.2 Abra la puerta del analizador


Use la tecla suministrada para desbloquear las dos cerraduras en el costado del analizador.

Consulte [Figura 7](#) en la página 456. Asegúrese de cerrar la puerta antes de iniciar el funcionamiento para mantener el grado de protección de la carcasa y la clasificación de seguridad.

## 5.4 Instalación eléctrica

<b>⚠ PELIGRO</b>	
	Peligro de electrocución. Desconecte siempre la alimentación eléctrica del instrumento antes de realizar conexiones eléctricas.

### 5.4.1 Indicaciones para la descarga electrostática

<b>AVISO</b>	
	Daño potencial al instrumento. Los delicados componentes electrónicos internos pueden sufrir daños debido a la electricidad estática, lo que acarrearía una disminución del rendimiento del instrumento y posibles fallos.

Consulte los pasos en este procedimiento para evitar daños de descarga electrostática en el instrumento:

- Toque una superficie metálica a tierra como el chasis de un instrumento, un conducto metálico o un tubo para descargar la electricidad estática del cuerpo.
- Evite el movimiento excesivo. Transporte los componentes sensibles a la electricidad estática en envases o paquetes anti-estáticos.
- Utilice una muñequera conectada a tierra mediante un alambre.
- Trabaje en una zona sin electricidad estática con alfombras antiestáticas y tapetes antiestáticos para mesas de trabajo.

### 5.4.2 Acceso eléctrico

Pase los cables de los dispositivos externos a través de los prensaestopas. Consulte [Figura 8](#) en la página 457. Mantenga los tapones colocados en los prensaestopas que no se vayan a utilizar. [Figura 9](#) en la página 461 muestra los componentes del analizador. El interruptor de encendido es un disyuntor que corta automáticamente el suministro de alimentación principal de la línea de alimentación de CA en caso de que se produzcan excesos de corriente (por ejemplo, un cortocircuito) o sobretensiones.

### 5.4.3 Conexión a dispositivos externos

Conecte los dispositivos externos que se utilizarán con el analizador a los terminales de señal y control del analizador. Consulte [Figura 10](#) en la página 463 y [Tabla 1](#) en la página 84.

**Tabla 1 Terminales de señal y control: descripciones**

Patilla	Descripción
AO1–AO8 (P101)	Ocho salidas analógicas para controlar dispositivos externos. Para obtener más información, consulte la versión ampliada del manual del usuario en línea.
FCT1–FCT5 (P102)	Cinco relés (contactos libres de tensión). La carga máxima es de 24 V CC, 0,5 A. <ul style="list-style-type: none"> <li>• FCT1—Alarma de averías</li> <li>• FCT2—Alarma de mantenimiento</li> <li>• FCT3—Analizador listo</li> <li>• FCT4 y FCT5—Para uso futuro</li> </ul>
DI1–DI7 (P103)	Siete entradas digitales para controlar el analizador de forma remota <sup>5</sup> Conecte las entradas digitales a un contacto externo libre de tensión (24 V CC) para activar el analizador e iniciar la medición de un canal. <ul style="list-style-type: none"> <li>• DI1—Arranque remoto para el canal 1</li> <li>• DI2—Arranque remoto para el canal 2</li> <li>• De DI3 a DI7—Para uso futuro</li> </ul>

<sup>5</sup> Si el analizador está en modo de mantenimiento, el control remoto está desactivado.

**Tabla 1 Terminales de señal y control: descripciones (continúa)**

Patilla	Descripción
FB1–FB4 (P104)	<p>Conectores Profibus DP o Modbus RTU (RS485)</p> <p><b>Profibus DP:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FB1—A1 (entrada)</li> <li>• FB2—A2 (salida)</li> <li>• FB3—B1 (entrada)</li> <li>• FB4—B2 (salida)</li> <li>• SHL—Protector</li> </ul> <p><b>Modbus RTU:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FB1—D (+)</li> <li>• FB2—D (-)</li> <li>• FB3—No se utiliza</li> <li>• FB4—No se utiliza</li> <li>• SHL—Protector</li> </ul> <p>Consulte la documentación del controlador SC4500 para obtener las instrucciones de configuración de Modbus y las etiquetas de telegrama.</p>
24 V CC/1 A (P105)	Fuente de alimentación de 24 V CC para las unidades de filtración EZ9010 y EZ9020
STR1–STR8 (P106)	<p>Ocho salidas digitales para el panel opcional Moduplex. Conecte los cables pelados de la válvula de cada canal del panel Moduplex a los conectores STR correspondientes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• STR1—Canal 1</li> <li>• STR2—Canal 2</li> <li>• ...</li> <li>• STR8—Canal 8</li> </ul>
EXT9–EXT12 (P107)	<p>Cuatro salidas digitales para el panel de filtración EZ9150 opcional. Conecte las válvulas eléctricas y la bomba del panel de filtración EZ9150 a los conectores EXT.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EXT9—Válvula de aclarado</li> <li>• EXT10—Válvula de retrolavado</li> <li>• EXT11—Válvula de drenaje de rebose</li> <li>• EXT12—Bomba de filtración</li> </ul>
D01–D06 (P108 y P109)	<p>Seis salidas de válvula neumática para el panel EZ9150.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• D01—Válvula de entrada de muestra</li> <li>• D02—Válvula de drenaje de la celda de flujo</li> <li>• D03—Válvula del canal 1</li> <li>• D04—Válvula del canal 2</li> <li>• D05—Válvula del canal 3</li> <li>• D06—Válvula del canal 4</li> </ul>

ES

#### 5.4.4 Conexión a la alimentación de CA

### ▲ PELIGRO



Peligro de descarga eléctrica e incendio. Asegúrese de que el cable suministrado y el enchufe a prueba de bloqueo cumplen los requisitos de códigos del país pertinentes.

- Asegúrese de que haya instalado un interruptor de corriente eléctrica con suficiente capacidad en la línea de alimentación.


- Asegúrese de que el interruptor de corriente o un interruptor de emergencia están instalados cerca del analizador para que este pueda desconectarse inmediatamente de la fuente de alimentación si es necesario.
- Conecte los equipos de acuerdo con los códigos eléctricos locales, estatales o nacionales.
- Instale el cable de alimentación suministrado a través del prensaestopas que se encuentra en el lateral del analizador.
- Apriete el prensaestopas para sujetar el cable de alimentación de forma segura y preservar el grado de protección de la carcasa.

Conecte el analizador a la alimentación de CA mediante el cable de alimentación de CA suministrado. Consulte [Tabla 2](#) en la página 86 y [Figura 11](#) en la página 468.

## A V I S O

No encienda el interruptor de alimentación. Realice todas las conexiones hidráulicas y eléctricas antes de la puesta en marcha o es posible que se produzcan daños en el analizador.

**Tabla 2 Información sobre el cableado: alimentación de CA**

Terminal	Descripción	Color del cable-América del Norte y Canadá	Color del cable-EU
L	Cargado/línea (L)	Negro (1)	Marrón
N	Neutral (N)	Blanco (2)	Azul
	Protección de toma a tierra (PE)	Verde y amarillo	Verde y amarillo

## 5.5 Conexiones hidráulicas

### 5.5.1 Directrices sobre la línea de muestra

#### ⚠ PRECAUCIÓN



Peligro de incendio. Este producto no ha sido diseñado para utilizarse con muestras inflamables.

Seleccione un punto de muestreo adecuado que sea representativo para conseguir un rendimiento óptimo del instrumento. La muestra debe ser representativa de todo el sistema.

- Asegúrese de que el caudal de la muestra sea superior que el caudal dirigido al analizador.
- Asegúrese de que la línea de muestreo se encuentre a la presión atmosférica en caso de que el analizador utilice una bomba peristáltica para transportar la muestra hasta el vaso de análisis.
- Asegúrese de que la línea de muestreo recoja la muestra de un pequeño vaso de rebose situado junto al analizador.
- Utilice la línea de muestra suministrada. No cambie la longitud de la línea de muestra.

La muestra del vaso de rebose debe renovarse de forma continua. Si los sólidos de la muestra son demasiado grandes, se recomienda también filtrar la muestra.

### 5.5.2 Instrucciones sobre la línea de drenaje

#### ⚠ ADVERTENCIA



Peligro de incendio. El usuario es responsable de asegurarse de que se adoptan las precauciones necesarias cuando se utiliza el equipo con métodos que contienen líquidos inflamables. Asegúrese de cumplir las precauciones de usuario y los protocolos de seguridad adecuados. Esto incluye, pero no se limita a controles de derrames y fugas, ventilación adecuada, uso atendido del equipo y el deber de no dejar nunca el instrumento sin vigilancia mientras esté encendido.

## ⚠ PRECAUCIÓN



Peligro por exposición a productos químicos. Deshágase de los productos químicos y los residuos de acuerdo con las normativas locales, regionales y nacionales.

## AVISO

No conecte los tubos de drenaje a otros tubos, ya que puede producirse contrapresión o daños en el analizador. Asegúrese de que los tubos de drenaje están abiertos a venteo.

## AVISO

Para evitar que se produzcan contrapresión y daños en el analizador, asegúrese de que el analizador está en una posición más alta que los drenajes de planta utilizados y que el tubo de drenaje tiene una pendiente descendiente constante. Instale los tubos de drenaje con un descenso vertical de 2,54 cm (1 pulgada) o más por cada 0,3 m (1 pie) de longitud de los tubos.

El analizador utiliza el tubo de drenaje para eliminar la muestra y los reactivos tras los análisis. Es importante que los tubos de drenaje estén instalados correctamente para garantizar que se elimine todo el líquido del instrumento. Una instalación incorrecta puede provocar que el líquido penetre de nuevo en el instrumento y lo dañe. Basta con un suelo o sumidero para el tubo de drenaje. El diámetro externo recomendado para el tubo de drenaje es de 32 mm. Consulte [Figura 12](#) en la página 470.

- Asegúrese de que las líneas de drenaje sean lo más cortas posible.
- Asegúrese de que el drenaje esté colocado más abajo que el analizador.
- Asegúrese de que las líneas de drenaje tengan un descenso constante.
- Asegúrese de que las líneas de drenaje no se doblen en exceso y de que no se retuerzan.
- Asegúrese de que las líneas de drenaje estén abiertas a venteo y de que tengan una presión de cero.
- Asegúrese de que las líneas de drenaje se cierran a la temperatura ambiente de la sala de instalación.
- No obstruya ni sumerja el tubo de drenaje.

También se recomienda contar con una conexión al suministro de agua cerca del analizador para que el sumidero y los tubos de drenaje se limpien periódicamente con agua limpia a fin de evitar obstrucciones por cristalización.

Consulte la hoja Method & Reagent Sheet del modelo correspondiente de la serie EZ para obtener más información sobre los reactivos utilizados en el analizador. Si el analizador utiliza reactivos inflamables, asegúrese de cumplir con las precauciones de seguridad que se indican a continuación:

- No conecte el tubo de drenaje a un sumidero en el suelo.
- Deseche los residuos de acuerdo con las normativas medioambientales locales, estatales y nacionales.

### 5.5.3 Instrucciones sobre la línea de ventilación

## ⚠ ADVERTENCIA



Peligro de incendio. El usuario es responsable de asegurarse de que se adoptan las precauciones necesarias cuando se utiliza el equipo con métodos que contienen líquidos inflamables. Asegúrese de cumplir las precauciones de usuario y los protocolos de seguridad adecuados. Esto incluye, pero no se limita a controles de derrames y fugas, ventilación adecuada, uso atendido del equipo y el deber de no dejar nunca el instrumento sin vigilancia mientras esté encendido.

## ⚠ PRECAUCIÓN



Peligro por exposición a productos químicos. Deshágase de los productos químicos y los residuos de acuerdo con las normativas locales, regionales y nacionales.

## AVISO

No conecte la línea de ventilación (puerto de salida de gases) a otros tubos, ya que pueden producirse contrapresión o daños en el analizador. Asegúrese de que la línea de ventilación esté abierta al aire en el exterior del edificio.

## AVISO

Para evitar que se produzcan contrapresión y daños en el analizador, asegúrese de que el analizador esté en una posición más alta que las líneas de ventilación de la planta y que el tubo de ventilación tiene una pendiente descendente constante. Instale la línea de ventilación con una inclinación descendente de 2,54 cm (1 pulg.) o más por cada 0,3 m (1 pie) de longitud del tubo.

El analizador utiliza la línea de ventilación para mantener el vaso de análisis a presión atmosférica. Es importante instalar correctamente la línea de ventilación para asegurarse de que durante el funcionamiento de la bomba no entra líquido en el vaso de análisis desde la línea de ventilación. Una instalación incorrecta puede provocar que el gas penetre de nuevo en el analizador y lo dañe. El diámetro externo recomendado para el tubo del colector de la línea de ventilación es de 32 mm. Consulte [Figura 12](#) en la página 470.

- La línea de ventilación debe ser lo más corta posible.
- Asegúrese de que la línea de ventilación tenga una pendiente descendente constante.
- Asegúrese de que la línea de ventilación no tenga curvas cerradas y no esté doblada o bloqueada.
- Asegúrese de que la línea de ventilación se cierre a la temperatura ambiente de la sala de instalación y que esté a presión cero.
- Asegúrese de que la línea de ventilación esté siempre más alta que el drenaje.
- No obstruya ni sumerja la línea de ventilación.

Si el analizador utiliza reactivos inflamables, asegúrese de cumplir con las precauciones de seguridad que se indican a continuación:

- No conecte el tubo de ventilación a un sumidero en el suelo.
- Deseche los residuos de acuerdo con las normativas medioambientales locales, estatales y nacionales.

### 5.5.4 Conexión del analizador a la prueba de componentes



#### ▲ PRECAUCIÓN



Peligro de incendio. Este producto no ha sido diseñado para utilizarse con líquidos inflamables.




Antes de poner en funcionamiento el analizador con todos los reactivos, se debe realizar una prueba de componentes con agua desionizada. Consulte los pasos ilustrados y [Realización de las pruebas de los componentes](#) en la página 92.

1. Instale los cuatro tubos de la válvula de pinzamiento como se muestra en el paso 1 a continuación.
  - a. Pulse el botón negro y, a continuación, introduzca los tubos en la válvula.
  - b. Suelte el botón cuando los tubos estén correctamente instalados.
2. Asegúrese de que el tubo de drenaje esté instalado correctamente en el vaso de muestra. Consulte el paso 2 con imágenes que se muestra a continuación.
3. Asegúrese de que el tubo del digestor esté correctamente instalado en el vaso del digestor. Consulte el paso 3 con imágenes que se muestra a continuación.
4. Conecte todos los tubos de líquido del analizador a una botella grande de agua desionizada para realizar una prueba de los componentes. Consulte el paso 3 con imágenes que se muestra a continuación. Los tubos vienen instalados de fábrica.

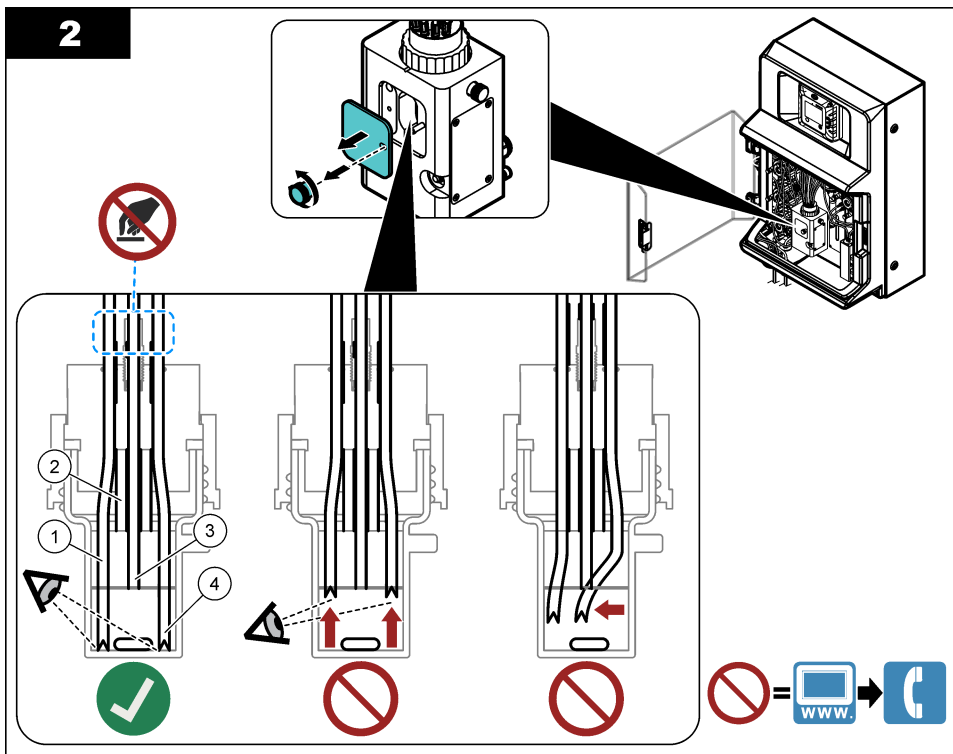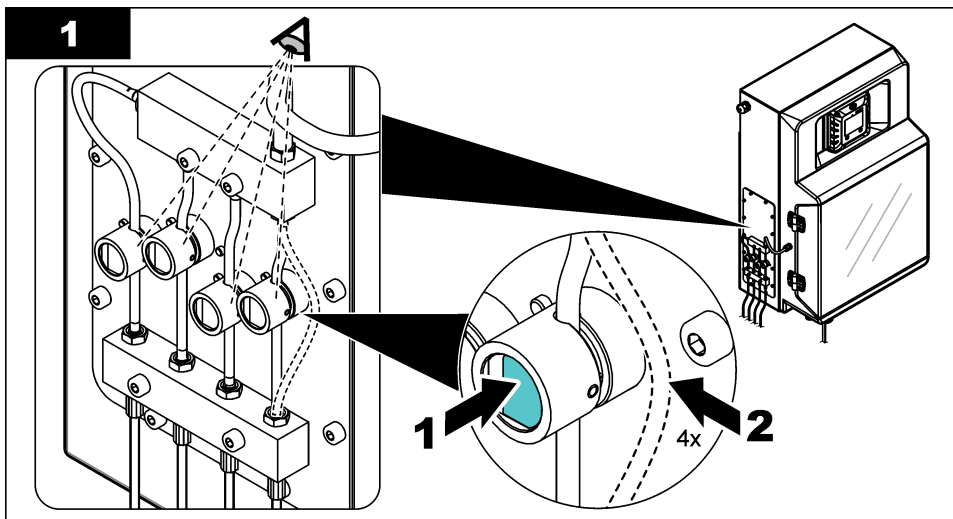

1 Tubo de drenaje	3 Tubo de muestra
2 Tubos de ventilación y reactivos (tubos superiores)	4 Tubo del digestor


3

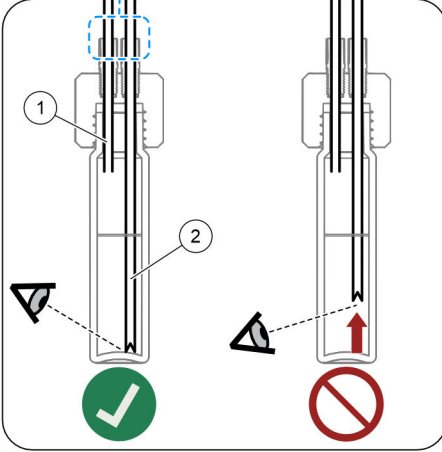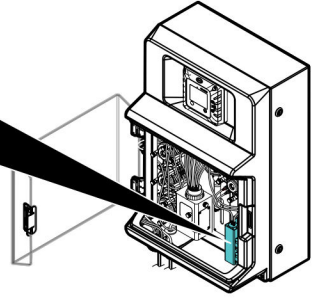

1 Tubo de ventilación

2 Tubo del digestor

4

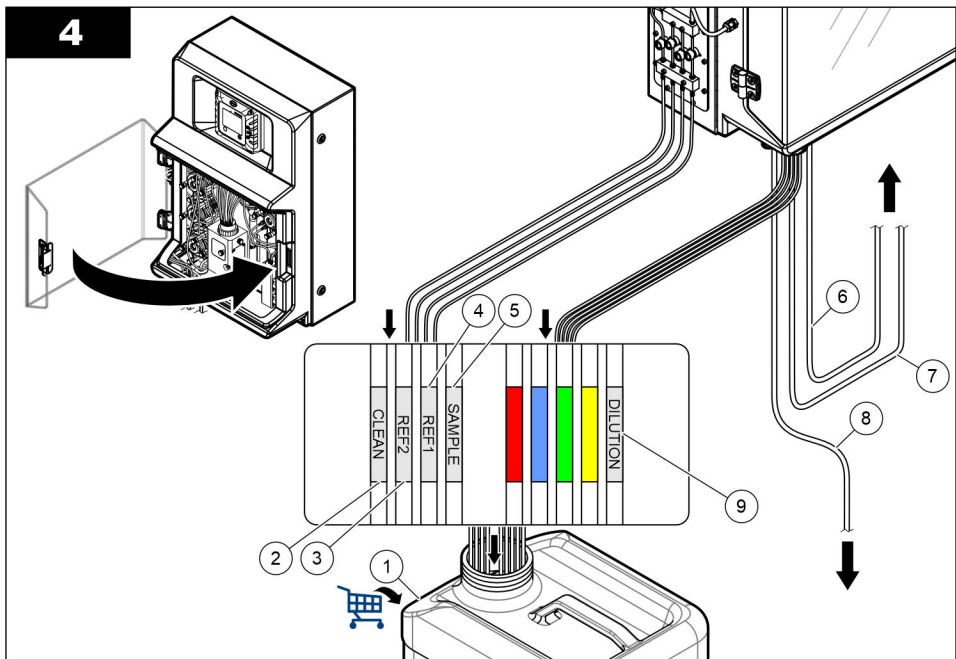

ES

1 Agua desionizada	4 Tubo de solución de Referencia 1 (REF1)	7 Digestor de ventilación
2 Tubo de solución limpiadora	5 Tubo de entrada de muestra	8 Tubo de drenaje
3 Tubo de solución de Referencia 2 (REF2)	6 Tubo de ventilación	9 Tubos de dilución y de la microbomba de reactivos

## Sección 6 Puesta en marcha

### 6.1 Puesta en marcha inicial

**Nota:** Asegúrese de que las instalaciones de montaje, tuberías y eléctricas estén totalmente terminadas antes de la puesta en marcha. Consulte [Instalación](#) en la página 82.

Cuando el analizador se alimenta por primera vez, un asistente de puesta en marcha le ayudará con los primeros pasos para completar la configuración. Siga todos los pasos para asegurarse de que el analizador funciona correctamente.

**Nota:** Asegúrese de utilizar los reactivos correctos para el rango de medición seleccionado. Para obtener más información, consulte la versión ampliada del manual del usuario en línea.

1. Abra la puerta del analizador. Consulte [Abra la puerta del analizador](#) en la página 83.
2. Coloque el interruptor de alimentación en la posición de encendido. Consulte [Figura 9](#) en la página 461.
3. Cierre la puerta del analizador con la llave suministrada.
4. Espere a que termine el proceso de inicialización.
5. Responda a las indicaciones de la pantalla para seleccionar el idioma, la zona horaria, la fecha y la hora.  
Para configurar el resto de ajustes del controlador, consulte la documentación del controlador SC4500.
6. Pulse la pantalla para mostrar el menú **EZ2700sc**.

7. Seleccione **Device menu (Menú del dispositivo)** para abrir el asistente de inicio. Se muestra la pantalla de bienvenida.
8. Siga los pasos que se muestran en la pantalla para seleccionar el rango de medición aplicable. Pulse **OK (Aceptar)**.
9. Si hay instalada una unidad de filtración, seleccione **On (Activado)**. En caso contrario, seleccione **Off (Desactivado)**.
10. Seleccione el número de canales para el analizador. Pulse **OK (Aceptar)**.
11. Si la configuración mostrada en la página de resumen es correcta, pulse **OK (Aceptar)**. Se muestra el menú principal de **EZ2700sc**.
12. Continúe con la prueba de los componentes. Consulte [Realización de las pruebas de los componentes](#) en la página 92.

## 6.2 Realización de las pruebas de los componentes

### ⚠ ADVERTENCIA



Riesgo de opresión. Las piezas que se mueven pueden oprimir y provocar daños. No toque las piezas móviles.

Realice una prueba de los componentes antes de poner en marcha el analizador. Utilice el menú **Mantenimiento** para iniciar las diferentes funciones del analizador y examinar el funcionamiento de los componentes.

#### Requisitos previos:

- Si el analizador está en modo operativo, seleccione **Mantenimiento > Start maintenance mode (Iniciar el modo de mantenimiento)**.
- Asegúrese de que los tubos de muestra, reactivo y solución se encuentren en un contenedor de agua desionizada. Consulte [Conexión del analizador a la prueba de componentes](#) en la página 88.

#### 6.2.1 Comprobación del agitador

1. Retire el protector de luz de la unidad fotométrica. Consulte [Figura 13](#) en la página 472.
2. Asegúrese de que el agitador se encuentra en el fondo del vaso de muestras.  
*Nota: Examine el agitador durante el procedimiento de cebado para asegurarse de que gira correctamente. El procedimiento de cebado se inicia en [Comprobación de las bombas y las válvulas de pinzamiento](#) en la página 92.*
3. Instale el protector de luz en el fotómetro.

#### 6.2.2 Comprobación de las bombas y las válvulas de pinzamiento

1. Compruebe el funcionamiento de las bombas y las válvulas de pinzamiento para asegurarse de que no haya fugas.
2. Asegúrese de que el vaso de análisis se llene con agua desionizada. Consulte [Figura 14](#) en la página 474.
3. Asegúrese de que el agua desionizada salga por el tubo de drenaje.
4. Seleccione **Mantenimiento > Start priming (Iniciar cebado)** y cebe todos los líquidos por separado.  
Si se produce una fuga, examine todas las conexiones y consulte la versión ampliada del manual de usuario disponible en línea para obtener más información.
  - a. Seleccione **Cebador referencia 1** y pulse **OK (Aceptar)**.
  - b. Seleccione **Cebador referencia 2** y pulse **OK (Aceptar)**.
  - c. Seleccione **Cebador solución de limpieza** y pulse **OK (Aceptar)**.
  - d. Seleccione **Prime rinsing (Cebador aclarado)** y pulse **OK (Aceptar)**.

- e. Seleccione **Prime dispenser (Cebiar dispensador)** y pulse **OK (Aceptar)**.
- f. Seleccione **Cebiar canal > Cebiar todos los canales** y pulse **OK (Aceptar)**.  
Todos los procedimientos de cebado se detienen automáticamente al finalizar.

### 6.2.3 Comprobación de las microbombas

Examine las microbombas en busca de fugas y burbujas de aire.

1. Retire el protector de luz del fotómetro.
2. Seleccione **Mantenimiento > Start priming (Iniciar cebado) > Prime all reagents (Cebiar todos los reactivos)**.
3. Asegúrese de que el agua desionizada entre en la microbomba a través de cada uno de los tubos de la microbomba (reactivo). A continuación, asegúrese de que entre en el vaso de análisis de forma continua sin burbujas de aire. Consulte [Figura 15](#) en la página 475.
4. Si las microbombas no funcionan correctamente (hay burbujas en los tubos), utilice el procedimiento de jeringa para introducir agua desionizada en el tubo correspondiente y eliminar las burbujas. Consulte [Figura 16](#) en la página 476.
5. Instale el protector de luz en el fotómetro.

### 6.2.4 Comprobación del fotómetro

Asegúrese de que la parte exterior del vaso de análisis esté limpia antes de la comprobación del fotómetro para que esta se realice correctamente. Para obtener más información sobre cómo limpiar los componentes del analizador, consulte la versión ampliada del manual del usuario disponible en línea.

1. Pulse el icono del menú principal y, a continuación, seleccione **Devices (Dispositivos)**.
2. Seleccione **EZ2700sc**.
3. Desplácese hacia abajo hasta la parte inferior de la pantalla y, a continuación, seleccione **Device menu (Menú del dispositivo)**.
4. Seleccione **Mantenimiento > Photometer check (Comprobación del fotómetro)**.
5. Pulse **OK (Aceptar)** para iniciar la medición.  
Una vez finalizada la calibración sin luz, el resultado se muestra en la pantalla.
6. Pulse **OK (Aceptar)** para continuar.
7. Asegúrese de que el tubo "REF1" esté conectado a un contenedor lleno de agua desionizada. Asegúrese de que el protector de luz esté instalado. Consulte [Figura 18](#) en la página 478.
8. Pulse **OK (Aceptar)**.  
Espere hasta que el vaso de análisis esté lleno.
9. Utilice un destornillador para ajustar la tensión de salida del sensor a 9 V. Consulte [Figura 17](#) en la página 476.
10. Espere a que se muestre el valor de 9 V en la pantalla. A continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
11. Pulse **OK (Aceptar)** para continuar.

## 6.3 Prueba de señal de entrada

Realice una prueba de las entradas digitales antes de poner en funcionamiento el analizador.

**Requisitos previos:** conecte las entradas digitales a un contacto externo libre de tensión (24 V CC).

Realice una prueba de señal de entrada digital y de señal de salida analógica de la siguiente manera:

1. Pulse el icono del menú principal y, a continuación, seleccione **Dispositivos**.
2. Seleccione **EZ2700sc**.
3. Desplácese hacia abajo hasta la parte inferior de la pantalla y, a continuación, seleccione **Device menu (Menú del dispositivo)**.

#### 4. Seleccione **Diagnostics (Diagnóstico) > Signals (Señales)**.

Aparecerán las señales de las entradas digitales.

#### 5. Compare el estado de las entradas digitales de la pantalla con las tensiones suministradas a las entradas digitales (24 V = On (Activado); 0 V = Off (Desactivado)).

### 6.4 Prueba de señal externa

Realice una prueba de las salidas analógicas antes de poner en funcionamiento el analizador.

**Requisitos previos:** configure las salidas analógicas (AO1–AO8, P101) para seleccionar la medición de canal representada por cada salida analógica. Para obtener más información, consulte la versión ampliada del manual del usuario en línea.

Realice una prueba de señal de salida analógica de la siguiente manera:

1. Pulse el icono del menú principal.
2. Seleccione **Salidas > Salida de mA - AOC > Prueba/Mantenimiento**.

Opción	Descripción
<b>Prueba funcional</b>	Realiza una prueba en las salidas del módulo seleccionado.
<b>Estado de salida</b>	Muestra el estado de las salidas del módulo seleccionado.

3. Utilice un multímetro para medir el valor de mA en cada salida analógica.
4. Compare el valor de mA medido en las salidas analógicas con los valores de mA esperados.

### 6.5 Configuración de la secuencia de canales




Seleccione la secuencia en la que se miden los canales, el número de veces que se mide cada canal y el tiempo de espera antes de que se mida un canal. Introduzca un máximo de 16 entradas con un máximo de 16 ciclos cada una.

1. Pulse el icono del menú principal y, a continuación, seleccione **Devices (Dispositivos)**.
2. Seleccione **EZ2700sc**.
3. Desplácese hacia abajo hasta la parte inferior de la pantalla y, a continuación, seleccione **Device menu (Menú del dispositivo)**.
4. Si el analizador está en modo operativo, seleccione **Mantenimiento > Start maintenance mode (Iniciar el modo de mantenimiento)**. Espere a que el analizador esté en modo de mantenimiento.
5. Seleccione **Configuration (Configuración) > Channel sequence setup (Configuración de la secuencia del canal)**.
6. Utilice las flechas de la barra lateral para seleccionar una posición (número en la secuencia) y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)** para configurar esa posición.
7. Seleccione una opción.

Opción	Descripción
<b>Select (Seleccionar)</b>	Establece el canal o el tiempo de espera correspondientes.
<b>Number of measurements (Número de mediciones)</b>	Establece el número de mediciones de un canal.
<b>Waiting time (Tiempo de espera)</b>	Establece el tiempo de espera para el canal seleccionado.

8. Pulse **OK (Aceptar)** para guardar los cambios.

## 6.6 Conexión de las soluciones y la muestra

⚠ PRECAUCIÓN	
	Peligro por exposición a productos químicos. Respete los procedimientos de seguridad del laboratorio y utilice el equipo de protección personal adecuado para las sustancias químicas que vaya a manipular. Consulte los protocolos de seguridad en las hojas de datos de seguridad actuales (MSDS/SDS).
⚠ PRECAUCIÓN	
	Peligro por exposición a productos químicos. Deshágase de los productos químicos y los residuos de acuerdo con las normativas locales, regionales y nacionales.
⚠ PRECAUCIÓN	
	Peligro de incendio. Este producto no ha sido diseñado para utilizarse con líquidos inflamables.

Los recipientes de reactivos se suministran con el analizador. Consulte [Figura 18](#) en la página 478. El usuario suministra los recipientes para el agua desionizada, la solución de Referencia 1 y la solución de Referencia 2. Es posible adquirir más recipientes del fabricante.

Instale los recipientes

- lo más cerca posible del analizador
- 1 metro por debajo de la parte inferior del analizador

Consulte [Figura 18](#) en la página 478 para ver la instalación del recipiente.

El usuario debe proveer los reactivos y las soluciones. Utilice únicamente reactivos suministrados por una empresa certificada o utilice reactivos específicos del fabricante. Como alternativa, el usuario puede preparar los reactivos. Siga las instrucciones de la hoja Method & Reagent Sheet correspondiente al modelo que puede consultar en el sitio web del fabricante.

Los tubos se instalan de fábrica. Lea la etiqueta de cada tubo para conocer cuál es la conexión correcta correspondiente. Consulte la hoja Method & Reagent Sheet correspondiente al modelo que puede consultar en el sitio web del fabricante para conocer los reactivos, las soluciones y los estándares correctos.

1. Una vez realizadas las pruebas de los componentes, instale los tubos "CLEAN" (solución de limpieza), "REF1" (solución de Referencia 1) y "REF2" (solución de Referencia 2) en los recipientes correspondientes. Consulte [Figura 18](#) en la página 478.
2. Instale cada tubo de reactivo codificado por colores en el recipiente de reactivo con el mismo color en la etiqueta.
3. Conecte la corriente de la muestra (o la salida de la muestra del panel Moduplex o del panel del filtro) al tubo de entrada de muestra del analizador. Consulte [Figura 18](#) en la página 478.
4. Pulse el icono del menú principal y, a continuación, seleccione **Devices (Dispositivos)**.
5. Seleccione **EZ2700sc**.
6. Desplácese hacia abajo hasta la parte inferior de la pantalla y, a continuación, seleccione **Device menu (Menú del dispositivo)**.
7. Seleccione **Mantenimiento > Start priming (Iniciar cebado) > Prime al (Cebado todo)**.

## 6.7 Validación antes de la puesta en marcha inicial

Realice una validación para asegurarse de que las mediciones se mantienen dentro del rango de tolerancia. Para obtener más información, consulte la versión ampliada del manual del usuario en línea.

1. Pulse el icono del menú principal y, a continuación, seleccione **Devices (Dispositivos)**.
2. Seleccione **EZ2700sc**.
3. Desplácese hacia abajo hasta la parte inferior de la pantalla y, a continuación, seleccione **Device menu (Menú del dispositivo)**.
4. Para iniciar una validación, seleccione **Calibration (Calibración) > Validation (Validación) > Start validation (Iniciar validación)**.

La validación mide el agua desionizada en el frasco de la referencia 2.

5. Para mostrar los resultados, seleccione una opción:
  - **Calibration (Calibración) > Validation (Validación) > Validation history (Historial de validación)**
  - **Diagnostics (Diagnóstico) > Historical data (Historial de datos) > Validation (Validación)**

## 6.8 Inicio del analizador

Para iniciar el analizador:

1. Pulse el icono del menú principal y, a continuación, seleccione **Devices (Dispositivos)**.
2. Seleccione **EZ2700sc**.
3. Desplácese hacia abajo hasta la parte inferior de la pantalla y, a continuación, seleccione **Device menu (Menú del dispositivo)**.
4. Seleccione **Mantenimiento > Start operational mode (Iniciar el modo de funcionamiento)**.

# Índice

- |   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1 | <a href="#">Informações adicionais</a> na página 97     | 4 | <a href="#">Informação geral</a> na página 99 |
| 2 | <a href="#">Descrição geral do produto</a> na página 97 | 5 | <a href="#">Instalação</a> na página 101      |
| 3 | <a href="#">Especificações</a> na página 98             | 6 | <a href="#">Arranque</a> na página 110        |

## Secção 1 Informações adicionais

O manual básico do utilizador contém informações suficientes para a colocação do produto em funcionamento. Está disponível online um manual do utilizador expandido, que contém mais informações.

PT-  
PT

### ⚠ PERIGO



Vários perigos! São fornecidas mais informações nas secções individuais do manual do utilizador expandido que são indicadas abaixo.

- Interface do utilizador e navegação
- Funcionamento
- Manutenção
- Resolução de problemas
- Listas de peças de substituição

Leia os códigos QR que se seguem para aceder ao manual do utilizador expandido.



Línguas europeias



Línguas americanas e asiáticas

## Secção 2 Descrição geral do produto

O analisador EZ2700sc da Hach é um analisador online que mede um parâmetro em amostras de água de aplicações industriais e ambientais. Consulte a [Figura 1](#) na página 439, a [Figura 2](#) na página 443 e a [Figura 3](#) na página 447.

O analisador é um analisador colorimétrico online para a análise geral da água (por exemplo, nitrato, fosfato). O analisador tem opções de arranque remoto, validação automática, calibração automática, limpeza automática e Modbus.

A água da amostra entra no analisador através do tubo de amostra. As bombas, válvulas e seringas no analisador deslocam a amostra e os reagentes para a célula de medição no painel de análise. Quando o processo de análise do recipiente estiver concluído, o analisador elimina a amostra através do tubo de drenagem. Os resultados da análise são apresentados no display do controlador SC4500. O controlador SC4500 guarda os dados do analisador (registo de dados, registo de eventos, registo de definições e registo de serviços). Utilize o controlador SC4500 para operar e configurar o analisador.

Para aumentar o número de fluxos de amostras (canais) que o analisador pode medir (2, 4 ou 8), adquira o painel multifluxo Moduplex com o analisador.

Para o pré-tratamento da amostra (filtragem, sedimentação), adquira o painel de filtragem EZ9010, EZ9020, EZ9150, EZ9200 ou EZ9250 com o analisador.

## Secção 3 Especificações

As especificações podem ser alteradas sem aviso prévio.

Especificação	Detalhes
Dimensões (L x A x P)	460 x 688 x 340 mm (18,1 x 27,1 x 13,4 polegadas)
Estrutura	IP44: ABS, PMMA e aço revestido
Display	IP66, display TFT a cores de 3,5 polegadas com painel tátil capacitivo
Peso	40 kg (88 lb)
Requisitos de energia	100 a 240 V CA $\pm$ 10%, 50/60 Hz
Consumo de energia	240 VA máximo
Altitude	2000 m (6560 pés) no máximo
Categoria de sobrevoltagem	II
Condições ambientais	Apenas para utilização em ambientes fechados
Nível de poluição	2
Temperatura de funcionamento	10 a 30 °C (50 a 86 °F); 5 a 95% de humidade relativa, sem condensação, sem corrosão
Temperatura de armazenamento	-20 a 60 °C (-4 a 140 °F), 95% de humidade relativa, sem condensação máxima
Entradas da amostra	Uma
Pressão de amostra	Por recipiente de "overflow" externo (aberto à pressão atmosférica)
Taxa de fluxo da amostra	100 a 300 mL/min
Temperatura da amostra	10 a 30 °C (50 a 86 °F)
Qualidade da amostra	Partículas de < 100 $\mu$ m, < 0,1 g/L no máximo Turvação < 50 NTU
Purga de ar para ambientes corrosivos	0,2 bar (20 kPa ou 3 psi); ar seco e limpo
Drenagem	Pressão atmosférica, ventilado, $\varnothing$ mínimo de 32 mm
Ligação à terra	Polo de ligação à terra seco e limpo de baixa impedância (< 1 $\Omega$ ) com um cabo de terra de > 2,5 mm <sup>1</sup> (13 AWG)
Saídas analógicas	Máximo de oito saídas analógicas de 0–20 mA (ou 4–20 mA) <b>Nota:</b> As saídas analógicas fornecem a alimentação de loop. Não é possível fornecer alimentação aos contactos do sistema SCADA ou PLC.
Entradas digitais	Sete entradas digitais: duas entradas digitais para arranque remoto. As restantes entradas digitais destinam-se a utilização futura.
Saídas digitais	Quatro saídas digitais ligadas para as válvulas e bombas do painel EZ9150; oito saídas digitais ligadas para as válvulas do painel Moduplex; 24 V CC, 500 mA.
Relés	Cinco contactos sem potencial (FCT), carga máxima de 24 V CC, 0,5 A (carga resistiva)
Ligações Ethernet	Ligação Ethernet Claros e conector Ethernet Modbus TCP/IP; versão LAN; 10/100 Mbps ou Profinet ou Ethernet IP
Comunicações RS485	Profibus DP ou Modbus RTU

<sup>2</sup> Para obter informações sobre a configuração Ethernet e Modbus, consulte a documentação do controlador SC4500.

Especificação	Detalhes
Certificações	Certificação CE, ETL de acordo com as normas de segurança UL e CSA, UKCA
Garantia	1 ano (EU: 2 anos)

## Secção 4 Informação geral

Em caso algum o fabricante será responsável por danos resultantes de qualquer utilização inadequada do produto ou do incumprimento das instruções deste manual. O fabricante reserva-se o direito de, a qualquer altura, efetuar alterações neste manual ou no produto nele descrito, sem necessidade, ou obrigação, de o comunicar. As edições revistas encontram-se disponíveis no website do fabricante.

PT-PT

### 4.1 Informações de segurança

O fabricante não é responsável por quaisquer danos resultantes da aplicação incorrecta ou utilização indevida deste produto, incluindo, mas não limitado a, danos directos, incidentais e consequenciais, não se responsabilizando por tais danos ao abrigo da lei aplicável. O utilizador é o único responsável pela identificação de riscos de aplicação críticos e pela instalação de mecanismos adequados para a protecção dos processos na eventualidade de uma avaria do equipamento.

Leia este manual até ao fim antes de desembalar, programar ou utilizar o aparelho. Dê atenção a todos os avisos relativos a perigos e precauções. A não leitura destas instruções pode resultar em lesões graves para o utilizador ou em danos para o equipamento.

Se o equipamento for utilizado de uma forma não especificada pelo fabricante, a protecção fornecida pelo equipamento pode ser prejudicada. Não utilize ou instale este equipamento de qualquer outra forma que não a especificada neste manual.

#### 4.1.1 Uso da informação de perigo

#### ▲ PERIGO

Indica uma situação de perigo potencial ou eminente que, se não for evitada, resultará em morte ou lesões graves.

#### ▲ ADVERTÊNCIA

Indica uma situação de perigo potencial ou eminente que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou lesões graves.

#### ▲ AVISO



Indica uma situação de perigo potencial, que pode resultar em lesões ligeiras a moderadas.





#### ATENÇÃO

Indica uma situação que, se não for evitada, pode causar danos no equipamento. Informação que requer ênfase especial.


#### 4.1.2 Etiquetas de precaução

Leia todos os avisos e etiquetas do equipamento. A sua não observação pode resultar em lesões para as pessoas ou em danos para o aparelho. Um símbolo no aparelho é referenciado no manual com uma frase de precaução.







	Este é o símbolo de alerta de segurança. Observe todas as mensagens de segurança que seguem este símbolo para evitar potenciais lesões. Caso se encontre no equipamento, consulte o manual de instruções para obter informações de operação ou segurança.
	Este símbolo identifica o risco de perigo químico e indica que apenas o pessoal qualificado e com formação para trabalhar com químicos deve manusear os produtos químicos ou efectuar manutenção em sistemas de produção química associados ao equipamento.

	Este símbolo indica que existe um risco de choque eléctrico e/ou electrocussão.
	Este símbolo indica a presença de dispositivos sensíveis a descargas electrostáticas (DEE) e indica que é necessário ter cuidado para evitar danos no equipamento.
	Este símbolo indica que o item seleccionado requer uma ligação à terra com protecção. Se o equipamento não for fornecido com uma ligação à terra, efectue uma ligação à terra com protecção ao terminal do condutor com protecção.
	O equipamento eléctrico marcado com este símbolo não pode ser eliminado nos sistemas europeus de recolha de lixo doméstico e público. Devolva os equipamentos antigos ou próximos do final da sua vida útil ao fabricante para que os mesmos sejam eliminados sem custos para o utilizador.

#### 4.1.3 Segurança química e biológica

<b>⚠ PERIGO</b>	
	Perigo químico ou biológico. Se utilizar o equipamento para monitorizar um processo de tratamento e/ou um sistema de alimentação química para o qual existem limites regulamentares e requisitos de monitorização relacionados com a saúde pública, segurança pública, fabrico ou processamento de alimentos ou bebidas, é da responsabilidade do utilizador deste equipamento conhecer e cumprir a regulamentação aplicável e dispor de mecanismos suficientes e adequados para estar em conformidade com os regulamentos aplicáveis na eventualidade de avaria do mesmo.

#### 4.2 Ícones usados nas ilustrações

				
Peças fornecidas pelo fabricante	Peças adquiridas pelo utilizador	Observar	Executar passos pela ordem inversa	
				
São necessárias duas pessoas	Ouvir	Utilizar apenas os dedos	Não utilizar ferramentas	Não tocar

#### 4.3 Utilização prevista

Os analisadores da série EZ da Hach destinam-se a ser utilizados por indivíduos que têm de medir continuamente parâmetros de qualidade da água em amostras de aplicações industriais e ambientais. Os analisadores da série EZ da Hach não tratam nem alteram a água e não são utilizados para controlar procedimentos.

#### 4.4 Componentes do produto

Certifique-se de que recebeu todos os componentes. Consulte a [Figura 4](#) na página 452. Se algum dos itens estiver em falta ou apresentar danos, contacte imediatamente o fabricante ou um representante de vendas.

## Secção 5 Instalação

### ⚠ PERIGO



Vários perigos. Apenas pessoal qualificado deverá realizar as tarefas descritas nesta secção do documento.

### 5.1 Diretrizes de instalação

#### ⚠ ADVERTÊNCIA



Perigo de incêndio. O utilizador é responsável por garantir que são aplicadas precauções suficientes quando o equipamento é utilizado com métodos que necessitem de recorrer a líquidos inflamáveis. Certifique-se de que respeita as precauções do utilizador e os protocolos de segurança adequados. Tal inclui, entre outros, o controlo de derrames e fugas, uma ventilação adequada, a não utilização sem supervisão e a garantia de que o equipamento nunca é deixado sem supervisão quando a alimentação estiver ligada.

#### ⚠ AVISO



Perigo de exposição a produtos químicos. Siga os procedimentos de segurança do laboratório e utilize todo o equipamento de protecção pessoal adequado aos produtos químicos manuseados. Consulte as fichas de dados sobre segurança de materiais (MSDS/SDS) para protocolos de segurança.

#### ⚠ AVISO



Perigo de exposição a produtos químicos. Elimine os produtos químicos e os resíduos de acordo com os regulamentos locais, regionais e nacionais.

- Instale o analisador num ambiente fechado e livre de perigos.
- Instale o analisador num ambiente protegido contra fluidos corrosivos.
- Instale o analisador num local limpo, seco, bem ventilado e com controlo da temperatura.
- Instale o analisador o mais próximo possível do ponto de amostragem.
- Não instale o analisador sob luz solar direta nem próximo de uma fonte de calor.
- Certifique-se de que existe espaço suficiente para fazer as ligações de canalização e elétricas.
- Certifique-se de que deixe espaço suficiente à frente do analisador para abrir a porta do analisador. Consulte [Dimensões do analisador](#) na página 102.
- Certifique-se de que as condições ambientais estão de acordo com especificações de funcionamento. Consulte [Especificações](#) na página 98.

Embora o analisador não seja concebido para ser utilizado com amostras inflamáveis, alguns analisadores EZ utilizam reagentes inflamáveis. Consulte a folha de reagentes e métodos do modelo da série EZ aplicável para obter mais informações sobre os reagentes utilizados no analisador. Se o analisador utilizar reagentes inflamáveis, certifique-se de que respeita as seguintes precauções de segurança:

- Mantenha o analisador afastado de calor, faíscas e chamas abertas.
- Não coma, beba ou fume junto do analisador.
- Utilize um sistema de ventilação de escape local.
- Utilize sistemas de iluminação e aparelhos à prova de faíscas e explosão.
- Evite descargas electrostáticas. Consulte [Considerações sobre descargas electrostáticas \(ESD\)](#) na página 102.
- Limpe e seque completamente o equipamento antes de o utilizar.
- Lave as mãos antes das pausas e no final do período de trabalho.
- Remova o vestuário contaminado. Lave o vestuário antes de o voltar a utilizar.
- Estes fluidos devem ser manuseados de acordo com os requisitos da agência reguladora local relativamente aos limites de exposição permitidos.

## 5.2 Dimensões do analisador

Consulte a [Figura 5](#) na página 454 para obter informações sobre as dimensões do analisador.

## 5.3 Instalação mecânica

### 5.3.1 Fixar o equipamento a uma parede

#### ⚠ ADVERTÊNCIA



Perigo de danos pessoais. Certifique-se de que a montagem de parede aguenta um peso 4 vezes superior ao do equipamento.

#### ⚠ ADVERTÊNCIA



Perigo de danos pessoais. Os equipamentos ou componentes são pesados. Peça ajuda para instalar ou mover os equipamentos ou componentes.

#### ⚠ ADVERTÊNCIA



Perigo de danos pessoais. O objecto é pesado. Certifique-se de que o equipamento está bem preso a uma parede, mesa ou chão para garantir a sua utilização com segurança.

Utilize os suportes de montagem fornecidos para fixar o equipamento na vertical e nivelado numa superfície de parede plana e vertical. Consulte a [Figura 6](#) na página 456.

Instale o equipamento num local e numa posição que permita ao utilizador desligá-lo facilmente da fonte de alimentação.

Certifique-se de que existe espaço suficiente por baixo do analisador para instalar os frascos.

O equipamento de montagem é fornecido pelo utilizador. Certifique-se de que o fixador de parede tem uma capacidade de resistência de carga suficiente (aproximadamente, 160 kg ou 353 lb). O equipamento de montagem deve ser aprovado para as propriedades da parede.

### 5.3.2 Abra a porta do analisador

Use a chave fornecida para destravar as duas travas na lateral do analisador. Consulte [Figura 7](#) na página 456. Certifique-se de fechar a porta antes da operação para manter a classificação ambiental da estrutura e a classificação de segurança.

## 5.4 Instalação eléctrica

#### ⚠ PERIGO



Perigo de electrocussão. Desligue sempre o equipamento antes de efectuar quaisquer ligações eléctricas.

### 5.4.1 Considerações sobre descargas electrostáticas (ESD)

#### ATENÇÃO



Danos no equipamento potencial. Os componentes eletrónicos internos sensíveis podem ser danificados através de eletricidade estática, provocando um desempenho reduzido ou uma eventual falha.

Siga os passos indicados neste procedimento para evitar danos de ESD no equipamento:

- Toque numa superfície metálica de ligação à terra, tal como o chassis de um equipamento, uma conduta ou tubo de metal para descarregar a eletricidade estática do corpo.
- Evite movimentos bruscos. Transporte componentes estáticos sensíveis em contentores ou embalagens anti-estáticos.

- Use uma pulseira anti-estática ligada por um fio à terra.
- Trabalhe num local sem energia estática com tapetes de proteção anti-estática e tapetes para bancadas de trabalho.

### 5.4.2 Acesso elétrico

Coloque os cabos dos dispositivos externos através das caixas de empanque para cabos. Consulte a [Figura 8](#) na página 458. Mantenha as fichas nas caixas de empanque para cabos que não são utilizadas.

[Figura 9](#) na página 461 apresenta os componentes no interior do analisador. O interruptor de alimentação é um disjuntor que desliga automaticamente a fonte de alimentação principal da linha elétrica CA se ocorrer uma situação de sobretensão (por exemplo, curto-circuito) ou sobretensão.

### 5.4.3 Ligar os dispositivos externos

Ligue os dispositivos externos que serão utilizados com o analisador aos terminais de sinal e controlo do analisador. Consulte a [Figura 10](#) na página 465 e a [Tabela 1](#) na página 103.

**Tabela 1 Terminais de sinal e controlo—Descrições**

Pino	Descrição
AO1–AO8 (P101)	Oito saídas analógicas para controlar dispositivos externos. Para obter mais informações, consulte a versão alargada do manual do utilizador online.
FCT1–FCT5 (P102)	<p>Cinco relés (contactos sem potencial). A carga máxima é de 24 V CC, 0,5 A.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FCT1—Alarme de avaria</li> <li>• FCT2—Alarme de manutenção</li> <li>• FCT3—Analisador pronto</li> <li>• FCT4 e FCT5—Para utilização futura</li> </ul>
DI1–DI7 (P103)	<p>Sete entradas digitais para controlar o analisador remotamente<sup>5</sup>. Ligue as entradas digitais a um contacto externo sem potencial (24 V CC) para ativar o analisador para iniciar uma medição de um canal.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DI1—Arranque remoto para o canal 1</li> <li>• DI2—Arranque remoto para o canal 2</li> <li>• DI3 a DI7—Para utilização futura</li> </ul>
FB1–FB4 (P104)	<p>Conectores Profibus DP ou Modbus RTU (RS485)</p> <p><b>Profibus DP:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FB1—A1 (entrada)</li> <li>• FB2—A2 (saída)</li> <li>• FB3—B1 (entrada)</li> <li>• FB4—B2 (saída)</li> <li>• SHL—Proteção</li> </ul> <p><b>Modbus RTU:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FB1—D (+)</li> <li>• FB2—D (-)</li> <li>• FB3—Não utilizado</li> <li>• FB4—Não utilizado</li> <li>• SHL—Proteção</li> </ul> <p>Consulte a documentação do controlador SC4500 para obter instruções de configuração Modbus e etiquetas de telegrama.</p>
24 V CC/1 A (P105)	Fonte de alimentação de 24 V CC para as unidades de filtragem EZ9010 e EZ9020

<sup>5</sup> Se o analisador estiver no modo de manutenção, o controlo remoto é desativado.

**Tabela 1 Terminais de sinal e controlo—Descrições (continuação)**

Pino	Descrição
STR1—STR8 (P106)	Oito saídas digitais para o painel Moduplex opcional. Ligue os fios descarnados de cada válvula de canal no painel Moduplex aos conectores STR relacionados. <ul style="list-style-type: none"><li>• STR1—Canal 1</li><li>• STR2—Canal 2</li><li>• ...</li><li>• STR8—Canal 8</li></ul>
EXT9—EXT12 (P107)	Quatro saídas digitais para o painel de filtragem opcional EZ9150. Ligue as válvulas elétricas e a bomba no painel de filtragem EZ9150 aos conectores EXT. <ul style="list-style-type: none"><li>• EXT9—Válvula de enxaguamento</li><li>• EXT10—Válvula de inversão de fluxo</li><li>• EXT11—Válvula de "overflow" de drenagem</li><li>• EXT12—Bomba de filtração</li></ul>
D01—D06 (P108 e P109)	Seis saídas de válvulas pneumáticas para o painel EZ9150. <ul style="list-style-type: none"><li>• D01—Válvula de entrada da amostra</li><li>• D02—Válvula de "overflow" de drenagem</li><li>• D03—Válvula do Canal 1</li><li>• D04—Válvula do Canal 2</li><li>• D05—Válvula do Canal 3</li><li>• D06—Válvula do Canal 4</li></ul>

#### 5.4.4 Ligar à alimentação CA

### ▲ PERIGO



Perigos de incêndio e de electrocussão. Certifique-se de que o cabo e a ficha sem bloqueio fornecidos cumprem os requisitos do código do país aplicáveis.


- Certifique-se de que o disjuntor instalado na linha elétrica tem capacidade de corrente elétrica suficiente.
- Certifique-se de que o disjuntor ou um interruptor de emergência está instalado próximo do analisador para que o analisador possa ser imediatamente desligado da fonte de alimentação, se necessário.
- Ligue o equipamento de acordo com os códigos elétricos locais, estatais ou nacionais.
- Instale o cabo de alimentação fornecido através da caixa de empanque para cabos que se encontra na parte lateral do analisador.
- Aperte a caixa de empanque para cabos para segurar o cabo de alimentação de forma segura e manter a classificação ambiental da estrutura.

Ligue o analisador à alimentação CA com o cabo de alimentação CA fornecido. Consulte a [Tabela 2](#) na página 105 e a [Figura 11](#) na página 468.

## ATENÇÃO

Não ligue o interruptor de alimentação. Efetue todas as ligações elétricas e de canalização antes do arranque. Caso contrário, poderão ocorrer danos no analisador.


**Tabela 2 Informações sobre cablagem—Alimentação CA**

Terminal	Descrição	Cor do cabo - América do Norte e Canadá	Cor do cabo - UE
L	Carregado/Linha (L)	Preto (1)	Castanho
N	Neutro (N)	Branco (2)	Azul
	Ligação à terra (PE)	Verde com faixa amarela	Verde com faixa amarela

PT-PT

## 5.5 Nivelamento

### 5.5.1 Diretrizes da linha de amostra


<b>▲ AVISO</b>	
	Perigo de incêndio. Este produto não está preparado para utilização com amostras inflamáveis.


Selecione um bom ponto de amostra representativo do melhor desempenho do equipamento. A amostra deve ser representativa de todo o sistema.

- Certifique-se de que o caudal da amostra é superior ao caudal para o analisador.
- Certifique-se de que a linha de amostra está à pressão atmosférica se o analisador utilizar uma bomba peristáltica para deslocar a amostra para o recipiente de análise.
- Certifique-se de que a linha de amostra recolhe a amostra de um pequeno recipiente de extravasamento próximo do analisador.
- Utilize a linha de amostra fornecida. Não altere o comprimento da linha de amostra.

A amostra no recipiente de extravasamento deve ser continuamente renovada. Se o tamanho de sólidos na amostra for demasiado grande, recomenda-se também a filtração da amostra.

### 5.5.2 Diretrizes da linha de drenagem

<b>▲ ADVERTÊNCIA</b>	
	Perigo de incêndio. O utilizador é responsável por garantir que são aplicadas precauções suficientes quando o equipamento é utilizado com métodos que necessitem de recorrer a líquidos inflamáveis. Certifique-se de que respeita as precauções do utilizador e os protocolos de segurança adequados. Tal inclui, entre outros, o controlo de derrames e fugas, uma ventilação adequada, a não utilização sem supervisão e a garantia de que o equipamento nunca é deixado sem supervisão quando a alimentação estiver ligada.

<b>▲ AVISO</b>	
	Perigo de exposição a produtos químicos. Elimine os produtos químicos e os resíduos de acordo com os regulamentos locais, regionais e nacionais.

## ATENÇÃO

Não ligue as linhas de drenagem a outras linhas, dado que isso pode resultar em contrapressão ou danos no analisador. Certifique-se de que as linhas de drenagem estão abertas ao ar exterior.

## ATENÇÃO

Para evitar a ocorrência de contrapressão e danos no analisador, certifique-se de que o analisador está mais elevado do que o(s) dreno(s) da instalação utilizado(s) e que a linha de drenagem tem uma inclinação descendente constante. Instale as linhas de drenagem com um declínio vertical de 2,54 cm (1 polegada) ou mais por cada 0,3 m (1 pé) de comprimento dos tubos.

O analisador utiliza a linha de drenagem para libertar a amostra e os reagentes após a análise. A instalação correta das linhas de drenagem é importante para se certificar de que todo o líquido é removido do equipamento. A instalação incorreta pode fazer com que o líquido volte a entrar no equipamento e cause danos. Uma drenagem para o chão ou para a pia é suficiente para a linha de drenagem. Recomenda-se um tubo de drenagem com um diâmetro externo de 32 mm. Consulte a **Figura 12** na página 471.

- Faça as linhas de drenagem o mais curtas possível.
- Certifique-se de que a drenagem fica abaixo do analisador.
- Certifique-se de que as linhas de drenagem têm uma inclinação constante para baixo.
- Certifique-se de que as linhas de drenagem não têm curvas pronunciadas e não ficam esmagadas.
- Certifique-se de que as linhas de drenagem estão abertas ao ar e estão com pressão zero.
- Certifique-se de que as linhas de drenagem estão protegidas das condições ambientais da sala de instalação.
- Não bloqueie nem mergulhe a linha de drenagem.

Uma ligação de água próximo do analisador também é recomendada para que a drenagem para a pia e os tubos de drenagem sejam regularmente lavados com água limpa a fim de evitar bloqueios por cristalização.

Consulte a folha de reagentes e métodos do modelo da série EZ aplicável para obter mais informações sobre os reagentes utilizados no analisador. Se o analisador utilizar reagentes inflamáveis, certifique-se de que respeita as seguintes precauções de segurança:

- Não ligue a linha de drenagem a uma conduta de drenagem no chão.
- Elimine os resíduos de acordo com os regulamentos ambientais locais, estatais e nacionais.

### 5.5.3 Diretrizes da linha de ventilação

#### ⚠ ADVERTÊNCIA



Perigo de incêndio. O utilizador é responsável por garantir que são aplicadas precauções suficientes quando o equipamento é utilizado com métodos que necessitem de recorrer a líquidos inflamáveis. Certifique-se de que respeita as precauções do utilizador e os protocolos de segurança adequados. Tal inclui, entre outros, o controlo de derrames e fugas, uma ventilação adequada, a não utilização sem supervisão e a garantia de que o equipamento nunca é deixado sem supervisão quando a alimentação estiver ligada.

#### ⚠ AVISO



Perigo de exposição a produtos químicos. Elimine os produtos químicos e os resíduos de acordo com os regulamentos locais, regionais e nacionais.

## ATENÇÃO

Não ligue a linha de ventilação (porta do gás de escape) a outras linhas, dado que isso pode resultar em contrapressão ou danos no analisador. Certifique-se de que a linha de ventilação está aberta ao ar no exterior do edifício.

## ATENÇÃO

Para evitar a ocorrência de contrapressão e danos no analisador, certifique-se de que o analisador está mais elevado do que a(s) abertura(s) de ventilação utilizada(s) na instalação e que a linha de ventilação tem uma inclinação descendente constante. Instale a linha de ventilação com um declínio vertical de 2,54 cm (1 polegada) ou mais por cada 0,3 m (1 pé) de comprimento dos tubos.


O analisador utiliza a linha de ventilação para manter o recipiente de análise à pressão atmosférica. A instalação correta da linha de ventilação é importante para garantir que, durante o funcionamento da bomba, não entra líquido no recipiente de análise a partir da linha de ventilação. A instalação incorreta pode fazer com que o gás volte a entrar no analisador e cause danos. O diâmetro externo recomendado para o tubo coletor da linha de ventilação é de 32 mm. Consulte a [Figura 12](#) na página 471.

- Faça a linha de ventilação o mais curta possível.
- Certifique-se de que a linha de ventilação tem uma inclinação constante para baixo.
- Certifique-se de que a linha de ventilação não tem uma curva pronunciada e não fica esmagada.
- Certifique-se de que a linha de ventilação está protegida das condições ambientais da sala de instalação e está com pressão zero.
- Certifique-se de que o tubo de ventilação está sempre acima da drenagem.
- Não bloqueie nem mergulhe a linha de ventilação.

Se o analisador utilizar reagentes inflamáveis, certifique-se de que respeita as seguintes precauções de segurança:



- Não ligue a linha de ventilação a uma conduta de drenagem no chão.
- Elimine os resíduos de acordo com os regulamentos ambientais locais, estatais e nacionais.

#### 5.5.4 Ligue o analisador para o teste dos componentes

<b>⚠ AVISO</b>	
	Perigo de incêndio. Este produto não foi concebido para uso com líquidos inflamáveis.


Antes de o analisador com todos os reagentes ser colocado em funcionamento, tem de ser realizado um teste dos componentes com água desionizada. Consulte os passos ilustrados e [Realizar os testes dos componentes](#) na página 111.

1. Instale os quatro tubos da válvula de manga flexível, conforme apresentado no passo 1 ilustrado abaixo.
  - a. Prima o botão preto e, em seguida, empurre os tubos para a válvula.
  - b. Solte o botão quando os tubos estiverem corretamente instalados.
2. Certifique-se de que os tubos de drenagem estão corretamente instalados no recipiente da amostra. Consulte o passo 2 ilustrado abaixo.
3. Certifique-se de que os tubos do digestor estão corretamente instalados no recipiente do digestor. Consulte o passo 3 ilustrado abaixo.
4. Ligue todos os tubos de líquido do analisador a um frasco grande de água desionizada para realizar um teste aos componentes. Consulte o passo 3 ilustrado abaixo. Os tubos são instalados de fábrica.

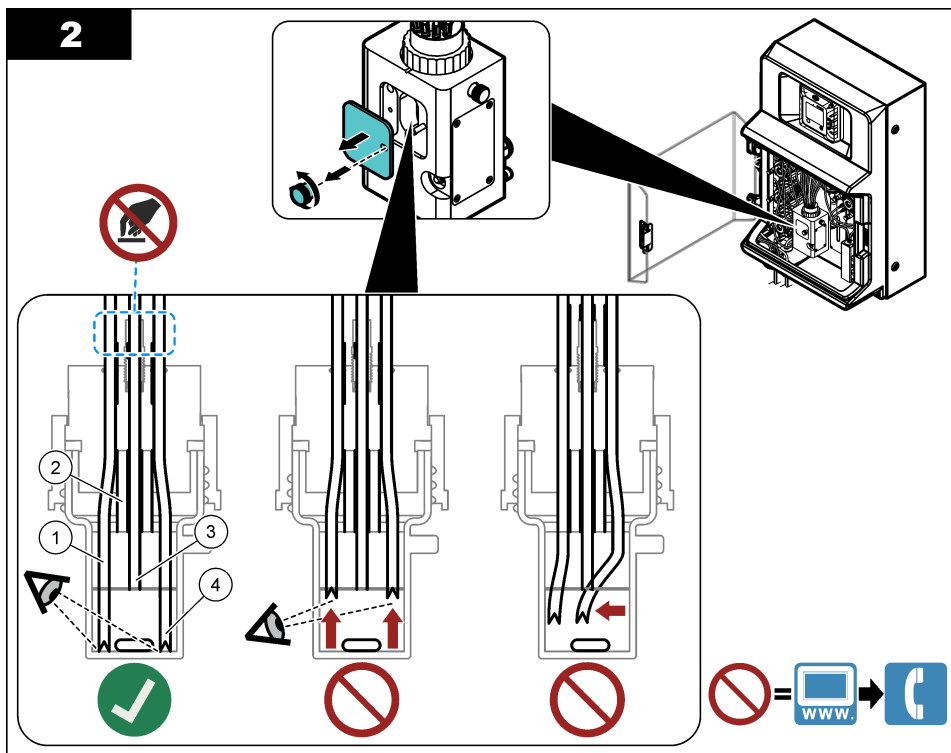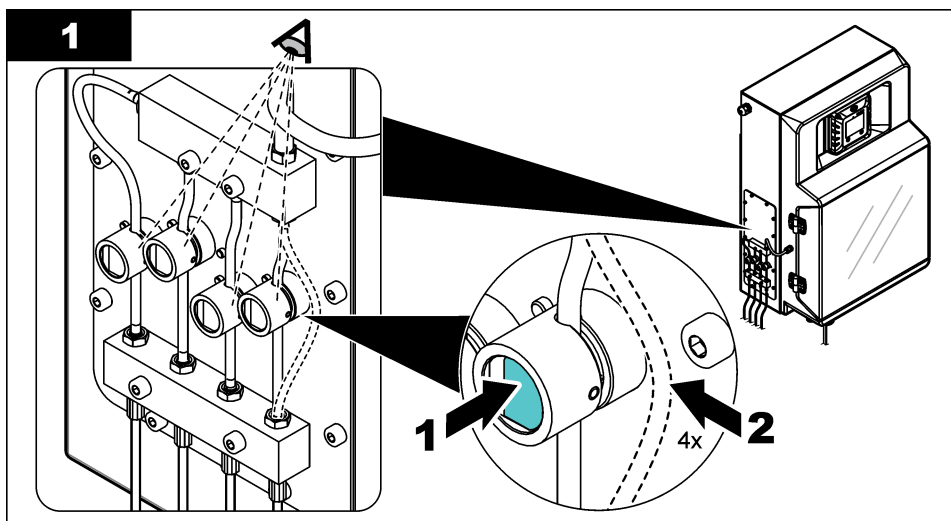

1 Tubos de drenagem	3 Tubos de amostras
2 Tubos de reagentes e ventilação (tubos superiores)	4 Tubos do digestor


3

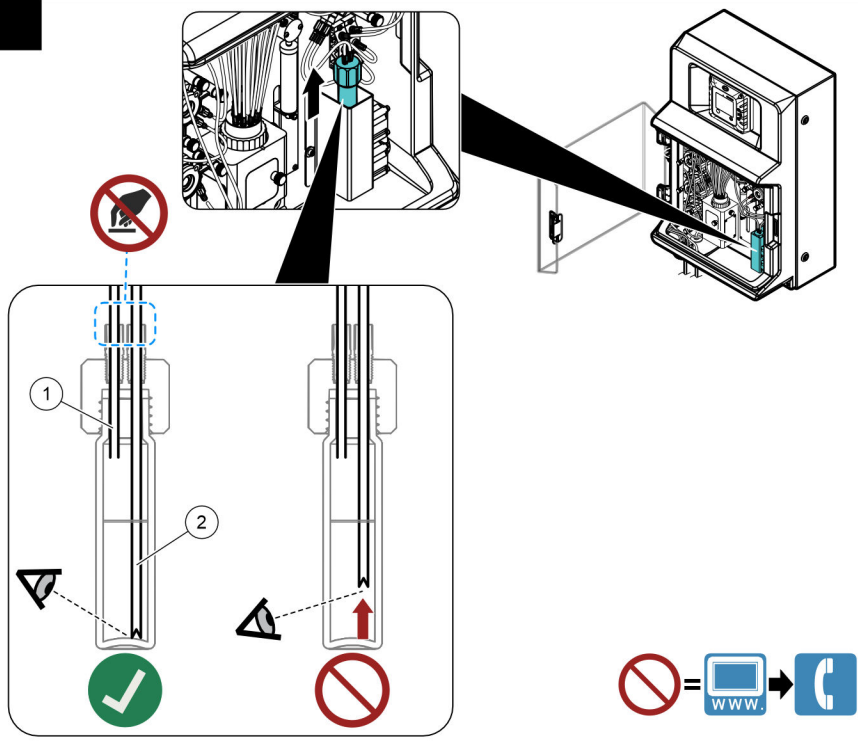

PT-PT

1 Tubos de ventilação	2 Tubos do digestor
-----------------------	---------------------

4

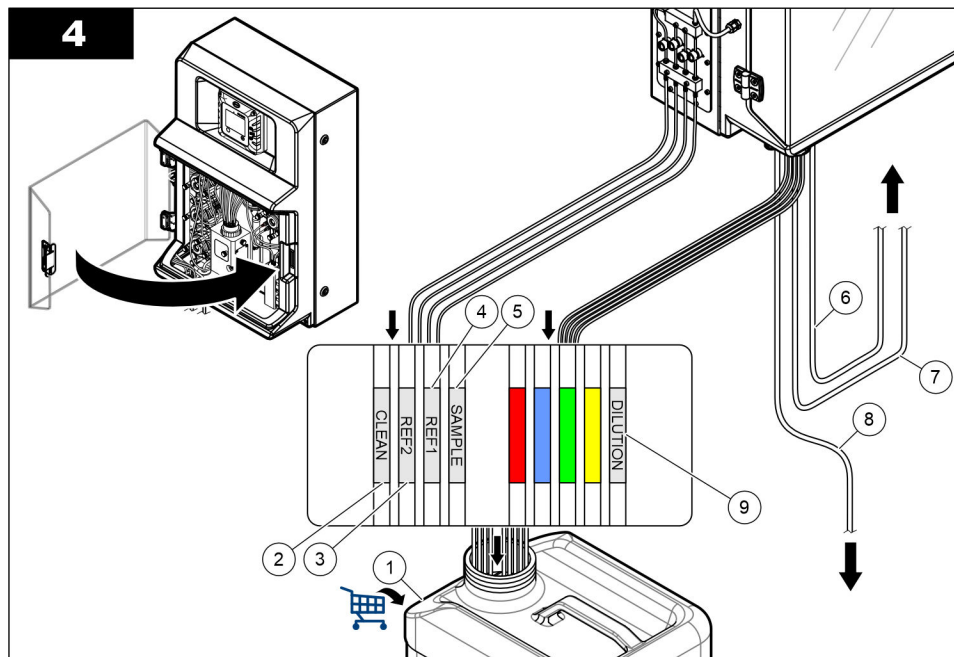

1 Água desionizada	4 Tubo de solução de referência 1 (REF1)	7 Digestor de ventilação
2 Tubo de solução de limpeza	5 Tubo de entrada da amostra	8 Tubos de drenagem
3 Tubo de solução de referência 2 (REF2)	6 Tubos de ventilação	9 Tubos de diluição e de reagente da microbomba

## Secção 6 Arranque

### 6.1 Arranque inicial

**Nota:** Certifique-se de que a montagem, a tubagem e as instalações elétricas estão totalmente concluídas antes do arranque. Consulte [Instalação](#) na página 101.

Quando o analisador é ligado pela primeira vez, um assistente de arranque irá ajudar nos primeiros passos para concluir a configuração. Conclua todos os passos que se seguem para se certificar de que o analisador está a funcionar corretamente.

**Nota:** Certifique-se de que utiliza os reagentes corretos para o intervalo de medição selecionado. Para obter mais informações, consulte a versão alargada do manual do utilizador online.

1. Abra a porta do analisador. Consulte [Abra a porta do analisador](#) na página 102.
2. Ligue o interruptor de alimentação para a posição ligada. Consulte [Figura 9](#) na página 461.
3. Feche a porta do analisador com a chave fornecida.
4. Aguarde a conclusão do procedimento de inicialização.
5. Responda às instruções no display para selecionar o idioma, o fuso horário, a data e a hora. Para configurar as outras definições do controlador, consulte a documentação do controlador SC4500.
6. Toque no display para apresentar o menu do **EZ2700sc**.
7. Selecione **Menu do dispositivo** para iniciar o assistente de arranque. É apresentado o ecrã de boas-vindas.

8. Conclua os passos apresentados no display para selecionar o intervalo de medição aplicável. Prima **OK**.
9. Se estiver instalada uma unidade de filtragem, selecione **Ligado**. Caso contrário, selecione **Desligado**.
10. Selecione o número de canais para o analisador. Prima **OK**.
11. Se a configuração apresentada na página de resumo estiver correta, prima **OK**. É apresentado o menu principal do **EZ2700sc**.
12. Continue com o teste dos componentes. Consulte a [Realizar os testes dos componentes](#) na página 111.

## 6.2 Realizar os testes dos componentes

### ⚠ ADVERTÊNCIA



Perigo de entalamento. As peças que se movem podem causar entalamento e provocar danos. Não toque nas peças em movimento.

Realize os testes dos componentes antes de colocar o analisador em funcionamento. Utilize o menu **Manutenção** para iniciar as diferentes funções do analisador para examinar o funcionamento do componente.

#### Pré-requisitos:

- Se o analisador estiver no modo operacional, selecione **Manutenção > Iniciar o modo de manutenção**.
- Certifique-se de que os tubos de amostra, reagente e solução estão num recipiente de água desionizada. Consulte a [Ligue o analisador para o teste dos componentes](#) na página 107.

#### 6.2.1 Examinar o agitador

1. Retire a proteção da luz da unidade do fotómetro. Consulte a [Figura 13](#) na página 472.
2. Certifique-se de que o agitador se encontra no fundo do recipiente da amostra.  
*Nota: Examine o agitador durante o procedimento de preparação para se certificar de que este roda corretamente. O procedimento de preparação é iniciado em [Examinar as bombas e as válvulas de manga flexível](#) na página 111.*
3. Instale a proteção da luz no fotómetro.

#### 6.2.2 Examinar as bombas e as válvulas de manga flexível

1. Examine o funcionamento das bombas e das válvulas de manga flexível para se certificar de que não existem fugas.
2. Certifique-se de que o recipiente de análise se enche com água desionizada. Consulte a [Figura 14](#) na página 474.
3. Certifique-se de que sai água desionizada pelos tubos de drenagem.
4. Selecione **Manutenção > Iniciar preparação** e prepare todos os líquidos em separado.  
Se ocorrer uma fuga, examine todas as ligações e consulte a versão alargada do manual do utilizador online para obter mais informações.
  - a. Selecione **Preparar referência 1** e prima **OK**.
  - b. Selecione **Preparar referência 2** e prima **OK**.
  - c. Selecione **Preparar solução de limpeza** e prima **OK**.
  - d. Selecione **Preparar enxaguamento** e prima **OK**.
  - e. Selecione **Preparar dispensador** e prima **OK**.
  - f. Selecione **Preparar canal > Preparar todos os canais** e prima **OK**.  
Cada procedimento de preparação para automaticamente depois de concluído.

### 6.2.3 Examinar as microbombas

Examine as microbombas quanto a fugas e bolhas de ar.

1. Retire a proteção da luz do fotómetro.
2. Selecione **Manutenção > Iniciar preparação > Preparar todos os reagentes**.
3. Certifique-se de que entra água desionizada na microbomba através de cada um dos tubos (reagente) da microbomba. Em seguida, no recipiente de análise continuamente sem bolhas de ar. Consulte a [Figura 15](#) na página 475.
4. Se as microbombas não funcionarem corretamente (bolhas nos tubos), utilize o procedimento da seringa para empurrar água desionizada para os tubos aplicáveis para remover as bolhas. Consulte a [Figura 16](#) na página 476.
5. Instale a proteção da luz no fotómetro.

### 6.2.4 Realizar uma verificação do fotómetro

Certifique-se de que a parte exterior do recipiente de análise está limpa antes de realizar a verificação do fotómetro para que possa ser concluída com sucesso. Para limpar os componentes do analisador, consulte a versão alargada do manual do utilizador online para obter mais informações.

1. Prima o ícone do menu principal e, em seguida, selecione **Dispositivos**.
2. Selecione **EZ2700sc**.
3. Desloque-se para baixo até ao fundo do ecrã e, em seguida, selecione **Menu do dispositivo**.
4. Selecione **Manutenção > Verificação do fotómetro**.
5. Prima **OK** para iniciar a medição.  
Quando a calibração escura estiver concluída, o resultado é apresentado no display.
6. Prima **OK** para continuar.
7. Certifique-se de que os tubos "REF1" estão ligados a um recipiente cheio com água desionizada. Certifique-se de que a proteção da luz está instalada. Consulte a [Figura 18](#) na página 479.
8. Prima **OK**.  
Aguarde até que o recipiente de análise esteja cheio.
9. Utilize uma chave de parafusos para ajustar a tensão da saída do sensor para 9 V. Consulte a [Figura 17](#) na página 476.
10. Aguarde até que o valor de 9 V seja apresentado no ecrã. Em seguida, prima **OK**.
11. Prima **OK** para continuar.

## 6.3 Realizar um teste de sinal de entrada

Realize um teste às entradas digitais antes de colocar o analisador em funcionamento.

**Pré-requisitos:** Ligue as entradas digitais a um contacto externo sem potencial (24 V CC).

Realize um teste ao sinal de entrada digital e ao sinal de saída analógica da seguinte forma:

1. Prima o ícone do menu principal e, em seguida, selecione **Dispositivos**.
2. Selecione **EZ2700sc**.
3. Desloque-se para baixo até ao fundo do ecrã e, em seguida, selecione **Menu do dispositivo**.
4. Selecione **Diagnóstico > Sinais**.  
Os sinais nas entradas digitais são apresentados.
5. Compare o estado das entradas digitais no display com as tensões fornecidas às entradas digitais (24 V = Ligado; 0 V = Desligado).

## 6.4 Realizar um teste de sinal de saída

Realize um teste às saídas analógicas antes de colocar o analisador em funcionamento.

**Pré-requisitos:** Configure as saídas analógicas (AO1–AO8, P101) para selecionar a medição do canal representada por cada saída analógica. Para obter mais informações, consulte a versão alargada do manual do utilizador online.

Realize um teste de sinal de saída analógica da seguinte forma:

1. Prima o ícone do menu principal.
2. Selecione **Saídas > Saídas mA AOC > Teste/manutenção**.

Opção	Descrição
Teste de funções	Realiza um teste às saídas no módulo selecionado.
Estado de saída	Indica o estado das saídas no módulo selecionado.

3. Utilize um multímetro para medir o valor de mA em cada saída analógica.
4. Compare o valor de mA medido nas saídas analógicas com os valores de mA esperados.

## 6.5 Definir a sequência de canais



Selecione a sequência pela qual os canais são medidos, o número de vezes que cada canal é medido e o tempo de espera antes de medir um canal. Introduza um máximo de 16 linhas com um máximo de 16 ciclos cada.

1. Prima o ícone do menu principal e, em seguida, selecione **Dispositivos**.
2. Selecione **EZ2700sc**.
3. Desloque-se para baixo até ao fundo do ecrã e, em seguida, selecione **Menu do dispositivo**.
4. Se o analisador estiver em modo operacional, selecione **Manutenção > Iniciar o modo de manutenção**.  
Aguarde até que o analisador esteja no modo de manutenção.
5. Selecione **Configuração > Configuração da sequência de canais**.
6. Utilize as setas na barra lateral para selecionar uma posição (número na sequência) e, em seguida, prima **OK** para configurar essa posição.
7. Selecione uma opção.

Opção	Descrição
Selecionar	Seleciona o canal ou o tempo de espera aplicável.
Número de medições	Define o número de medições para um canal.
Tempo de espera	Define o tempo de espera para o canal selecionado.

8. Prima **OK** para guardar as alterações.

## 6.6 Ligar as soluções e a amostra

⚠ AVISO	
	Perigo de exposição a produtos químicos. Siga os procedimentos de segurança do laboratório e utilize todo o equipamento de protecção pessoal adequado aos produtos químicos manuseados. Consulte as fichas de dados sobre segurança de materiais (MSDS/SDS) para protocolos de segurança.
⚠ AVISO	
	Perigo de exposição a produtos químicos. Elimine os produtos químicos e os resíduos de acordo com os regulamentos locais, regionais e nacionais.

## ▲ AVISO



Perigo de incêndio. Este produto não foi concebido para uso com líquidos inflamáveis.

Os recipientes dos reagentes são fornecidos com o analisador. Consulte [Figura 18](#) na página 479. Os recipientes para a solução de referência 1, a solução de referência 2 e água desionizada são fornecidos pelo utilizador. É possível adquirir mais recipientes ao fabricante.

Instale os recipientes

- o mais próximo possível do analisador
- 1 metro abaixo da parte inferior do analisador

Consulte a [Figura 18](#) na página 479 para a instalação do recipiente.

Os reagentes e as soluções são fornecidos pelo utilizador. Utilize apenas reagentes fornecidos por uma empresa certificada ou utilize reagentes dedicados do fabricante. Como alternativa, os reagentes podem ser preparados pelo utilizador. Siga as instruções na folha de reagentes e métodos para o modelo aplicável no website do fabricante.

Os tubos são instalados de fábrica. Leia a etiqueta existente em cada tubo para identificar a ligação de canalização correta. Consulte a folha de reagentes e métodos aplicável para o modelo no website do fabricante para obter informações sobre os reagentes, soluções e padrões corretos.

1. Após a realização dos testes dos componentes, instale os tubos "CLEAN" (solução de limpeza), "REF1" (solução de referência 1) e "REF2" (solução de referência 2) nos recipientes relacionados. Consulte a [Figura 18](#) na página 479.
2. Instale cada tubo de reagente codificado por cores no recipiente do reagente com a mesma cor na etiqueta.
3. Ligue a fonte da amostra (ou a saída da amostra do painel Moduplex ou do painel do filtro) ao tubo de entrada da amostra do analisador. Consulte a [Figura 18](#) na página 479.
4. Prima o ícone do menu principal e, em seguida, selecione **Dispositivos**.
5. Selecione **EZ2700sc**.
6. Desloque-se para baixo até ao fundo do ecrã e, em seguida, selecione **Menu do dispositivo**.
7. Selecione **Manutenção > Iniciar preparação > Preparar tudo**.

## 6.7 Efetuar uma validação antes do arranque inicial

Efetue uma validação para se certificar de que as medições estão dentro do intervalo de tolerância. Para obter mais informações, consulte a versão alargada do manual do utilizador online.

1. Prima o ícone do menu principal e, em seguida, selecione **Dispositivos**.
2. Selecione **EZ2700sc**.
3. Desloque-se para baixo até ao fundo do ecrã e, em seguida, selecione **Menu do dispositivo**.
4. Para iniciar uma validação, selecione **Calibração > Validação > Iniciar validação**.  
A validação mede a água desionizada no frasco de Referência 2.
5. Para apresentar os resultados, selecione uma opção:
  - **Calibração > Validação > Histórico de validações**
  - **Diagnóstico > Dados do histórico > Validação**

## 6.8 Iniciar o analisador

Para iniciar o analisador:

1. Prima o ícone do menu principal e, em seguida, selecione **Dispositivos**.
2. Selecione **EZ2700sc**.

3. Desloque-se para baixo até ao fundo do ecrã e, em seguida, selecione **Menu do dispositivo**.
4. Selecione **Manutenção > Iniciar modo operacional**.

# Obsah

- 1 [Doplňující informace](#) na straně 116
- 2 [Popis výrobku](#) na straně 116
- 3 [Technické údaje](#) na straně 117

- 4 [Obecné informace](#) na straně 118
- 5 [Instalace](#) na straně 120
- 6 [Spuštění](#) na straně 129

## Kapitola 1 Doplňující informace

Základní uživatelská příručka obsahuje informace, které postačují k uvedení do provozu. Rozšířená uživatelská příručka je k dispozici online a obsahuje další informace.

### ▲ NEBEZPEČÍ



Více druhů nebezpečí! Další informace jsou uvedeny v jednotlivých částech rozšířené uživatelské příručky, v částech uvedených níže.

- Uživatelské rozhraní a navigace
- Provoz
- Údržba
- Řešení problémů
- Seznamy náhradních dílů

Naskenováním následujících QR kódů přejdete na rozšířenou uživatelskou příručku.



Evropské jazyky



Americké a asijské jazyky

## Kapitola 2 Popis výrobku

Analyzátor Hach EZ2700sc je online analyzátor, který měří jeden parametr ve vzorcích vody z průmyslových a environmentálních aplikací. Viz [Obr. 1](#) na straně 437, [Obr. 2](#) na straně 440 a [Obr. 3](#) na straně 445.

Tento analyzátor je online kolorimetrický analyzátor pro obecnou analýzu vody (např. dusičnany, fosfáty). Analyzátor má možnosti dálkového spuštění, automatické validace, automatické kalibrace, automatického čištění a Modbus.

Vzorková voda vstupuje do analyzátoru vzorkovací hadičkou. Čerpadla, ventily a stříkačky v analyzátoru přenášejí vzorek a reagentie do měřicí kvety na analytickém panelu. Po dokončení analýzy analyzátor odstraní vzorek vypouštěcí hadičkou. Výsledky analýzy se zobrazí na displeji kontroléru SC4500. Kontrolér SC4500 ukládá data analyzátoru (datový protokol, protokol událostí, protokol nastavení a servisní protokol). K provozu a konfiguraci analyzátoru použijte kontrolér SC4500.

Chcete-li zvýšit počet proudů vzorků (kanálů), které analyzátor dokáže měřit (2, 4 nebo 8), zakupte s analyzátozem panel Moduplex s více proudy.

Za účelem předběžné úpravy vzorku (filtrace, usazování) zakupte s analyzátozem filtrační panel EZ9010, EZ9020, EZ9150, EZ9200 nebo EZ9250.

## Kapitola 3 Technické údaje

Specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Technický údaj	Podrobnosti
Rozměry (Š x V x H)	460 x 688 x 340 mm (18,1 x 27,1 x 13,4 palce)
Kryt	IP44; ABS, PMMA a potažená ocel
Displej	IP66, 3,5palcový barevný TFT displej s kapacitativní dotykovou plochou
Hmotnost	40 kg (88 lb)
Požadavky na napájení	100 až 240 V AC $\pm 10$ %, 50/60 Hz
Spotřeba energie	Maximálně 240 VA
Nadmořská výška	maximálně 2000 m (6560 ft)
Kategorie přepětí	II
Podmínky okolního prostředí	Používejte pouze v interiéru
Stupeň znečištění	2
Provozní teplota	10 až 30 °C (50 až 86 °F); relativní vlhkost 5 až 95 %, bez kondenzace, nekondenzující
Skladovací teplota	-20 až 60 °C (-4 až 140 °F), 95% relativní vlhkost, bez kondenzace, maximum
Přívody vzorku	Jeden
Tlak vzorku	Vnější přepadovou nádobou (otevřenou na atmosférický tlak)
Rychlost průtoku vzorku	100 až 300 mL/min
Teplota vzorku	10 až 30 °C (50 až 86 °F)
Kvalita vzorku	< 100 $\mu$ m částice, < 0,1 g/L maximálně Zákal < 50 NTU
Čištění vzduchem pro korozivní prostředí	0,2 bar (20 kPa nebo 3 psi); suchý a čistý vzduch
Odtok	Atmosférický tlak, odvětrávaný, min. $\varnothing$ 32 mm
Zemnění	Suchá a čistá zemnicí tyč s nízkou impedancí (< 1 $\Omega$ ) se zemnicím kabelem > 2,5 mm <sup>2</sup> (13 AWG)
Analogové výstupy	Max. osm analogových výstupů 0–20 mA (nebo 4–20 mA) <b>Poznámka:</b> Analogové výstupy dodávají smyčkové napájení. Napájení nelze dodávat do kontaktů systému SCADA nebo PLC.
Digitální vstupy	Sedm digitálních vstupů: dva digitální vstupy pro vzdálené spouštění. Zbývající digitální vstupy pro budoucí použití.
Digitální výstupy	Čtyři napájené digitální výstupy pro ventily a čerpadla panelu EZ9150; osm napájených digitálních výstupů pro ventily panelu Moduplex; 24 V DC, 500 mA.
Relé	Pět bezpotenciálových kontaktů (FCT), maximální zatížení 24 V DC, 0,5 A (odporová zátěž)
Ethernetové přípojky	Ethernetové připojení systému Claros a ethernetový konektor Modbus TCP/IP; verze LAN; 10/100 Mb/s nebo Profinet nebo Ethernet IP
Komunikace přes RS485	Profibus DP nebo Modbus RTU

CS

<sup>2</sup> Informace o konfiguraci sítě Ethernet a Modbus naleznete v dokumentaci ke kontroléru SC4500.

Technický údaj	Podrobnosti
Certifikáty	CE, certifikace ETL podle bezpečnostních norem UL a CSA, UKCA
Záruka	1 rok (EU: 2 roky)

## Kapitola 4 Obecné informace

Výrobce v žádném případě neodpovídá za poškození vzniklá v důsledku nesprávného používání produktu nebo nedodržení pokynů v návodu k obsluze. Výrobce si vyhrazuje právo provádět v tomto návodu a výrobcích v něm popisovaných změny, a to kdykoliv, bez předchozích oznámení či jakýchkoli následných závazků. Revidovaná vydání jsou dostupná na internetových stránkách výrobce.

### 4.1 Bezpečnostní informace

Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávnou aplikací nebo nesprávným použitím tohoto produktu včetně (nikoli pouze) přímých, náhodných a následných škod a zříká se odpovědnosti za takové škody v plném rozsahu, nakolik to umožňuje platná legislativa. Uživatel je výhradně zodpovědný za určení kritických rizik aplikace a za instalaci odpovídajících mechanismů ochrany procesů během potenciální nesprávné funkce zařízení.

Před vybalením, montáží a uvedením přístroje do provozu si prosím pozorně přečtete celý tento návod. Zvláštní pozornost věnujte všem upozorněním na možná nebezpečí a výstražným informacím. V opačném případě může dojít k vážným poraněním obsluhy a poškození přístroje.

Pokud je zařízení používáno způsobem, který není specifikován výrobcem, může dojít ke zhoršení ochrany poskytované zařízením. Neinstalujte toto zařízení ani jej nepoužívejte žádným jiným způsobem, než je uvedeno v tomto návodu.

#### 4.1.1 Informace o možném nebezpečí

##### ▲ NEBEZPEČÍ

Označuje možnou nebo bezprostředně rizikovou situaci, jež může v případě, že jí nezabráníte, vést k usmrcení nebo vážnému zranění.

##### ▲ VAROVÁNÍ

Upozorňuje na možné nebo skryté nebezpečné situace, jež by bez vhodných preventivních opatření mohly vést k úmrtí nebo vážnému poranění.

##### ▲ POZOR

Upozorňuje na možnou nebezpečnou situaci, jež by mohla mít za následek menší nebo mírné poranění.

##### UPOZORNĚNÍ

Označuje situaci, která může způsobit poškození přístroje, pokud se nezabrání jejímu vzniku. Upozorňuje na informace vyžadující zvláštní pozornost.

#### 4.1.2 Výstražné symboly





Přečtete si všechny štítky a etikety na přístroji. V opačném případě může dojít k poranění osob nebo poškození přístroje. Odkazy na symboly na přístroji naleznete v návodu spolu s výstražnou informací.



Toto je symbol bezpečnostního upozornění. Řiďte se všemi bezpečnostními oznámeními s tímto symbolem, abyste předešli možnému zranění. Pokud je umístěn na přístroji, podívejte se do referenční příručky na informace o funkci a bezpečnosti.




Tento symbol upozorňuje na nebezpečí působení chemických látek. Zacházení s chemikáliemi a provádění údržbových prací na zařízeních dopravujících chemické látky je povoleno pouze kvalifikovaným osobám vyškoleným k práci s chemikáliemi.





	Symbol upozorňuje na možnost úrazu nebo usmrcení elektrickým proudem.
	Tento symbol označuje přítomnost zařízení citlivého na elektrostatický výboj a znamená, že je třeba dbát opatrnosti, aby nedošlo k poškození zařízení.
	Tento symbol označuje, že označená položka vyžaduje ochranné uzemnění. Přístroj není dodáván se zemnicí zástrčkou na kabelu, provedte ochranné zemnicí připojení do ochranného kondukčního terminálu.
	Elektrické zařízení označené tímto symbolem se nesmí likvidovat v evropských systémech domácího nebo veřejného odpadu. Staré nebo vysloužilé zařízení vraťte výrobci k bezplatné likvidaci.

CS

#### 4.1.3 Chemická a biologická bezpečnost

<b>⚠ NEBEZPEČÍ</b>	
	Chemické nebo biologické riziko. Je-li tento přístroj používán ke sledování procesu čištění odpadních vod nebo pro systém dodávky chemických látek, pro něž existují regulační limity a požadavky na sledování související s veřejným zdravím, výrobou potravin nebo jejich zpracováním, pak je na odpovědnosti uživatele tohoto přístroje, aby se seznámil a dodržoval všechny platné zákony a předpisy a zavedl dostatečné a vhodné mechanismy zaručující dodržování platných zákonů a předpisů v případě poruchy přístroje.

#### 4.2 Ikony použité v ilustracích

			
Díly dodané výrobcem	Díly dodané uživatelem	Podívejte se	Provedte kroky v obráceném pořadí

				
Jsou potřeba dvě osoby	Poslechněte si	Používejte pouze prsty	Nepoužívejte nástroje	Nedotýkejte se jej

#### 4.3 Zamýšlené použití

Analyzátory Hach řady EZ jsou určeny pro použití osobami, které musí neustále měřit parametry kvality vody ve vzorcích z průmyslových a environmentálních aplikací. Analyzátory řady EZ od společnosti Hach vodu neupravují ani nemění její vlastnosti a nepoužívají se při kontrole postupů.

#### 4.4 Součásti výrobku

Ujistěte se, že byly dodány všechny součásti. Viz část **Obr. 4** na straně 449. V případě, že některé položky chybí nebo jsou poškozené, se ihned obraťte na výrobce nebo příslušného obchodního zástupce.

## Kapitola 5 Instalace

### ⚠ NEBEZPEČÍ



Různá nebezpečí. Práce uvedené v tomto oddíle dokumentu smí provádět pouze dostatečně kvalifikovaný personál.

### 5.1 Pokyny k instalaci

#### ⚠ VAROVÁNÍ



Nebezpečí požáru. Uživatel je odpovědný za přijetí dostatečných preventivních opatření v případě, že se vybavení používá pomocí metod využívajících hořlavé kapaliny. Dbejte na dodržování správných preventivních opatření na ochranu uživatele a bezpečnostních protokolů. K nim patří zejména kontrola rozliití a úniku, dostatečná ventilace, zákaz používání bez dozoru a zajištění, aby přístroj pod napětím nebyl ponecháván bez dohledu.

#### ⚠ POZOR



Nebezpečí styku s chemikáliemi. Dodržujte laboratorní bezpečnostní postupy a noste veškeré osobní ochranné pomůcky vyžadované pro manipulaci s příslušnými chemikáliemi. Bezpečnostní protokoly naleznete v aktuálních datových bezpečnostních listech (MSDS/SDS).

#### ⚠ POZOR



Nebezpečí styku s chemikáliemi. Likvidujte chemikálie a odpad v souladu s místními, regionálními a národními předpisy.

- Instalujte vnitřní části analyzátoru v bezpečném prostředí.
- Analyzátor instalujte v prostředí chráněném před žíravými kapalinami.
- Instalujte analyzátor v čistých, suchých, řádně větraných a temperovaných prostorách.
- Analyzátor nainstalujte co nejbližší bodu odběru vzorků.
- Neinstalujte analyzátor na přímé sluneční světlo ani poblíž zdroje tepla.
- Zajistěte dostatečný volný prostor pro instalaci potrubí a elektrických přípojek.
- Nezapomeňte ponechat dostatečný prostor před analyzátozem, aby bylo možné otevřít dvířka analyzátoru. Viz [Rozměry analyzátoru](#) na straně 121.
- Ujistěte se, že podmínky okolního prostředí vyhovují provozním specifikacím. Viz [Technické údaje](#) na straně 117.

Přestože analyzátor není určen k použití s hořlavými vzorky, některé analyzátory EZ používají hořlavé reagentie. Další informace o reagentiích používaných v analyzátoru naleznete v seznamu metod a reagentií příslušného modelu řady EZ. Pokud analyzátor používá hořlavé reagentie, dodržujte následující bezpečnostní opatření:


- Analyzátor uchovávejte mimo dosah tepla, jisker a otevřeného plamene.
- V blízkosti analyzátoru nejezte, nepijte ani nekuřte.
- Využívejte místní ventilapro test ční systém pro odvod plynů.
- Používejte spotřebiče a systém osvětlení odolné proti jiskrám a výbuchu.
- Zabraňte elektrostatickým výbojům. Viz [Zřetel na elektrostatické výboje](#) na straně 121.
- Přístroj před použitím kompletně vyčistěte a osušte.
- Před přestávkami a na konci pracovní doby si umyjte ruce.
- Sejměte kontaminovaný oděv. Před opětovným použitím oděv vyperte.
- S těmito kapalinami je nutné manipulovat v souladu s požadavky místních kontrolních orgánů nebo přípustnými mezemi expozice.


## 5.2 Rozměry analyzátoru


Viz **Obr. 5** na straně 454, kde naleznete informace o rozměrech analyzátoru.

## 5.3 Mechanická instalace

### 5.3.1 Připevnění přístroje na stěnu

▲ VAROVÁNÍ	
	Nebezpečí poranění osob. Ujistěte se, že je montáž na stěnu schopna udržet čtyřnásobek hmotnosti zařízení.

▲ VAROVÁNÍ	
	Nebezpečí poranění osob. Přístroje nebo součásti jsou těžké. Při instalaci nebo přemísťování používejte pomoc jiné osoby.

▲ VAROVÁNÍ	
	Nebezpečí poranění osob. Tento předmět je těžký. Dbejte na to, aby byl přístroj bezpečně připevněn ke zdi, stolu nebo podlaze a umožňoval tak bezpečný provoz.

Pomocí dodaných montážních držáků připevněte přístroj svisle a vodorovně na rovnou svislou stěnu. Viz **Obr. 6** na straně 456.

Přístroj nainstalujte na takové místo a do takové polohy, aby jej uživatel mohl snadno odpojit od zdroje napájení.


Ujistěte se, že je kolem přístroje dostatek volného místa pro instalaci lahví.

Montážní materiál dodá uživatel. Ujistěte se, že upevňovací prvek na stěnu má dostatečnou nosnost (přibližně 160 kg nebo 353 liber). Montážní kování musí být schváleno pro vlastnosti stěny.


### 5.3.2 Otevřete dvířka analyzátoru

Pomocí dodaného klíče odemkněte dva zámky na straně analyzátoru. Viz **Obr. 7** na straně 456. Před zahájením provozu nezapomeňte dvířka zavřít, aby byl zachován stupeň krytí krytu a bezpečnostní třída.

## 5.4 Elektrická instalace

▲ NEBEZPEČÍ	
	Nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým proudem. Před jakýmkoli pracemi na elektrickém zapojení odpojte přístroj od zdroje napájení.

### 5.4.1 Zřetel na elektrostatické výboje

UPOZORNĚNÍ	
	Instalujte zařízení v místech a polohách, které umožňují snadný přístup pro odpojení zařízení a pro jeho obsluhu. Působením statické elektřiny může dojít k poškození citlivých vnitřních elektronických součástí a snížení výkonnosti či selhání.

Dodržováním kroků uvedených v této proceduře zabráníte poškození přístroje elektrostatickými výboji:

- Dotkněte se uzemněného kovového předmětu, například základny přístroje, kovové trubky nebo potrubí, a zbavte se tak statické elektřiny na povrchu těla.
- Nehýbejte se příliš prudce. Součástky citlivé na elektrostatický náboj přepravujte v antistatických nádobách nebo obalech.

- Noste zápěstní řemínek, který je uzemněn drátem.
- Pracujte v antistaticky chráněné oblasti s antistatickou ochranou podlahy a pracovního stolu.

## 5.4.2 Přívod elektřiny

Kabely externích zařízení protáhněte kabelovými průchodkami. Viz **Obr. 8** na straně 457. Nepoužívané zástrčky ponechte v kabelových průchodkách.

**Obr. 9** na straně 460 zobrazuje součásti uvnitř analyzátoru. Spínač napájení je jistič, který automaticky odpojuje hlavní napájecí kabel z elektrické sítě, pokud se vyskytne nadproud (např. zkrat) nebo přepětí.

## 5.4.3 Připojení externích zařízení

Připojte externí zařízení, která se budou používat s analyzátozem, k signálovým a řídicím svorkám analyzátoru. Viz **Obr. 10** na straně 462 a **Tabulka 1** na straně 122.

**Tabulka 1 Signální a řídicí svorky — popis**

Kolik	Popis
AO1–AO8 (P101)	Osm analogových výstupů k ovládání externích zařízení. Další informace a ilustrace naleznete v online rozšířené uživatelské příručce.
FCT1–FCT5 (P102)	Pět relé (bezpotenciálové kontakty). Zátěžové maximum je 24 V DC, 0,5 A. <ul style="list-style-type: none"> <li>• FCT1 — Alarm poruchy</li> <li>• FCT2 — Alarm údržby</li> <li>• FCT3 — Analyzátor připraven</li> <li>• FCT4 a FCT5 — Pro budoucí použití</li> </ul>
DI1–DI7 (P103)	Seven digitálních vstupů k dálkovému ovládání analyzátoru <sup>5</sup> Připojte digitální vstupy k externímu bezpotenciálovému kontaktu (24 V DC), aby analyzátor spustil měření pro kanál. <ul style="list-style-type: none"> <li>• DI1 — Vzdálený start pro kanál 1</li> <li>• DI2 — Vzdálený start pro kanál 2</li> <li>• DI3 až DI7 — Pro budoucí použití</li> </ul>
FB1–FB4 (P104)	Konektory Profibus DP nebo Modbus RTU (RS485) <b>Profibus DP:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FB1—A1 (vstup)</li> <li>• FB2—A2 (výstup)</li> <li>• FB3—B1 (vstup)</li> <li>• FB4—B2 (výstup)</li> <li>• SHL — Štít</li> </ul> <b>Modbus RTU:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FB1—D (+)</li> <li>• FB2—D (-)</li> <li>• FB3 — nepoužito</li> <li>• FB4 — nepoužito</li> <li>• SHL — Štít</li> </ul> <p>Pokyny pro konfiguraci Modbus a telegramové tagy naleznete v dokumentaci ke kontroléru SC4500.</p>
24 V DC/1 A (P105)	Napájení 24 V DC pro filtrační jednotky EZ9010 a EZ9020

<sup>5</sup> Pokud je analyzátor v režimu údržby, je dálkové ovládání zakázáno.

**Tabulka 1 Signální a řídicí svorky — popis (pokračování)**

Kolík	Popis
STR1–STR8 (P106)	<p>Osm digitálních výstupů pro volitelný panel Moduplex. Připojte holé vodiče jednotlivých kanálových ventilů na panelu Moduplex k příslušným konektorům STR.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• STR1 — Kanál 1</li> <li>• STR2 — Kanál 2</li> <li>• ...</li> <li>• STR8 — Kanál 8</li> </ul>
EXT9–EXT12 (P107)	<p>Čtyři digitální výstupy pro volitelný filtrační panel EZ9150. Připojte elektrické ventily a čerpadlo na filtračním panelu EZ9150 ke konektorům EXT.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EXT9 — Ventil proplachovací vody</li> <li>• EXT10 — Ventil zpětného proplachu</li> <li>• EXT11 — Vypouštěcí přepadový ventil</li> <li>• EXT12 — Filtrační čerpadlo</li> </ul>
D01–D06 (P108 a P109)	<p>Šest výstupů pneumatických ventilů pro panel EZ9150.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• D01 – Vstupní ventil vzorku</li> <li>• D02 – vypouštěcí přepadový ventil</li> <li>• D03 – ventil kanálu 1</li> <li>• D04 – ventil kanálu 2</li> <li>• D05 – ventil kanálu 3</li> <li>• D06 – ventil kanálu 4</li> </ul>

CS

#### 5.4.4 Připojení napájení střídavým proudem

### ⚠ NEBEZPEČÍ



Nebezpečí poranění elektrickým proudem a nebezpečí požáru. Ujistěte se, že dodaný kabel a nezamykací zástrčka splňují platné zákonné předpisy v dané zemi.


- Ujistěte se, že je v elektrickém vedení nainstalován jistič s dostatečnou kapacitou.
- Ujistěte se, že je v blízkosti analyzátoru nainstalován jistič nebo nouzový vypínač, aby bylo možné analyzátor v případě potřeby okamžitě odpojit od zdroje napájení.
- Připojte zařízení v souladu s místními nebo státními elektrickými předpisy.
- Dodaný napájecí kabel nainstalujte přes kabelovou průchodku, která je na boku analyzátoru.
- Utáhněte kabelovou průchodku, aby byl napájecí kabel bezpečně uchycen a byla dodržena ekologická třída krytu.

Připojte analyzátor k napájení střídavým proudem pomocí dodaného napájecího kabelu. Viz část **Tabulka 2** na straně 124 a **Obr. 11** na straně 468.

## UPOZORNĚNÍ

Nenastavujte spínač napájení do polohy zapnuto. Před spuštěním dokončete všechna elektrická a vodovodní připojení, jinak může dojít k poškození analyzátoru.

**Tabulka 2** Informace o kabeláži – střídavé napájení

Svorka	Popis	Barva kabelů - Severní Amerika a Kanada	Barva kabelu-EU
L	Horká linka (L)	Černá (1)	Hnědá
N	Nulový vodič (N)	Bílá (2)	Modrá
	Ochranný zemnicí vodič (PE)	Zelená se žlutým proužkem	Zelená se žlutým proužkem

## 5.5 Potrubí

### 5.5.1 Pokyny pro přívodní hadičku vzorku

#### ⚠ POZOR



Nebezpečí požáru. Tento přístroj není určen k používání s hořlavými vzorky.

Pro co nejlepší funkci přístroje zvolte bod odběru vzorku, který bude dostatečně kvalitní a reprezentativní. Vzorek musí být reprezentativní v celém systému.

- Ujistěte se, že průtok vzorku je vyšší než průtok do analyzátoru.
- Pokud analyzátor k přivádění vzorku do analytické nádoby používá peristaltické čerpadlo, zkontrolujte, zda má vedení vzorku hodnotu atmosférického tlaku.
- Zkontrolujte, že vedení vzorku odebírá vzorek z malé přeplňovací nádoby v blízkosti analyzátoru.
- Použijte dodanou hadičku pro odběr vzorků. Neměňte délku hadičky pro odběr vzorků.

Vzorek v přepadové nádobě musí být nepřetržitě obnovován. Pokud jsou pevné látky ve vzorku příliš velké, doporučuje se filtrace vzorku.

### 5.5.2 Pokyny pro použití odtokových hadiček

#### ⚠ VAROVÁNÍ



Nebezpečí požáru. Uživatel je odpovědný za přijetí dostatečných preventivních opatření v případě, že se vybavení používá pomocí metod využívajících hořlavé kapaliny. Dbejte na dodržování správných preventivních opatření na ochranu uživatele a bezpečnostních protokolů. K nim patří zejména kontrola rozliti a úniku, dostatečná ventilace, zákaz používání bez dozoru a zajištění, aby přístroj pod napětím nebyl ponecháván bez dohledu.

#### ⚠ POZOR



Nebezpečí styku s chemikáliemi. Likvidujte chemikálie a odpad v souladu s místními, regionálními a národními předpisy.

## UPOZORNĚNÍ

Nepřipojujte odtokovou hadičku k jiným hadičkám, protože může vzniknout zpětný tlak nebo se analyzátor může poškodit. Dbejte, aby odtoková hadička byla otevřená na volný vzduch.

## UPOZORNĚNÍ

Chcete-li zamezit zpětnému tlaku a poškození analyzátoru, dbejte, aby byl analyzátor výše než jiné odtoky používané ve vašem zařízení a aby odtoková hadička měla konstantní sklon. Namontujte odtokovou hadičku s vertikálním poklesem 2,54 cm nebo více na každých 0,3 m délky hadice.

Analyzátor používá odtokovou hadičku k vypouštění vzorku a reagiencí po analýze. Aby bylo zajištěno odvedení veškeré kapaliny z přístroje, je důležitá správná instalace odtokových hadiček. Nesprávná instalace může způsobit únik kapaliny do přístroje a jeho poškození. Pro odtokovou hadičku stačí podlahový odtok nebo do umyvadla. Doporučený vnější průměr odtokové hadičky je 32 mm. Viz část **Obr. 12** na straně 469.

- Odtokové hadičky by měly být co nejkratší.
- Zkontrolujte, zda je odtok níže než analyzátor.
- Dbejte na to, aby měly odtokové hadičky konstantní sklon.
- Odtokové hadičky nesmí mít ostré ohyby, ani nesmí být přiskřípnuté.
- Odtoková hadička musí mít volný konec a musí v ní být nulový tlak.
- Ujistěte se, že jsou odtokové hadičky zavřené vůči okolí instalační místnosti.
- Neucpávejte ani neponožujte odtokovou hadičku.

Je rovněž doporučeno provést připojení k rozvodu vody v blízkosti analyzátoru tak, aby byl odtok s odtokovou hadičkou pravidelně proplachován čistou vodou pro prevenci ucpání krystalizací.

Další informace o reagiencích používaných v analyzátoru naleznete v seznamu metod a reagiencí příslušného modelu řady EZ. Jestliže se v analyzátoru používají hořlavé reagenty, zajistěte dodržování těchto bezpečnostních opatření:

- Odtokovou hadičku nevyvádějte do podlahového odtoku.
- Odpad likvidujte v souladu s místními a státními předpisy o životním prostředí.

### 5.5.3 Pokyny pro použití odvzdušňovacích hadiček

#### ⚠ VAROVÁNÍ



Nebezpečí požáru. Uživatel je odpovědný za přijetí dostatečných preventivních opatření v případě, že se vybavení používá pomocí metod využívajících hořlavé kapaliny. Dbejte na dodržování správných preventivních opatření na ochranu uživatele a bezpečnostních protokolů. K nim patří zejména kontrola rozlítí a úniku, dostatečná ventilace, zákaz používání bez dozoru a zajištění, aby přístroj pod napětím nebyl ponecháván bez dohledu.

#### ⚠ POZOR



Nebezpečí styku s chemikáliemi. Likvidujte chemikálie a odpad v souladu s místními, regionálními a národními předpisy.

## UPOZORNĚNÍ

Nepřipojujte odvzdušňovací hadičku (port výstupních plynů) k jiným hadičkám, protože může vzniknout zpětný tlak nebo se analyzátor může poškodit. Zkontrolujte, zda je odvzdušňovací hadička otevřená pro vzduch na vnější straně objektu.

## UPOZORNĚNÍ

Chcete-li zamezit zpětnému tlaku a poškození analyzátoru, dbejte, aby byl analyzátor výše než jiná odvzdušňovací hadička používaná ve vašem zařízení a aby odvzdušňovací hadička měla konstantní sklon. Namontujte odvzdušňovací hadičku s vertikálním poklesem 2,54 cm nebo více na každých 0,3 m délky hadice.

Analyzátor používá odvětrávací hadičku k udržování atmosférického tlaku v analytické nádobě. Správná instalace odvětrávací hadičky je důležitá, aby se během provozu čerpadla nedostala z odvětrávacího vedení do analytické nádoby žádná kapalina. Nesprávná instalace může způsobit návrat plynů do přístroje a jeho poškození. Doporučený vnější průměr přívodní hadice odvzdušňovací hadičky je 32 mm. Viz část **Obr. 12** na straně 469.

- Odvzdušňovací hadička musí být co nejkratší.

- Dbejte na to, aby měly odvodušňovací hadičky konstantní sklon.
- Odvodušňovací hadičky nesmí mít ostré ohyby, ani nesmí být přiskřípnuté.
- Ujistěte se, že je odvodušňovací hadička uzavřená vůči okolnímu prostředí instalační místnosti a je pod nulovým tlakem.
- Ujistěte se, že je odvodušňovací vedení vždy výše než výpusť.
- Neucpávejte ani neponožujte odvodušňovací hadičku.

Jestliže se v analyzátoru používají hořlavé reagenty, zajistěte dodržování těchto bezpečnostních opatření:

- Odvodušňovací hadičku nevyvádějte do podlahového odtoku.
- Odpad likvidujte v souladu s místními a státními předpisy o životním prostředí.

## 5.5.4 Zapojení analyzátoru pro test součástí


### ▲ POZOR




Nebezpečí požáru. Tento přístroj není určen k používání s hořlavými kapalinami.

Před uvedením analyzátoru se všemi reagenty do provozu je nutné provést test součástí s deionizovanou vodou. Viz ilustrované kroky a část [Provedení testů součástí](#) na straně 130.

1. Nainstalujte čtyři hadice škrticího ventilu, jak je znázorněno v následujícím kroku 1.
  - a. Stiskněte černé tlačítko, poté zatlačte hadičku do ventilu.
  - b. Po správné instalaci hadičky uvolněte tlačítko.
2. Ujistěte se, že je vypouštěcí hadička správně vložena do nádoby na vzorek. Řiďte se následujícím vyobrazeným krokem 2.
3. Ujistěte se, že je hadička vyhnivací nádrže správně vložena do vyhnivací nádoby. Řiďte se následujícím vyobrazeným krokem 3.
4. Připojte všechny hadičky kapalin analyzátoru k velké láhvi s deionizovanou vodou a proveďte test součástí. Řiďte se následujícím vyobrazeným krokem 3. Hadicové vedení je instalováno z výroby.

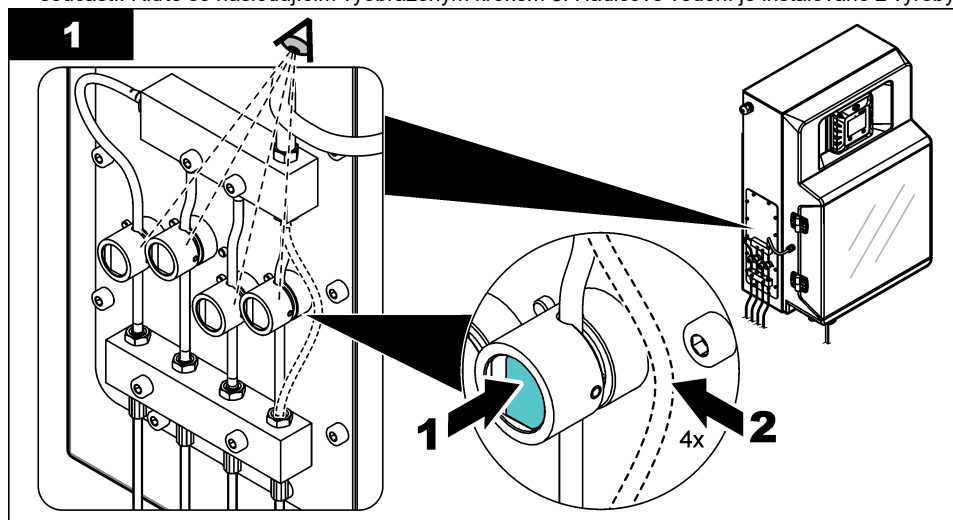




2

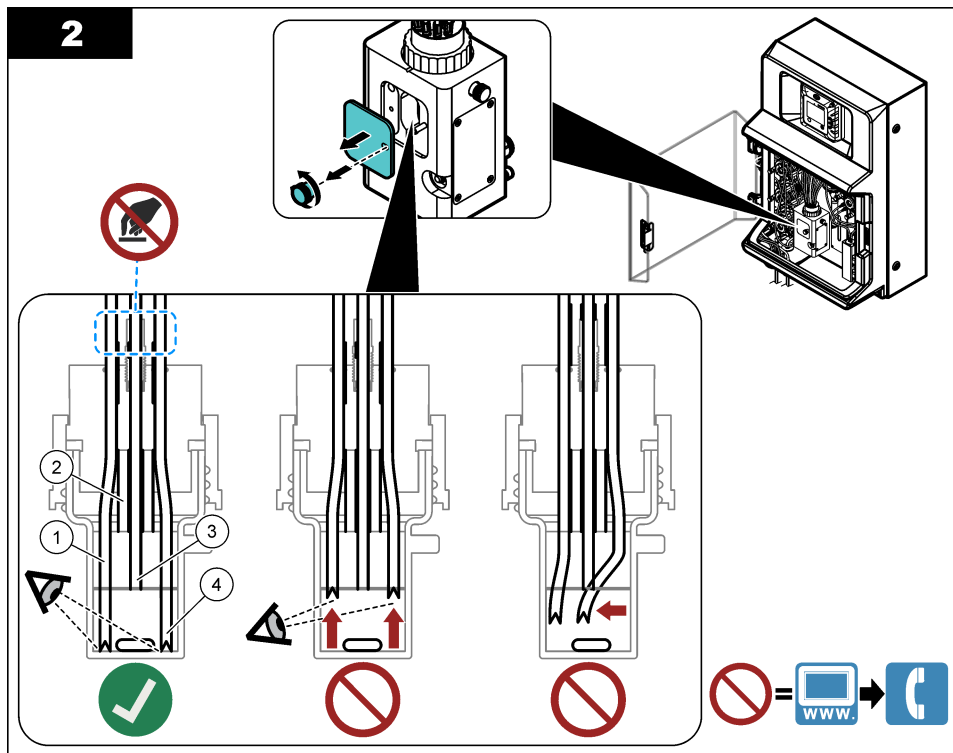

CS

1 Vypouštěcí hadička	3 Hadička pro odběr vzorků
2 Reagencie a odvětrávací hadička (horní hadička)	4 Hadičky rozkladné nádoby


3

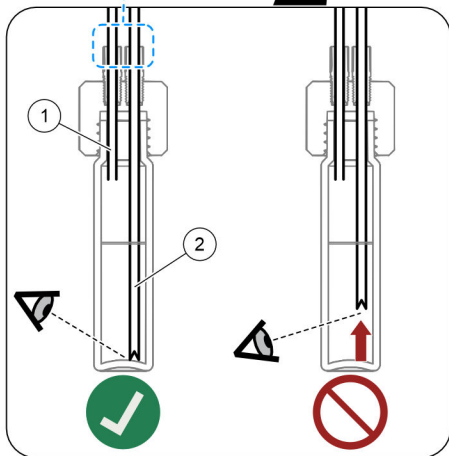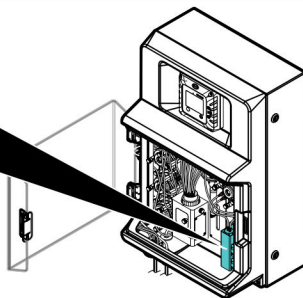

1 Odvětrávací hadička

2 Hadičky rozkladné nádoby

4

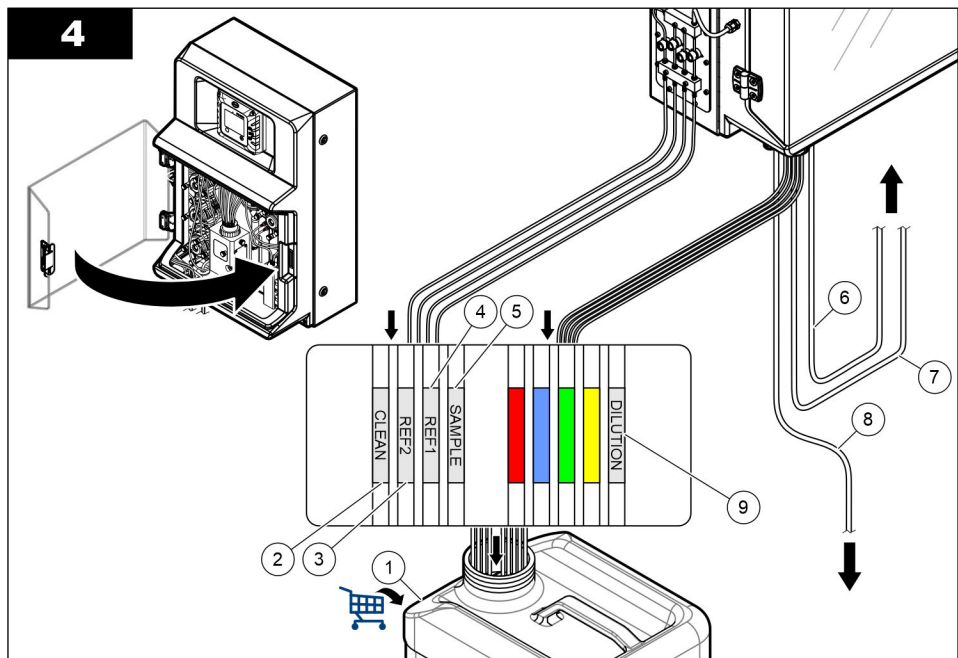

1 Deionizovaná voda	4 Hadička roztoku Reference 1 (REF1)	7 Odvětrávání z rozkladné nádoby
2 Hadička čistícího roztoku	5 Hadička přívodu vzorku	8 Vypouštěcí hadička
3 Hadička roztoku Reference 2 (REF2)	6 Odvětrávací hadička	9 Hadička fedění a mikročerpadla reagensie

## Kapitola 6 Spuštění

### 6.1 Počáteční spuštění

**Poznámka:** Před spuštěním se ujistěte, že je úplně dokončena instalace držáku, hadiček a elektrických zařízení. Viz část [Instalace](#) na straně 120.

Když je analyzátor poprvé nastaven na hodnotu ZAPNUTO, průvodce spuštěním vám pomůže s prvními kroky k dokončení nastavení. Provedte všechny následující kroky, abyste zajistili správnou funkci analyzátoru.

**Poznámka:** Dbejte na použití správného standardu a elektrolytu pro zvolený rozsah měření. Další informace a ilustrace naleznete v online rozšířené uživatelské příručce.

- Otevřete dvířka analyzátoru. Viz část [Otevřete dvířka analyzátoru](#) na straně 121.
- Nastavte spínač napájení do polohy Zapnuto. Viz [Obr. 9](#) na straně 460.
- Zavřete dvířka analyzátoru pomocí dodaného klíče.
- Počkejte na dokončení inicializační procedury.
- Na výzvu na displeji odpovězte, abyste vybrali jazyk, časové pásmo, datum a čas.  
Chcete-li nakonfigurovat další nastavení kontroléru, přečtěte si dokumentaci ke kontroléru SC4500.
- Klepnutím na displej zobrazíte nabídku **EZ2700sc**.
- Volbou možnosti **Nabídka Zařízení** spusťte asistenta spuštění. Zobrazí se uvítací obrazovka.

8. Proveďte kroky zobrazené na displeji a vyberte příslušný rozsah měření. Stiskněte tlačítko **OK**.
9. Pokud je nainstalována filtrační jednotka, vyberte možnost **Zapnuto**. Pokud ne, vyberte možnost **Vypnuto**.
10. Vyberte počet kanálů pro analyzátor. Stiskněte tlačítko **OK**.
11. Pokud je konfigurace zobrazená na stránce přehledu správná, stiskněte tlačítko **OK**. Zobrazí se hlavní nabídka **EZ2700sc**.
12. Pokračujte testem součástí. Viz [Provedení testů součástí](#) na straně 130.

## 6.2 Provedení testů součástí

### ⚠ VAROVÁNÍ



Nebezpečí poranění. Součásti, které mohou skřípnutím způsobit poranění. Nedotýkejte se pohyblivých částí.

Před uvedením analyzátoru do provozu proveďte testy součástí. Pomocí nabídky **Údržba** můžete spouštět různé funkce analyzátoru za účelem kontroly funkčnosti součástí.

#### Předpoklady:

- Pokud je analyzátor v provozním režimu, zvolte možnost **Údržba > Spustit režim údržby**.
- Ujistěte se, že hadičky se vzorkem, reagensů a roztokem jsou v nádobě s deionizovanou vodou. Viz [Zapojení analyzátoru pro test součástí](#) na straně 126.

#### 6.2.1 Kontrola míchadla

1. Odeberte světelný štít z fotometrické jednotky. Viz [Obr. 13](#) na straně 472.
2. Ujistěte se, že míchadlo je na dně nádoby na vzorky.  
*Poznámka: Během postupu plnění kontrolujte míchadlo, abyste se ujistili, že se míchadlo správně otáčí. Proces plnění je zahájen v [Kontrola čerpadel a škrticích ventilů](#) na straně 130.*
3. Nainstalujte světelný štít na fotometr.

#### 6.2.2 Kontrola čerpadel a škrticích ventilů

1. Zkontrolujte funkčnost čerpadel a škrticích ventilů, aby bylo ověřeno, že nedochází k únikům.
2. Ověřte, že analytická nádoba se naplní deionizovanou vodou. Viz [Obr. 14](#) na straně 473.
3. Ověřte, že deionizovaná voda vytéká vypouštěcí hadičkou.
4. Vyberte položku **Údržba > Spustit plnění** a naplňte samostatně každou tekutinu.  
Pokud dojde k úniku, zkontrolujte všechna připojení a přečtěte si další informace v online rozšířené verzi uživatelské příručky.
  - a. Vyberte možnost **Prime reference 1 (Naplnit referencí 1)** a stiskněte tlačítko **OK**.
  - b. Vyberte možnost **Prime reference 2 (Naplnit referencí 2)** a stiskněte tlačítko **OK**.
  - c. Vyberte možnost **Prime cleaning solution (Naplnit čistícím roztokem)** a stiskněte tlačítko **OK**.
  - d. Vyberte možnost **Prime Flush (Naplnit proplachem)** a stiskněte tlačítko **OK**.
  - e. Vyberte možnost **Naplňovač** a stiskněte tlačítko **OK**.
  - f. Vyberte možnost **Prime channel (Naplnit kanál) > Prime all channels (Naplnit všechny kanály)** a stiskněte tlačítko **OK**.  
Každá procedura plnění se automaticky zastaví po dokončení postupu.

### 6.2.3 Kontrola mikročerpadel

Zkontrolujte mikročerpadla na známky netěsnosti a přítomnosti vzduchových bublin.

1. Odeberte z fotometru stínítko.
2. Vyberte položku **Údržba > Spustit plnění > Naplnit všechny reagentie**.
3. Ujistěte se, že se deionizovaná voda dostane do mikročerpadla každou hadičkou mikročerpadel (reagencií). A poté plynule do analytické nádoby bez vzduchových bublin. Viz **Obr. 15** na straně 475.
4. Pokud mikročerpadla nefungují správně (bublíny v hadičce), napustte do příslušných hadiček deionizovanou vodu pomocí injekční stříkačky, aby se bubliny odstranily. Viz **Obr. 16** na straně 476.
5. Nainstalujte stínítko na fotometr.

### 6.2.4 Provedte kontrolu fotometru

Před kontrolou fotometru se ujistěte, že je vnější část analytické nádoby čistá, aby bylo možné kontrolu úspěšně dokončit. Další informace o čištění součástí analyzátoru naleznete v online rozšířené uživatelské příručce.

1. Stiskněte ikonu hlavní nabídky a vyberte položku **Zařízení**.
2. Vyberte **EZ2700sc**.
3. Posuňte se do dolní části obrazovky a vyberte **Nabídka Zařízení**.
4. Vyberte položku **Údržba > Kontrola fotometru**.
5. **OK**  
Po dokončení kalibrace tmavé hodnoty se na displeji zobrazí výsledek.
6. **OK**
7. Ujistěte se, že je hadička „REF1“ připojena k nádobě naplněné deionizovanou vodou. Ujistěte se, že je nainstalován světlý štít. Viz **Obr. 18** na straně 478.
8. Stiskněte tlačítko **OK**.  
Počkejte, dokud se nenaplní analytická nádoba.
9. Pomocí šroubováku upravte napětí výstupu senzoru na 9 V. Viz **Obr. 17** na straně 476.
10. Počkejte, dokud se na obrazovce nezobrazí hodnota 9 V. Poté stiskněte tlačítko **OK**.
11. **OK**

## 6.3 Provedte test vstupního signálu

Test digitálních vstupů provedte ještě před uvedením analyzátoru do provozu.

**Předpoklady:** Připojte digitální vstupy k externímu bezpotenciálnímu kontaktu (24 VDC).

Provedte test digitálního vstupního signálu a analogového výstupního signálu následujícím způsobem:

1. Stiskněte ikonu hlavní nabídky a vyberte položku **Zařízení**.
2. Vyberte **EZ2700sc**.
3. Posuňte se do dolní části obrazovky a vyberte **Nabídka Zařízení**.
4. Vyberte položku **Diagnostika > Signály**.  
Zobrazí se signály na digitálních vstupech.
5. Porovnejte stav digitálních vstupů na displeji s napětím přiváděným na digitální vstupy. (24 V = Zapnuto; 0 V = Vypnuto).

## 6.4 Provedte test výstupního signálu

Test analogových výstupů provedte ještě před uvedením analyzátoru do provozu.

**Předpoklady:** Konfigurace analogových výstupů (AO1–AO8, P101) pro výběr měření kanálů reprezentovaných každým analogovým výstupem. Další informace a ilustrace naleznete v online rozšířené uživatelské příručce.

Proveďte test analogového výstupního signálu následujícím způsobem:

1. Stiskněte ikonu hlavní nabídky.
2. Vyberte možnost **Výstupy > mA výstupy AOC > Test/Údržba**.

Možnost	Popis
<b>Test funkce</b>	Provede test výstupů na vybraném modulu.
<b>Stav výstupu</b>	Zobrazuje stav výstupů na vybraném modulu.

3. Pomocí multimetru změřte hodnotu mA u každého analogového výstupu.
4. Porovnejte hodnoty mA naměřené na analogových výstupech s očekávanými hodnotami mA.

## 6.5 Nastavení pořadí kanálů

Zvolte pořadí měření kanálů, počet měření každého kanálu a čekací dobu před měřením kanálu. Zadejte maximálně 16 řádků s maximálně 16 cykly.

1. Stiskněte ikonu hlavní nabídky a vyberte položku **Zařízení**.
2. Vyberte **EZ2700sc**.
3. Posuňte se do dolní části obrazovky a vyberte **Nabídka Zařízení**.
4. Pokud je analyzátor v provozním režimu, zvolte možnost **Údržba > Spustit režim údržby**. Počkejte, až bude analyzátor v režimu údržby.
5. Vyberte položku **Konfigurace > Nastavení pořadí kanálů**.
6. Pomocí šipek na bočním panelu vyberte pozici (číslo v sekvenci), poté pomocí tlačítka **OK** nakonfigurujte tuto pozici.
7. Vyberte možnost.

Možnost	Popis
<b>Vybrat</b>	Vybere příslušný kanál nebo čekací dobu.
<b>Počet měření</b>	Nastaví počet měření pro kanál.
<b>Čekací doba</b>	Nastaví čekací dobu pro vybraný kanál.

8. Stisknutím tlačítka **OK** uložíte změny.

## 6.6 Připojení roztoků a vzorku

### ▲ POZOR



Nebezpečí styku s chemikáliemi. Dodržujte laboratorní bezpečnostní postupy a noste veškeré osobní ochranné pomůcky vyžadované pro manipulaci s příslušnými chemikáliemi. Bezpečnostní protokoly naleznete v aktuálních datových bezpečnostních listech (MSDS/SDS).

### ▲ POZOR



Nebezpečí styku s chemikáliemi. Likvidujte chemikálie a odpad v souladu s místními, regionálními a národními předpisy.



Nebezpečí požáru. Tento přístroj není určen k používání s hořlavými kapalinami.

Nádoby s reagenty se dodávají s analyzátozem. Viz **Obr. 18** na straně 478. Nádoby s referenčním roztokem 1 a referenčním roztokem 2 a deionizovanou vodou dodává uživatel. Další nádoby si může koupit výrobce.

Nainstalujte nádoby

- co nejbližší k analyzátoru
- 1 metr pod spodní částí analyzátoru

Viz **Obr. 18** na straně 478, kde naleznete informace o instalaci nádoby.

Reagencie a roztoky dodává uživatel. Používejte pouze reagencie dodané certifikovanou společností nebo používejte reagencie určené výrobcem. Jako alternativní způsob může reagencie připravit uživatel. Postupujte podle pokynů v seznamu metod a reagentů pro příslušný model, který je k dispozici na webových stránkách výrobce.

Hadicové vedení je instalováno z výroby. Přečtete si štítek na každé hadičce, abyste zjistili správné zapojení. Správné reagencie, roztoky a standardy naleznete v příslušném seznamu metod a reagentů pro model, který je uveden na webových stránkách výrobce.

1. Po provedení testů součástí nainstalujte hadičky „CLEAN“ (čisticí roztok), „REF1“ (referenční roztok 1) a „REF2“ (referenční roztok 2) do příslušných nádob. Viz **Obr. 18** na straně 478.
2. Každou barevně označenou hadičku s reagenty vložte do nádoby na reagenty se stejnou barvou na štítku.
3. Zapojte zdroj vzorku (nebo výstup vzorku panelu Moduplex nebo panelu filtru) do hadičky vstupu vzorku analyzátoru. Viz **Obr. 18** na straně 478.
4. Stiskněte ikonu hlavní nabídky a vyberte položku **Zařízení**.
5. Vyberte **EZ2700sc**.
6. Posuňte se do dolní části obrazovky a vyberte **Nabídka Zařízení**.
7. Zvolte **Údržba > Spustit plnění > Naplnit vše**.

## 6.7 Před prvním spuštěním proveďte validaci

Proveďte validaci, abyste se ujistili, že měření jsou v rozsahu tolerance. Další informace a ilustrace naleznete v online rozšířené uživatelské příručce.

1. Stiskněte ikonu hlavní nabídky a vyberte položku **Zařízení**.
2. Vyberte **EZ2700sc**.
3. Posuňte se do dolní části obrazovky a vyberte **Nabídka Zařízení**.
4. Chcete-li spustit validaci, vyberte položku **Kalibrace > Validace > Spustit validaci**.  
Validace měří deionizovanou vodu v láhvi Reference 2.
5. Pro zobrazení výsledků vyberte možnost:
  - **Kalibrace > Validace > Historie validace**
  - **Diagnostika > Historická data > Validace**

## 6.8 Spuštění analyzátoru

Spuštění analyzátoru:

1. Stiskněte ikonu hlavní nabídky a vyberte položku **Zařízení**.
2. Vyberte **EZ2700sc**.

3. Posuňte se do dolní části obrazovky a vyberte **Nabídka Zařízení**.
4. Vyberte položku **Údržba > Spustit provozní režim**.

CS

# Inhoudsopgave

- 1 [Meer informatie](#) op pagina 135
- 2 [Productoverzicht](#) op pagina 135
- 3 [Specificaties](#) op pagina 136

- 4 [Algemene informatie](#) op pagina 137
- 5 [Installatie](#) op pagina 139
- 6 [Opstarten](#) op pagina 148

## Hoofdstuk 1 Meer informatie

De basishandleiding voor gebruikers bevat voldoende informatie voor de inbedrijfname. Online is een uitgebreide gebruikershandleiding beschikbaar met meer informatie.

### ⚠ GEVAAR



Diverse gevaren! Meer informatie vindt u in de afzonderlijke hoofdstukken van de uitgebreide gebruikershandleiding die hieronder worden weergegeven.

- Gebruikersinterface en navigatie
- Bewerking
- Onderhoud
- Problemen oplossen
- Lijsten met vervangende onderdelen

Scan de QR-codes die volgen om naar de uitgebreide gebruikershandleiding te gaan.



Europese talen



Amerikaanse en Aziatische talen

## Hoofdstuk 2 Productoverzicht

De Hach EZ2700sc- analyser is een online-analyser die één parameter meet in watermonsters van industriële en milieutoepassingen. Raadpleeg [Afbeelding 1](#) op pagina 438, [Afbeelding 2](#) op pagina 443 en [Afbeelding 3](#) op pagina 447.

De analyser is een online colorimetrische analyser voor algemene wateranalyse (bijv. nitraat, fosfaat). De analyser heeft opties voor starten op afstand, automatische validatie, automatische kalibratie, automatische reiniging en Modbus.

Het monsterwater komt de analyser binnen via de monsterslang. De pompen, ventielen en dispenser in de analyser verplaatsen het monster en de reagentia naar de meetkuvet op het analysepaneel. Wanneer het analyseproces in het analysevat is voltooid, voert de analyser het monster af via de afvoerslang. De analyseresultaten worden weergegeven op het display van de SC4500-controller. De SC4500-controller slaat de gegevens van de analyser op (gegevenslogboek, gebeurtenissenlogboek, instellingenlogboek en servicelogboek). Gebruik de SC4500-controller om de analyser te bedienen en te configureren.

Om het aantal monsterstromen (kanalen) dat de analyser kan meten (2, 4 of 8) te verhogen, kunt u het Moduplex multi-stream-paneel bij de analyser aanschaffen.

Om het monster voor te bereiden (filtratie, bezinking), moet het EZ9010-, EZ9020-, EZ9150-, EZ9200- of EZ9250-filtratiepaneel bij de analyser worden aangeschaft.

## Hoofdstuk 3 Specificaties

Specificaties kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd.

Specificatie	Details
Afmetingen (B x H x D)	460 x 688 x 340 mm (18,1 x 27,1 x 13,4 inch)
Behuizing	IP44; ABS, PMMA en gecoat staal
Display	3,5-inch TFT-kleurenscherm met capacitieve touchpad en IP66-technologie
Gewicht	40 kg (88 lb)
Stroomvereisten	100 tot 240 VAC $\pm$ 10 %, 50/60 Hz
Energieverbruik	240 VA maximaal
Hoogte	2000 m (6560 ft) maximaal
Overspanningcategorie	II
Omgevingscondities	Alleen voor gebruik binnen
Vervuilingsgraad	2
Bedrijfstemperatuur	10 tot 30 °C (50 tot 86 °F); 5 tot 95 % relatieve vochtigheid, niet-condenserend, niet-corrosief
Opslagtemperatuur	-20 tot 60 °C (-4 tot 140 °F), 95 % relatieve vochtigheid, niet-condenserend maximum
Monsteringen	Eén
Monsterdruk	Door extern overloopvat (open voor atmosferische druk)
Monsterdebiet	100 tot 300 mL/min
Monstertemperatuur	10 tot 30 °C (50 tot 86 °F)
Monsterkwaliteit	< 100 $\mu$ m deeltjes, ,maximaal < 0,1 g/L Troebelheid < 50 NTU
Luchtzuivering voor corrosieve omgevingen	0,2 bar (20 kPa of 3 psi); droge en schone lucht
Afvoer	Atmosferische druk, geventileerd, minimale $\varnothing$ 32 mm
Verbinding naar aarde	Droge en schone aardstaf met lage impedantie (< 1 ohm) met een aardingskabel van > 2,5 mm <sup>2</sup> (13 AWG)
Analog outputs (analoge uitgangen)	Maximaal acht 0-20 mA (of 4-20 mA) analoge uitgangen <b>Opmerking:</b> De analoge uitgangen leveren de lusvoeding. De contacten van het SCADA- en PLC-systeem kunnen niet worden gevoed.
Digitale ingangen	Zeven digitale ingangen: Twee digitale ingangen voor starten op afstand. De overige digitale ingangen zijn voor toekomstig gebruik.
Digitale uitgangen	Vier bekrachtigde digitale uitgangen voor de kleppen en pompen van het EZ9150-paneel; acht bekrachtigde digitale uitgangen voor de kleppen van het Moduplex-paneel; 24 VDC, 500 mA.
Relais	Vijf potentiaalvrije contacten (FCT), maximale belasting 24 VDC, 0,5 A (weerstandsbelasting)
Ethernet-verbindingen	Clarus Ethernet-verbinding en Modbus TCP/IP Ethernet-connector; LAN-versie; 10/100 Mbps, of Profinet of Ethernet IP

<sup>2</sup> Raadpleeg de documentatie bij de SC4500-controller voor informatie over Ethernet-configuratie en Modbus-configuratie.

Specificatie	Details
RS485-communicatie	Profibus DP of Modbus RTU
Certificeringen	CE, ETL-gecertificeerd volgens UL- en CSA-veiligheidsnormen, UKCA
Garantie	1 jaar (EU: 2 jaar)

## Hoofdstuk 4 Algemene informatie

In geen geval is de fabrikant aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuist gebruik van het product of het niet opvolgen van de instructies in de handleiding. De fabrikant behoudt het recht om op elk moment, zonder verdere melding of verplichtingen, in deze handleiding en de producten die daarin worden beschreven, wijzigingen door te voeren. Gewijzigde versies zijn beschikbaar op de website van de fabrikant.

### 4.1 Veiligheidsinformatie

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor enige schade door onjuist toepassen of onjuist gebruik van dit product met inbegrip van, zonder beperking, directe, incidentele en gevolgschade, en vrijwaart zich volledig voor dergelijke schade voor zover dit wettelijk is toegestaan. Uitsluitend de gebruiker die verantwoordelijk voor het identificeren van kritische toepassingsrisico's en het installeren van de juiste mechanismen om processen te beschermen bij een mogelijk onjuist functioneren van apparatuur.

Lees deze handleiding voor het uitpakken, installeren of gebruiken van het instrument. Let op alle waarschuwingen. Wanneer u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig persoonlijk letsel of schade aan het instrument.

Als de apparatuur wordt gebruikt op een manier die niet is gespecificeerd door de fabrikant, kan de door de apparatuur geboden bescherming worden aangetast. Gebruik en installeer dit apparaat niet op een andere manier dan die in de handleiding wordt aangegeven.

#### 4.1.1 Gebruik van gevareninformatie

##### **▲ GEVAAR**

Geeft een potentieel gevaarlijke of dreigende situatie aan die, als deze niet kan worden voorkomen, kan resulteren in dodelijk of ernstig letsel.

##### **▲ WAARSCHUWING**

Geeft een potentieel of op handen zijnde gevaarlijke situatie aan, die als deze niet wordt vermeden, kan leiden tot de dood of ernstig letsel.

##### **▲ VOORZICHTIG**







Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die kan resulteren in minder ernstig letsel of lichte verwondingen.

##### **LET OP**

Duidt een situatie aan die (indien niet wordt voorkomen) kan resulteren in beschadiging van het apparaat. Informatie die speciaal moet worden benadrukt.

#### 4.1.2 Waarschuwingsetiketten

Lees alle labels en etiketten die op het instrument zijn bevestigd. Het niet naleven van deze waarschuwingen kan leiden tot letsel of beschadiging van het instrument. In de handleiding wordt door middel van een veiligheidsvoorschrift uitleg gegeven over een symbool op het instrument.

	Dit is het symbool voor veiligheidswaarschuwingen. Volg alle veiligheidsberichten op die after dit symbool staan, om mogelijk letsel te voorkomen. Als u dit symbool op het apparaat ziet, moet u de instructiehandleiding raadplegen voor informatie over de werking of veiligheid.
	Dit symbool duidt op een kans op chemisch letsel en geeft aan dat alleen personen die bevoegd en opgeleid zijn om met chemicaliën te werken chemische producten mogen hanteren of onderhoudswerkzaamheden mogen uitvoeren aan chemicaliënleveringssystemen voor de apparatuur.
	Dit symbool geeft aan dat er een risico op een elektrische schok en/of elektrocutie bestaat.
	Dit symbool wijst op de aanwezigheid van apparaten die gevoelig zijn voor elektrostatische ontlading en geeft aan dat voorzichtigheid betracht dient te worden om schade aan de apparatuur te voorkomen.
	Dit symbool geeft aan dat het instrument op een geaard stopcontact dient te worden aangesloten. Als het instrument zonder aardingsstekker met snoer wordt geleverd, moet het instrument worden geaard op de aansluiting voor de veiligheidsaarddraad.
	Elektrische apparatuur gemarkeerd met dit symbool mag niet worden afgevoerd via Europese systemen voor afvoer van huishoudelijk of openbaar afval. Oude apparatuur of apparatuur aan het einde van zijn levensduur kan naar de fabrikant worden geretourneerd voor kosteloze verwerking.

### 4.1.3 Chemische en biologische veiligheid

<b>⚠ GEVAAR</b>	
	Chemische of biologische gevaren. Als dit instrument wordt gebruikt voor het sturen van een proces en/of het doseren van chemicaliën waarvoor wettelijke voorschriften en/of eisen gelden ten aanzien van de volksgezondheid, de veiligheid, de productie of het verwerken van voedingsmiddelen of dranken, dient de gebruiker er zorg voor te dragen dat hij/zij bekend is met deze voorschriften en/of eisen en deze na te leven. Tevens dient de gebruiker er zorg voor te dragen dat er voldoende maatregelen getroffen zijn en eventueel vereist materiaal aanwezig is om aan de geldende wetten en eisen in geval van een defect te voldoen.

### 4.2 Pictogrammen die in de afbeeldingen worden gebruikt

			
Door fabrikant verstrekte onderdelen	Door gebruiker verstrekte onderdelen	Kijk	Voer stappen in omgekeerde volgorde uit
			
Gebruik twee mensen	Luister	Gebruik alleen vingers	Gebruik geen gereedschap
			
			Niet aanraken

### 4.3 Gebruiksdoel

De Hach EZ-analyzers zijn bedoeld voor gebruik door personen die continu waterkwaliteitsparameters moeten meten in monsters van industriële en milieutoepassingen. De

Hach EZ-serie analysers behandelen of wijzigen water niet en dienen niet te worden gebruikt voor controleprocedures.

## 4.4 Productcomponenten

Controleer of alle componenten zijn ontvangen. Raadpleeg [Afbeelding 4](#) op pagina 452. Neem onmiddellijk contact op met de fabrikant of een verkoopvertegenwoordiger in geval van ontbrekende of beschadigde onderdelen.

## Hoofdstuk 5 Installatie

### ▲ GEVAAR



Diverse gevaren. Alleen bevoegd personeel mag de in dit deel van het document beschreven taken uitvoeren.

## 5.1 Installatierichtlijnen

### ▲ WAARSCHUWING



Brandgevaar. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om voldoende voorzorgsmaatregelen te nemen wanneer het apparaat wordt gebruikt bij methodes waarbij brandbare vloeistoffen worden gebruikt. Volg de juiste voorzorgsmaatregelen voor gebruikers en houd u aan veilige werkprotocollen. Hieronder wordt o.a. verstaan controle op lekken en morsen, goede ventilatie, niet werken zonder toezicht en het instrument nooit zonder toezicht achterlaten terwijl de spanning is ingeschakeld.

### ▲ VOORZICHTIG



Gevaar van blootstelling aan chemicaliën. Volg alle laboratorium technische veiligheidsvoorschriften op en draag alle persoonlijke beschermingsuitrustingen die geschikt zijn voor de gehanteerde chemicaliën. Raadpleeg de huidige veiligheidsinformatiebladen (MSDS/SDS) voor veiligheidsprotocollen.

### ▲ VOORZICHTIG



Gevaar van blootstelling aan chemicaliën. Chemicaliën en afval dienen te worden afgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke, regionale en nationale voorschriften.

- Installeer de analyser op een binnenlocatie, in een niet-gevaarlijke omgeving.
- Installeer de analyser in een omgeving die beschermd is tegen corrosieve vloeistoffen.
- Installeer de analyser in een schone, droge, goed geventileerde en op temperatuur gecontroleerde ruimte.
- Installeer de analyser zo dicht mogelijk bij het monsterafnamepunt.
- Monteer de analyser niet in direct zonlicht of in de buurt van een warmtebron.
- Zorg ervoor dat er voldoende ruimte is om vloeistofslangen en elektrische verbindingen aan te sluiten.
- Zorg dat u vóór de analyser voldoende ruimte laat om de analyser-deur te openen. Raadpleeg [Afmetingen van de analyser](#) op pagina 140.
- Zorg ervoor dat de omgevingscondities binnen de bedrijfsspecificaties liggen. Raadpleeg [Specificaties](#) op pagina 136.

Hoewel de analyser niet is ontworpen voor gebruik met ontvlambare monsters, maken sommige EZ-analysers gebruik van ontvlambare reagentia. Raadpleeg het methode- en reagensblad van het toepasselijke EZ-seriemodel voor meer informatie over de in de analyser gebruikte reagentia. Als de analyser ontvlambare reagentia gebruikt, dient u de volgende veiligheidsmaatregelen in acht te nemen:

- Houd de analyser uit de buurt van hitte, vonken en open vuur.
- Eet, drink of rook niet in de buurt van de analyser.

- Gebruik een lokaal afzuigventilatiesysteem.
- Gebruik vonk- en explosieveilige apparaten en verlichtingssystemen.
- Voorkom elektrostatische ontladingen. Zie [Elektrostatische ontladingen \(ESD\)](#) op pagina 141.
- Reinig en droog het instrument voor gebruik volledig.
- Was uw handen voor werkpauses en aan het einde van de werkperiode.
- Verwijder besmette kleding. Was de kleding voor deze opnieuw gebruikt wordt.
- Deze vloeistoffen moeten worden behandeld in overeenstemming met de vereisten van de plaatselijke regelgevende instanties met betrekking tot toegestane blootstellingslimieten.

NL

## 5.2 Afmetingen van de analyser

Raadpleeg [Afbeelding 5](#) op pagina 454 voor de afmetingen van de analyser

## 5.3 Mechanische installatie

### 5.3.1 Het instrument aan een wand bevestigen

#### ▲ WAARSCHUWING



Gevaar voor letsel. Zorg ervoor dat de wandsteun 4 keer het gewicht van de apparatuur kan dragen.

#### ▲ WAARSCHUWING



Gevaar voor persoonlijk letsel. De instrumenten of onderdelen zijn zwaar. Schakel assistentie in bij het installeren of verplaatsen.

#### ▲ WAARSCHUWING



Gevaar voor letsel. Het is een zwaar voorwerp. Bevestig het instrument stevig aan een wand, op een tafel of op de vloer voor een veilige werking.

Gebruik de meegeleverde montagebeugels om het instrument rechtop en horizontaal op een vlak, verticaal wandoppervlak te bevestigen. Raadpleeg [Afbeelding 6](#) op pagina 456.

Installeer het instrument op een plaats en in een positie waarbij de gebruiker het instrument eenvoudig kan loskoppelen van de voedingsbron.

Zorg ervoor dat er voldoende ruimte onder de analyser is om de flessen te installeren.

De gebruiker dient voor de bevestigingsmiddelen voor de montage te zorgen. Zorg dat de bevestiging voldoende draagcapaciteit heeft (ongeveer 160 kg of 353 lb). De bevestigingsmiddelen moeten zijn goedgekeurd voor de eigenschappen van de muur.

### 5.3.2 Open de deur van de analyser

Gebruik de meegeleverde sleutel om de twee vergrendelingen aan de zijkant van de analyser te ontgrendelen. Raadpleeg [Afbeelding 7](#) op pagina 456. Zorg ervoor dat u de deur vóór gebruik sluit om de omgevingsclassificatie van de behuizing en de veiligheidsclassificatie te behouden.

## 5.4 Elektrische installatie

#### ▲ GEVAAR



Elektrocuciegevaar. Koppel altijd het instrument los van de netvoeding voordat u elektrische aansluitingen tot stand brengt.

## 5.4.1 Elektrostatische ontladingen (ESD)

### LET OP



Potentiële schade aan apparaat. Delicate interne elektronische componenten kunnen door statische elektriciteit beschadigd raken, wat een negatieve invloed op de werking kan hebben of een storing kan veroorzaken.

Raadpleeg de stappen in deze procedure om beschadiging van het instrument door elektrostatische ontlading te vermijden:

- Raak een geaard metalen oppervlak aan, zoals de behuizing van een instrument, een metalen leiding of pijp om de statische elektriciteit van het lichaam weg te leiden.
- Vermijd overmatige beweging. Statisch-gevoelige onderdelen vervoeren in anti-statische containers of verpakkingen.
- Draag een polsbandje met een aardverbinding.
- Werk in een antistatische omgeving met antistatische vloerpads en werkbankpads.

## 5.4.2 Elektrische toegang

Steek de kabels van de externe apparaten door de kabelwartels. Zie [Afbeelding 8](#) op pagina 458. Laat de pluggen in de niet-gebruikte kabelwartels zitten.

[Afbeelding 9](#) op pagina 461 toont de onderdelen in de analyser. De aan/uit-schakelaar is een stroomonderbreker die automatisch de hoofdstroomvoorziening van de leiding van het wisselspanningsnet onderbreekt als er een te hoge stroom ontstaat (kortsluiting bijvoorbeeld) of een te hoge spanning optreedt.

## 5.4.3 De externe apparaten aansluiten

Sluit de externe apparaten die met de analyser worden gebruikt, aan op de signaal- en besturingsaansluitingen in de analyser. Raadpleeg [Afbeelding 10](#) op pagina 465 en [Tabel 1](#) op pagina 141.

**Tabel 1 Signaal- en besturingsaansluitingen-Beschrijvingen**

Pen	Beschrijving
AO1–AO8 (P101)	Acht analoge uitgangen voor de besturing van externe apparaten. Raadpleeg .Raadpleeg de uitgebreide gebruikershandleiding online voor meer informatie.
FCT1–FCT5 (P102)	Vijf relais (potentiaalvrije contacten). De maximale belasting is 24 VDC, 0,5 A. <ul style="list-style-type: none"><li>• FCT1-Storingsalarm</li><li>• FCT2-Onderhoudsalarm</li><li>• FCT3 - Analysator gereed</li><li>• FCT4 en FCT5-Voor toekomstig gebruik</li></ul>
DI1–DI7 (P103)	Zeven digitale ingangen om de analyser op afstand te bedienen <sup>5</sup> Sluit de digitale ingangen aan op een extern potentiaalvrij contact (24 V DC) om de analyser te laten starten met een meting voor een kanaal. <ul style="list-style-type: none"><li>• DI1 – Start op afstand voor kanaal 1</li><li>• DI2 – Start op afstand voor kanaal 2</li><li>• DI3 t/m DI7 – Voor toekomstig gebruik</li></ul>

<sup>5</sup> Als de analyser zich in de onderhoudsmodus bevindt, is de afstandsbediening uitgeschakeld.

**Tabel 1 Signaal- en besturingsaansluitingen-Beschrijvingen (vervolg)**

Pen	Beschrijving
FB1–FB4 (P104)	<p>Profibus DP- of Modbus RTU-connectoren (RS485)</p> <p><b>Profibus DP:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FB1–A1 (ingang)</li> <li>• FB2–A2 (uitgang)</li> <li>• FB3–B1 (ingang)</li> <li>• FB4–B2 (uitgang)</li> <li>• SHL-afscherming</li> </ul> <p><b>Modbus RTU:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FB1–D (+)</li> <li>• FB2–D (-)</li> <li>• FB3–niet gebruikt</li> <li>• FB4–niet gebruikt</li> <li>• SHL-afscherming</li> </ul> <p>Raadpleeg de documentatie van de SC4500-controller voor Modbus-configuratie-instructies en telegramtags.</p>
24 VDC/1 A (P105)	24 V DC-voeding voor EZ9010- en EZ9020-filtereenheden
STR1–STR8 (P106)	<p>Acht digitale uitgangen voor het optionele Mod duplex-paneel. Sluit de gestripte draden van elke kanaalklep op het modulopaneel aan op de bijbehorende STR-connectoren.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• STR1–Kanaal 1</li> <li>• STR2–Kanaal 2</li> <li>• ...</li> <li>• STR8–Kanaal 8</li> </ul>
EXT9–EXT12 (P107)	<p>Vier digitale uitgangen voor het optionele EZ9150-filtratiepaneel. Sluit de elektrische ventielen en de pomp op het EZ9150-filterpaneel aan op de EXT-connectoren.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EXT9–Spoelklep</li> <li>• EXT10–Terugspoelklep</li> <li>• EXT11–Overloopventiel afvoer</li> <li>• EXT12–Filtratiepomp</li> </ul>
D01–D06 (P108 en P109)	<p>Zes aansluitingen voor pneumatische kleppen voor het EZ9150-paneel.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• D01–Monsterinlaatklep</li> <li>• D02–Afvoeroverloopklep</li> <li>• D03–Klep Kanaal 1</li> <li>• D04–Klep Kanaal 2</li> <li>• D05–Klep Kanaal 3</li> <li>• D06–Klep Kanaal 4</li> </ul>

#### 5.4.4 Aansluiten op netspanning

<b>⚠ GEVAAR</b>	
	Gevaar van elektrische schokken en brandgevaar. Zorg ervoor dat het meegeleverde snoer en de niet-geborgde stekker in overeenstemming zijn met de van toepassing zijnde voorschriften van het land..

- Zorg dat er een stroomonderbreker met voldoende stroomcapaciteit in het netspannings snoer is geïnstalleerd.

- Zorg ervoor dat de stroomonderbreker of een noodschakelaar in de buurt van de analyser is geïnstalleerd, zodat de analyser indien nodig onmiddellijk van de stroomtoevoer kan worden losgekoppeld.
- Sluit apparatuur aan in overeenstemming met lokale, staats- of nationale elektrische regelgeving.
- Sluit het meegeleverde netsnoer aan via de kabelwartel aan de zijkant van de analyser.
- Draai de kabelwartel vast om de voedingskabel stevig te bevestigen en om de omgevingsclassificatie van de behuizing te behouden.

Sluit de analyser aan op de netvoeding met het meegeleverde netsnoer. Raadpleeg [Tabel 2](#) op pagina 143 en [Afbeelding 11](#) op pagina 468.

## LET OP

Zet de aan/uit-schakelaar niet op aan. Voltooi alle elektrische aansluitingen en slangen voordat u de analyser opstart, anders kan de analyser beschadigd raken.

**Tabel 2 Informatie over bedrading — netvoeding**

Klem	Beschrijving	Kabel kleur-Noord-Amerika en Canada	Kabel kleur-EU
L	Spanningvoerend/Line (L)	Zwart (1)	Bruin
N	Neutraal (N)	Wit (2)	Blauw
	Aarde (PE)	Groen met gele streep	Groen met gele streep

## 5.5 Leidingen

### 5.5.1 Richtlijnen voor monsterleidingen

#### ⚠ VOORZICHTIG



Brandgevaar. Dit product is niet geschikt voor gebruik in combinatie met ontvlambare monsters.

Selecteer een goed, representatief monsternamepunt voor de beste prestaties van het instrument. Het monster moet representatief zijn voor het hele systeem.

- Zorg ervoor dat de monsterstroom groter is dan de stroming naar de analyser.
- Controleer of de monsterleiding op atmosferische druk is als de analyser een peristaltische pomp gebruikt om het monster het analysevat in te verplaatsen.
- Zorg ervoor dat de monsterleiding monster uit een klein overloopvat dichtbij de analyser inneemt.
- Gebruik de monsterslang die wordt meegeleverd. Wijzig de lengte van de monsterslang niet.

Het monster in het overloopvat moet continu worden vernieuwd. Als de afmeting van vaste stoffen in het monster te hoog is, wordt aanbevolen het monster ook te filtreren.

### 5.5.2 Richtlijnen afvoerslangen

#### ⚠ WAARSCHUWING



Brandgevaar. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om voldoende voorzorgsmaatregelen te nemen wanneer het apparaat wordt gebruikt bij methodes waarbij brandbare vloeistoffen worden gebruikt. Volg de juiste voorzorgsmaatregelen voor gebruikers en houd u aan veilige werkprotocollen. Hieronder wordt o.a. verstaan controle op lekken en morsen, goede ventilatie, niet werken zonder toezicht en het instrument nooit zonder toezicht achterlaten terwijl de spanning is ingeschakeld.

## ⚠ VOORZICHTIG



Gevaar van blootstelling aan chemicaliën. Chemicaliën en afval dienen te worden afgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke, regionale en nationale voorschriften.

## LET OP

Sluit de afvoerslangen niet aan op andere slangen omdat er dan tegendruk of schade aan de analyser kan ontstaan. Zorg ervoor dat de afvoerslangen niet luchtdicht zijn.

## LET OP

Zorg ervoor dat de analyser hoger staat dan de gebruikte afvoeren en dat de afvoerslang onder een constante hoek schuin naar beneden loopt, om tegendruk en beschadiging van de analyser te voorkomen. Installeer de afvoerslangen met een verticale daling van 2,54 cm (1 inch) of meer voor elke 0,3 m (1 ft) lengte van de slang.

De analyser gebruikt de afvoerslang om het monster en de reagentia na analyse af te voeren. Correcte installatie van de afvoerslangen is belangrijk om ervoor te zorgen dat alle vloeistof wordt verwijderd uit het instrument. Onjuiste installatie kan ertoe leiden dat vloeistof terugstroomt in het instrument en schade veroorzaakt. Een afvoer in vloer of gootsteen is voldoende voor de afvoerslang. De aanbevolen buitendiameter voor de afvoerslang is 32 mm. Zie [Afbeelding 12](#) op pagina 471.

- Zorg ervoor dat de afvoerslangen zo kort mogelijk zijn.
- Zorg ervoor dat de afvoer lager ligt dan de analyser.
- Zorg ervoor dat de afvoerslangen overal omlaag lopen.
- Zorg ervoor dat de afvoerslangen niet in scherpe bochten lopen en niet wordt afgekneld.
- Zorg ervoor dat de afvoerslangen niet afgesloten zijn van omgevingslucht en niet onder druk staan.
- Zorg ervoor dat de afvoerslangen zijn afgesloten van de omgeving van de installatieruimte.
- De afvoerslang niet blokkeren of onderdompelen.

Een wateraansluiting in de buurt van de analyser wordt ook aangeraden, zodat de spoelbak en de afvoerslang regelmatig worden doorgespoeld met schoon water om verstopping door kristallisatie te voorkomen.

Raadpleeg het methode- en reagensblad van het toepasselijke EZ-seriemodel voor meer informatie over de in de analyser gebruikte reagentia. Als de analyser ontvlambare reagentia gebruikt, dient u de volgende veiligheidsmaatregelen in acht te nemen:

- Sluit de afvoerslang niet aan op een vloerafvoer.
- Voer afval af in overeenstemming met de plaatselijke, regionale en nationale milieuregelgeving.

### 5.5.3 Richtlijnen ventilatieslang

## ⚠ WAARSCHUWING



Brandgevaar. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om voldoende voorzorgsmaatregelen te nemen wanneer het apparaat wordt gebruikt bij methodes waarbij brandbare vloeistoffen worden gebruikt. Volg de juiste voorzorgsmaatregelen voor gebruikers en houd u aan veilige werkprotocollen. Hieronder wordt o.a. verstaan controle op lekken en morsen, goede ventilatie, niet werken zonder toezicht en het instrument nooit zonder toezicht achterlaten terwijl de spanning is ingeschakeld.

## ⚠ VOORZICHTIG



Gevaar van blootstelling aan chemicaliën. Chemicaliën en afval dienen te worden afgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke, regionale en nationale voorschriften.

## LET OP

Sluit de ventilatieslangen (uitlaatgaspoort) niet aan op andere slangen omdat er dan tegendruk of schade aan de analyser kan ontstaan. Zorg ervoor dat de ventilatieslang een opening heeft naar de lucht buiten het gebouw.

Om tegendruk en schade aan de analyser te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat de analyser zich op een hogere plek bevindt dan de gebruikte ventilatie(s) van de installatie, en dat de ventilatieslang een constante neerwaartse helling heeft. Installeer de ventilatieslang met een verticale daling van 2,54 cm (1 inch) of meer voor elke 0,3 m (1 ft) lengte van de slang.

De analyser gebruikt de ventilatieslang om het analysevat op atmosferische druk te houden. Een correcte installatie van de ventilatieslang is belangrijk om ervoor te zorgen dat er tijdens de werking van de pomp geen vloeistof het analysevat binnenstroomt uit de ventilatieslang. Onjuiste installatie kan ertoe leiden dat gas terugstroomt in de analyser en schade veroorzaakt. De aanbevolen buitendiameter voor de uitlaatslang van de ventilatieslang is 32 mm. Zie [Afbeelding 12](#) op pagina 471.

- Zorg ervoor dat de ventilatieslang zo kort mogelijk is.
- Zorg ervoor dat de ventilatieslang overal omlaag loopt.
- Zorg ervoor dat de ventilatieslang niet in scherpe bochten loopt en niet wordt afgekneld.
- Zorg ervoor dat de ventilatieslang is afgesloten van de omgeving van de installatieruimte en niet onder druk staat.
- Zorg ervoor dat de ventilatieslang altijd hoger ligt dan de afvoer.
- De ventilatieslang niet blokkeren of onderdompelen.

Als de analyser ontvlambare reagentia gebruikt, dient u de volgende veiligheidsmaatregelen in acht te nemen:

- Sluit de ventilatieslang niet aan op een vloerafvoer.
- Voer afval af in overeenstemming met de plaatselijke, regionale en nationale milieuregeling.

## 5.5.4 Vul de analyser voor de componententest



### ⚠ VOORZICHTIG



Brandgevaar. Dit product is niet geschikt voor gebruik in combinatie met ontvlambare vloeistoffen.

Voordat de analyser met alle reagentia in gebruik wordt genomen, moet er een componententest met gedeïoniseerd water worden uitgevoerd. Raadpleeg de geïllustreerde stappen en [De onderdeeltests uitvoeren](#) op pagina 149.

1. Plaats de vier slangen van de pinch valves zoals weergegeven in geïllustreerde stap 1 hieronder.
  - a. Druk op de zwarte knop en duw de slang in de pinch valve.
  - b. Laat de knop los wanneer de slang correct is geplaatst.
2. Zorg ervoor dat de afvoerslangen correct in het monstervat zijn geplaatst. Raadpleeg de geïllustreerde stap 2 die volgt.
3. Zorg ervoor dat de vergisterslangen correct in het vergistervat zijn geplaatst. Raadpleeg de geïllustreerde stap 3 die volgt.
4. Sluit alle vloeistofslangen van de analyser aan op een grote fles gedeïoniseerd water om de onderdelen te testen. Raadpleeg de geïllustreerde stap 3 die volgt. De slangen zijn in de fabriek geïnstalleerd.

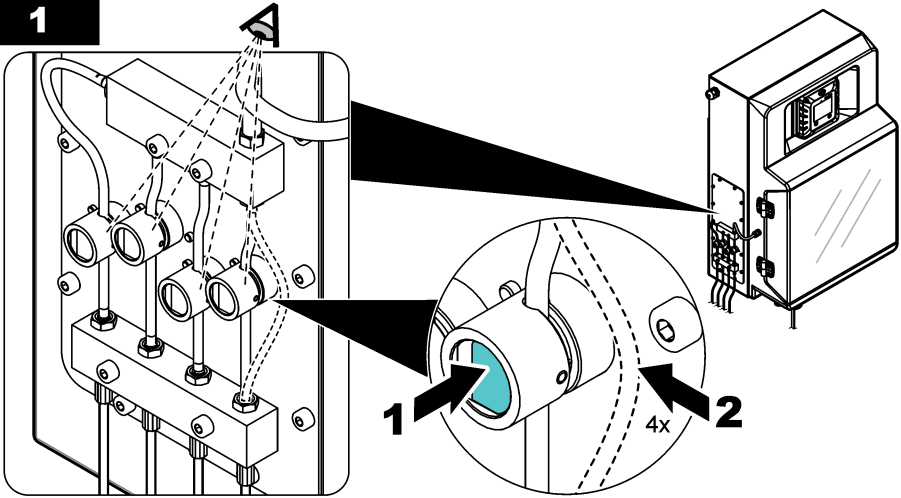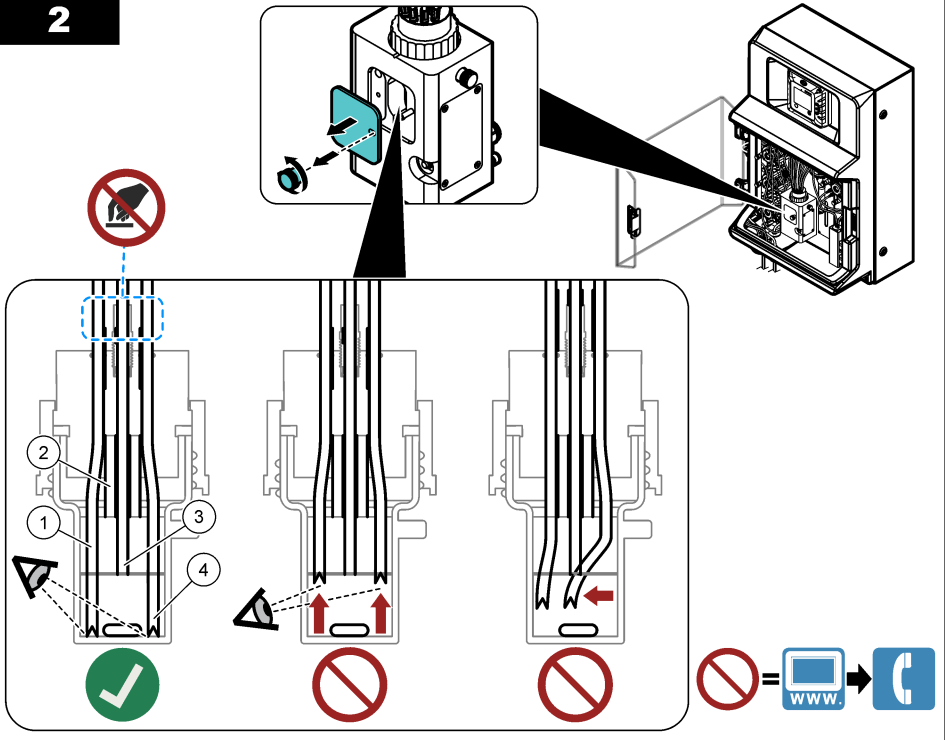**1****2**




1 Afvoerslang

3 Monsterslang

2 Reagentia- en ontluchtingslang (bovenste slang)

4 Vergisterslangen


3

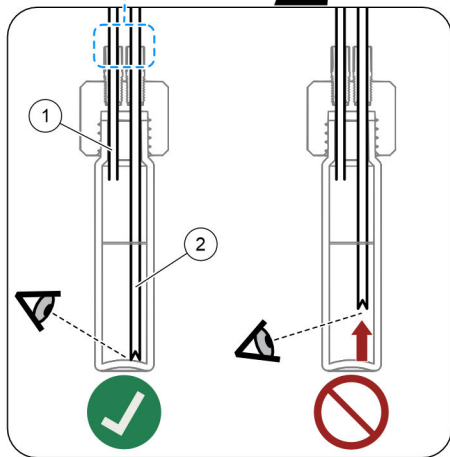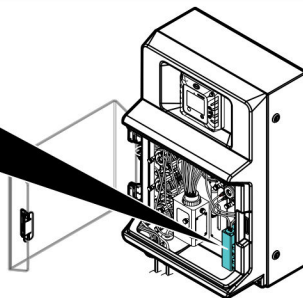

1 Ontluchtingslang

2 Vergisterslang

NL

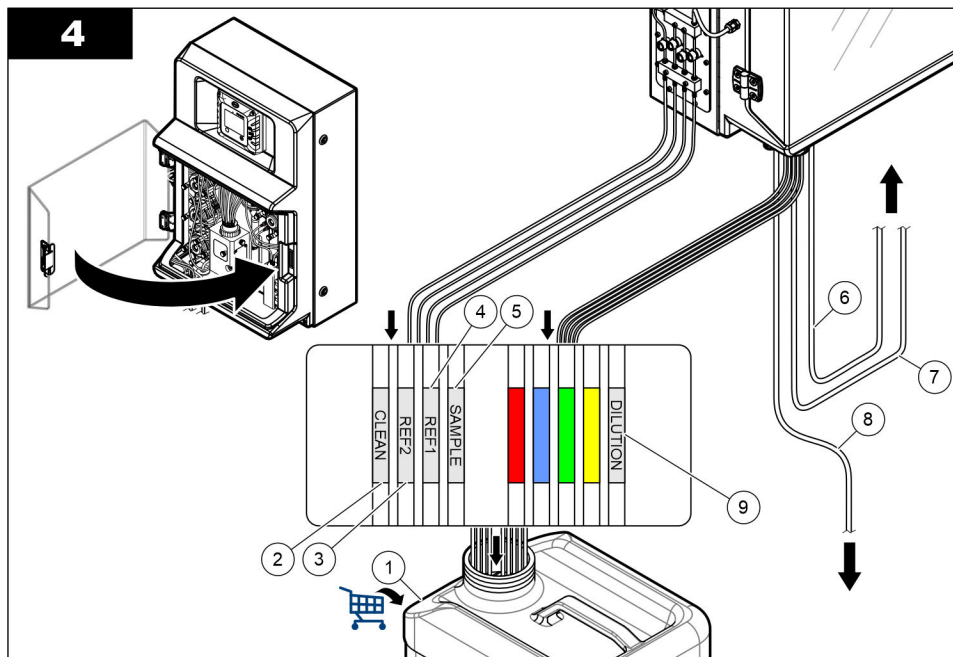

1 Gedeïoniseerd water	4 Slang voor referentie 1-oplossing (REF1)	7 Ontluchting vergister
2 Slang met reinigungsoplossing	5 Monsterinlaatslang	8 Afvoerslangen
3 Slang voor referentie 2-oplossing (REF2)	6 Ontluchtungs slang	9 Slang van de verdunnings- en reagensmicropomp

## Hoofdstuk 6 Opstarten

### 6.1 Eerste keer opstarten

**Opmerking:** Zorg ervoor dat de montage, aansluiting van slangen en elektrische installaties volledig zijn voltooid voordat u begint met opstarten. Zie [Installatie](#) op pagina 139.


Wanneer de analyser voor de eerste keer wordt ingeschakeld, helpt een opstartassistent bij de eerste stappen om de instelling te voltooien. Voer alle volgende stappen uit om er zeker van te zijn dat de analyser correct werkt.

**Opmerking:** Zorg ervoor dat u de juiste reagentia gebruikt voor het geselecteerde meetbereik. Raadpleeg de uitgebreide gebruikershandleiding online voor meer informatie.

1. Open de deur van de analyser. Zie [Open de deur van de analyser](#) op pagina 140.
2. Zet de aan/uit-schakelaar in de AAN-stand. Raadpleeg [Afbelding 9](#) op pagina 461.
3. Sluit de deur van de analyser met de meegeleverde sleutel.
4. Wacht tot de initialisatieprocedure is voltooid.
5. Reageer op de aanwijzingen op het scherm om de taal, tijdzone, datum en tijd te selecteren. Raadpleeg de documentatie bij de SC4500-controller voor informatie over het configureren van de andere controllerinstellingen.
6. Tik op het scherm om het **EZ2700sc**-menu weer te geven.
7. Selecteer **Apparaatmenu** om de opstartassistent te starten. Het welkomsscherm wordt weergegeven.

8. Voer de stappen op het scherm uit om het toepasselijke meetbereik te selecteren. Druk op **OK**.
9. Als een filtratie-eenheid geïnstalleerd is, selecteert u **Aan**. Zo niet, selecteert u **Uit**.
10. Selecteer het aantal kanalen voor de analyser. Druk op **OK**.
11. Als de configuratie op de samenvattingspagina correct is, drukt u op **OK**.  
Het **EZ2700sc**-hoofdmenu wordt weergegeven.
12. Ga door met de componenttest. Zie [De onderdeeltests uitvoeren](#) op pagina 149.

## 6.2 De onderdeeltests uitvoeren

<b>⚠ WAARSCHUWING</b>	
	<p>Gevaar van beknelling. Bewegende delen kunnen tot beknelling en daardoor verwondingen leiden. Raak bewegende delen niet aan.</p>

Voer de onderdeeltests uit voordat de analyser in bedrijf wordt gesteld. Gebruik het menu **Onderhoud** om de verschillende analyserfuncties te starten en de werking van de onderdelen te controleren.

### Voorvereisten:

- Als de analyser in de operationele modus is, selecteert u **Onderhoud > Start de onderhoudsmodus**.
- Zorg ervoor dat het monster, de reagens en de oplossingslangen zich in een container met gedeïoniseerd water bevinden. Zie [Vul de analyser voor de componenttest](#) op pagina 145.

### 6.2.1 De roerder inspecteren

1. Verwijder het lichtscherm van de fotometereenheid. Zie [Afbeelding 13](#) op pagina 472.
2. Zorg ervoor dat de roerder zich onderin het monstervat bevindt.  
***Opmerking:** Controleer de roerder tijdens de primingprocedure om er zeker van te zijn dat de roerder correct draait. De primingprocedure wordt gestart in [De pompen en pinch valves controleren](#) op pagina 149.*
3. Breng het lichtscherm aan op de fotometer.

### 6.2.2 De pompen en pinch valves controleren

1. Controleer de werking van de pompen en pinch valves om er zeker van te zijn dat er geen lekken zijn.
2. Zorg ervoor dat het analysevat wordt gevuld met gedeïoniseerd water. Zie [Afbeelding 14](#) op pagina 474.
3. Controleer of er gedeïoniseerd water uit de afvoerslang komt.
4. Selecteer **Onderhoud > Start het aanvullen** en vul alle vloeistoffen afzonderlijk.  
Als er een lekkage optreedt, controleer dan alle aansluitingen en raadpleeg de uitgebreide gebruikershandleiding online voor meer informatie.
  - a. Selecteer **Referentie 1 primen** en druk op **OK**.
  - b. Selecteer **Referentie 2 primen** en druk op **OK**.
  - c. Selecteer **Reinigingsoplossing primen** en druk op **OK**.
  - d. Selecteer **Primen voor spoelen** en druk op **OK**.
  - e. Selecteer **Dispenser primen** en druk op **OK**.
  - f. Selecteer **Kanaal primen > Alle kanalen primen** en druk op **OK**.  
Elke voorvulprocedure wordt automatisch gestopt wanneer de procedure is voltooid.

### 6.2.3 De micropompen controleren

Controleer de micropompen op lekkages en luchtballen.

1. Verwijder het lichtscherf van de fotometer.
2. Selecteer **Onderhoud > Start het aanvullen > Alle reagentia aanvullen**.
3. Zorg ervoor dat gedeïoniseerd water in de micropomp terechtfomt via elk van de (reagens)buisjes van de micropomp. Vervolgens continu in het analysevat, zonder luchtballen. Zie [Afbeelding 15](#) op pagina 475.
4. Als de micropompen niet correct werken (luchtballen in de slangen), gebruik dan de injectiespuitprocedure om gedeïoniseerd water in de betreffende slangen te persen om de luchtballen te verwijderen. Zie [Afbeelding 16](#) op pagina 476.
5. Breng het lichtscherf aan op de fotometer.

### 6.2.4 Voer een controle met fotometer uit

Zorg ervoor dat de buitenkant van het analysevat schoon is vóór de controle met de fotometer, zodat de controle met succes kan worden uitgevoerd. Raadpleeg voor het reinigen van de componenten van de analyser eerst de uitgebreide versie van de gebruikershandleiding die online beschikbaar is.

1. Druk op het pictogram van het hoofdfmenu en selecteer **Apparaten**.
2. Selecteer **EZ2700sc**.
3. Blader naar de onderkant van het scherm en selecteer vervolgens **Apparaatfmenu**.
4. Selecteer **Onderhoud > Controle met fotometer**.
5. Druk op **OK** om de meting te starten.  
Wanneer de donkere kalibratie voltooid is, wordt het resultaat weergegeven op het scherm.
6. Druk op **OK** om verder te gaan.
7. Zorg ervoor dat de 'REF1' slang is aangesloten op een container gevuld met gedeïoniseerd water. Zorg dat de lichtkap is geïnstalleerd. Zie [Afbeelding 18](#) op pagina 479.
8. Druk op **OK**.  
Wacht tot het analysevat is gevuld.
9. Stel met een schroevendraaier de spanning van de sensoruitgang in op 9 V. Raadpleeg [Afbeelding 17](#) op pagina 476.
10. Wacht tot u de waarde 9 V op het scherm ziet. Druk dan op **OK**.
11. Druk op **OK** om verder te gaan.

## 6.3 Een test van het invoersignaal uitvoeren

Test de digitale ingangen voordat u de analyser in gebruik neemt.

**Voorvereisten:** Sluit de digitale ingangen aan op een extern potentiaalvrij contact (24 VDC).

Voer als volgt een test uit van de digitale ingangssignalen en de analoge uitgangssignalen:

1. Druk op het pictogram van het hoofdfmenu en selecteer vervolgens **Apparaten**.
2. Selecteer **EZ2700sc**.
3. Blader naar de onderkant van het scherm en selecteer vervolgens **Apparaatfmenu**.
4. Selecteer **Diagnose > Signalen**.  
De signalen bij de digitale ingangen worden weergegeven.
5. Vergelijk de status van de digitale ingangen op het display met de spanningen die aan de digitale ingangen worden geleverd (24 V = Aan; 0 V = Uit).

## 6.4 Een test van het uitvoersignaal uitvoeren

Test de analoge uitgangen voordat u de analyser in gebruik neemt.

**Voorvereisten:** Configureer de analoge uitgangen (AO1–AO8, P101) om de kanaalmeting te selecteren die door elke analoge uitgang wordt weergegeven. Raadpleeg de uitgebreide gebruikershandleiding online voor meer informatie.

Voer als volgt een test van het analoge uitvoersignaal uit:

1. Druk op het pictogram van het hoofdmenu.
2. Selecteer **Uitgangen > mA uitgangen AOC > Test/onderhoud**.

Optie	Beschrijving
<b>Functietest</b>	Voert een test uit van de uitgangen op de geselecteerde module.
<b>Uitvoerstatus</b>	Geeft de status van de uitgangen op de geselecteerde module weer.

3. Gebruik een multimeter om de mA-waarde bij elke analoge uitgang te meten.
4. Vergelijk de mA-waarde gemeten bij de analoge uitgangen met de verwachte mA-waarden.

## 6.5 De kanaalvolgorde instellen



Selecteer de volgorde waarin de kanalen worden gemeten, het aantal keren dat elk kanaal wordt gemeten en de wachttijd voordat een kanaal wordt gemeten. Voer maximaal 16 regels in met maximaal 16 cycli per regel.

1. Druk op het pictogram van het hoofdmenu en selecteer **Apparaten**.
2. Selecteer **EZ2700sc**.
3. Blader naar de onderkant van het scherm en selecteer vervolgens **Apparaatmenu**.
4. Als de analyser in de operationele modus staat, selecteer dan **Onderhoud > Start de onderhoudsmodus**.  
Wacht tot de analyser in onderhoudsmodus staat.
5. Selecteer **Configuratie > Kanaalvolgorde instellen**.
6. Gebruik de pijlen op de zijbalk om een positie te selecteren (nummer in de reeks) en druk vervolgens op **OK** om die positie te configureren.
7. Selecteer een optie.

Optie	Beschrijving
<b>Selecteren</b>	Hiermee selecteert u het gewenste kanaal of de gewenste wachttijd.
<b>Aantal metingen</b>	Hiermee stelt u het aantal metingen voor een kanaal in.
<b>Wachttijd</b>	Hiermee stelt u de wachttijd in voor het geselecteerde kanaal.

8. Druk op **OK** om de wijzigingen op te slaan.

## 6.6 Sluit de oplossingen en het monster aan

<b>⚠ VOORZICHTIG</b>	
	Gevaar van blootstelling aan chemicaliën. Volg alle laboratorium technische veiligheidsvoorschriften op en draag alle persoonlijke beschermingsuitrustingen die geschikt zijn voor de gehanteerde chemicaliën. Raadpleeg de huidige veiligheidsinformatiebladen (MSDS/SDS) voor veiligheidsprotocollen.
<b>⚠ VOORZICHTIG</b>	
	Gevaar van blootstelling aan chemicaliën. Chemicaliën en afval dienen te worden afgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke, regionale en nationale voorschriften.

## ⚠ VOORZICHTIG



Brandgevaar. Dit product is niet geschikt voor gebruik in combinatie met ontvlambare vloeistoffen.

De reagenshouders worden meegeleverd bij de analyser. Raadpleeg [Afbeelding 18](#) op pagina 479. De houders voor de referentie 1-oplossing en de referentie 2-oplossing en het gedeïoniseerd water worden door de gebruiker geleverd. Meer houders kunnen bij de fabrikant worden gekocht.

Installeer de houders

- zo dicht mogelijk bij de analyser
- 1 meter onder de bodem van de analyser

Raadpleeg [Afbeelding 18](#) op pagina 479 voor de containerinstallatie.

De reagentia en oplossingen worden door de gebruiker geleverd. Gebruik uitsluitend reagentia die door een gecertificeerd bedrijf zijn geleverd of gebruik uitsluitend door de fabrikant goedgekeurde reagentia. Als alternatief kunnen reagentia door de gebruiker worden bereid. Volg de instructies in het methode- en reagensblad voor het toepasselijke model dat u op de website van de fabrikant vindt.

De slangen zijn in de fabriek geïnstalleerd. Lees het etiket op elke slang om de juiste aansluitkoppeling te bepalen. Raadpleeg het toepasselijke methode- en reagensblad voor het model op de website van de fabrikant voor de juiste reagentia, oplossingen en standaarden.

1. Nadat de onderdeeltests zijn uitgevoerd, plaatst u de slangen "CLEAN" (reinigingsoplossing), "REF1" (referentie 1-oplossing) en "REF2" (referentie 2-oplossing) in de bijbehorende containers. Zie [Afbeelding 18](#) op pagina 479.
2. Plaats elke reagensbuis met kleurcodering in de reagenscontainer met dezelfde kleur op het label.
3. Sluit de monsterbron (of de monsteruitlaat van het Moduplex-paneel of filterpaneel) aan op de monsterinlaatslang van de analyser. Zie [Afbeelding 18](#) op pagina 479.
4. Druk op het pictogram van het hoofdmenu en selecteer **Apparaten**.
5. Selecteer **EZ2700sc**.
6. Blader naar de onderkant van het scherm en selecteer vervolgens **Apparaatmenu**.
7. Selecteer **Onderhoud > Start het aanvullen > Alle aanvullen**.

## 6.7 Voer een validatie uit voor de eerste keer opstarten

Voer een validatie uit om te controleren of de metingen binnen het tolerantiebereik vallen. Raadpleeg de uitgebreide gebruikershandleiding online voor meer informatie.

1. Druk op het pictogram van het hoofdmenu en selecteer **Apparaten**.
2. Selecteer **EZ2700sc**.
3. Blader naar de onderkant van het scherm en selecteer vervolgens **Apparaatmenu**.
4. Om een validatie te starten, selecteert u **Kalibratie > Validatie > Start de validatie**.  
De validatie meet het gedeïoniseerde water in de Reference 2-fles.
5. Selecteer een optie om de resultaten weer te geven:
  - **Kalibratie > Validatie > Validatiegeschiedenis**
  - **Diagnose > Historische gegevens > Validatie**

## 6.8 De analyser starten

Doe het volgende om de analyser te starten:

1. Druk op het pictogram van het hoofdmenu en selecteer **Apparaten**.
2. Selecteer **EZ2700sc**.
3. Blader naar de onderkant van het scherm en selecteer vervolgens **Apparaatmenu**.
4. Selecteer **Onderhoud > Start de bedrijfsmodus**.

# Indholdsfortegnelse

- 1 Yderligere oplysninger på side 154
- 2 Produktoversigt på side 154
- 3 Specifikationer på side 155

- 4 Generelle oplysninger på side 156
- 5 Installation på side 158
- 6 Opstart på side 167

## Sektion 1 Yderligere oplysninger

Den grundlæggende brugervejledning indeholder tilstrækkelige oplysninger til at gennemføre driftsætelsen. En udvidet brugervejledning findes online og indeholder flere oplysninger.

### ⚠ FARE



Flere risici! Der findes flere oplysninger i de enkelte afsnit i den udvidede brugervejledning, som er vist nedenfor.

- Brugergænseflade og navigation
- Betjening
- Vedligeholdelse
- Fejlfinding
- Reservedele

Scan QR-koderne, der følger, for at gå til den udvidede brugervejledning.



Europæiske sprog



Amerikanske og asiatiske sprog

## Sektion 2 Produktoversigt

Hach EZ2700sc-analysatoren er en onlineanalysator, der måler én parameter i vandprøver fra industrielle og miljømæssige anvendelser. Se [Figur 1](#) på side 437, [Figur 2](#) på side 440 og [Figur 3](#) på side 445.

Analysatoren er en direkte styret, kolorimetrisk analysator til generel vandanalyse (f.eks. nitrat, fosfat). Analysatoren har funktioner til fjernstyret start, automatisk validering, automatisk kalibrering, automatisk rensning og Modbus.

Prøven løber ind i analysatoren gennem prøveslangen. Pumperne, ventilerne og sprøjterne i analysatoren flytter prøven og reagenserne til målecellen på analysepanelet. Når analyseprocessen i beholderen er fuldført, sender analysatoren prøven gennem afløbsslangen. Analyseresultaterne vises på SC4500-kontrolenhedens display. SC4500-kontrolenheden gemmer analysatorens data (datalog, hændelseslog, indstillingslog og servicelog). Brug SC4500-kontrolenheden til at betjene og konfigurere analysatoren.

Hvis du vil øge antallet af prøvestrømme (kanaler), som analysatoren kan måle (2, 4 eller 8), skal du købe Moduplex-multistrømspanelet til analysatoren.

Til klargøring af prøven (filtrering, bundfældning) skal du købe EZ9010-, EZ9020- EZ9150-, EZ9200- eller EZ9250-filtreringspanelet til analysatoren.

## Sektion 3 Specifikationer

Specifikationerne kan ændres uden varsel.

Specifikation	Detaljer
Mål (B x H x D)	460 x 688 x 340 mm (18,1 x 27,1 x 13,4")
Kabinet	IP44, ABS, PMMA og overfladebehandlet stål
Display	IP66, 3,5" TFT-farvedisplay med kapacitiv berøringsplade
Vægt	40 kg (88 lb)
Strømkrav	100 til 240 VAC ±10 %, 50/60 Hz
Strømforsyning	240 VA maks.
Højde	2000 m (6560 fod) maksimum
Overspændingskategori	II
Miljømæssige forhold	Kun til indendørs brug.
Forureningsgrad	2
Driftstemperatur	10-30 °C (50-86 °F), 5-95 % relativ luftfugtighed, ikke-kondenserende, ikke-ætsende
Opbevaringstemperatur	-20 til 60 °C (-4 til 140 °F); 95 % relativ luftfugtighed, ikke-kondenserende maks.
Prøveindløb	Én
Prøvetryk	Ved ekstern overløbsbeholder (åben til atmosfærisk tryk)
Gennemstrømningshastighed for prøve	100 til 300 mL/min
Prøvetemperatur	10 til 30 °C (50 til 86 °F)
Prøvekvalitet	< 100 µm partikler, < 0,1 g/L maks. Turbiditet < 50 NTU
Luftskylning til korrosive miljøer	0,2 bar (20 kPa eller 3 psi), tør og ren luft
Afløb	Atmosfærisk tryk, ventileret, min. Ø 32 mm
Jordforbindelse	Tør og ren jordingsstang med lav impedans (< 1 Ω) med et jordkabel på > 2,5 mm <sup>2</sup> (13 AWG)
Analoge udgange	Otte 0–20 mA (eller 4-20 mA) analoge udgange maks. <b>BEMÆRK:</b> De analoge udgange leverer sløffestrom. Der kan ikke levere strøm til kontakterne på SCADA- eller PLC-systemet.
Digitale indgange	Syv digitale indgange: To digitale indgange til fjernstyret start. De resterende digitale indgange er til fremtidig brug.
Digitale udgange	Fire strømforsynede digitale udgange til ventiler og pumper på EZ9150-panelet, otte strømforsynede digitale udgange til ventiler på Moduplex-panelet, 24 V DC, 500 mA.
Relæer	Fem potentialfrie kontakter (FCT), maksimal belastning 24 V DC, 0,5 A (ohmsk belastning)
Ethernet-forbindelser	Claros Ethernet-forbindelse og Modbus TCP/IP Ethernet-stik, LAN-version, 10/100 Mbps, eller Profinet eller Ethernet IP
RS485-kommunikation	Profibus DP eller Modbus RTU

DA

<sup>2</sup> Se oplysninger om Ethernet-konfiguration og Modbus-konfiguration i dokumentationen til SC4500-kontrolenheden.

Specifikation	Detaljer
Certificeringer	CE, ETL-certificeret iht. UL- og CSA-sikkerhedsstandarderne
Garanti	1 år (EU: 2 år)

## Sektion 4 Generelle oplysninger

Producenten kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for skade som følge af forkert brug af produkter eller manglende overholdelse af foreskrifterne i brugsvejledningen. Producenten forbeholder sig ret til når som helst at foretage ændringer i denne manual og de beskrevne produkter uden varsel eller forpligtelser. Reviderede udgaver kan findes på producentens webside.

### 4.1 Sikkerhedsoplysninger

Producenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader på grund af forkert anvendelse eller misbrug af dette produkt, herunder uden begrænsning direkte skader, hændelige skader eller følgeskader, og fraskriver sig ansvaret for sådanne skader i det fulde omfang, som tillades ifølge gældende lov. Kun brugeren er ansvarlig for at identificere alvorlige risici ved anvendelsen og installere relevante mekanismer til beskyttelse af processerne i forbindelse med en eventuel fejl på udstyret.

Læs hele manualen inden udpakning, installation eller betjening af dette udstyr. Læg især mærke til alle fare- og advarselsmeddelelser. Undladelse heraf kan medføre, at brugeren kommer alvorligt til skade, eller det kan medføre beskadigelse af analysatoren.

Hvis udstyret bruges på en måde, der ikke er specificeret af producenten, kan den beskyttelse, som udstyret giver, blive forringet. Dette udstyr må ikke anvendes eller installeres på nogen anden måde end hvad der er anført i denne manual.

#### 4.1.1 Brug af sikkerhedsoplysninger

##### ▲ FARE

Angiver en eventuel eller overhængende farlig situation, der vil medføre dødsfald eller alvorlige kvæstelser, hvis den ikke undgås.

##### ▲ ADVARSEL

Angiver en potentiel eller umiddelbart farlig situation, som kan resultere i død eller alvorlig tilskadekomst, hvis den ikke undgås.

##### ▲ FORSIGTIG

Indikerer en potentiel farlig situation, der kan resultere i mindre eller moderat tilskadekomst.

##### BEMÆRKNING

Angiver en situation, der kan medføre skade på instrumentet, hvis ikke den undgås. Oplysninger, der er særligt vigtige.

#### 4.1.2 Sikkerhedsmærkater





Læs alle skilte og mærkater, som er placeret på apparatet. Der kan opstå person- eller instrumentskade, hvis forholdsreglerne ikke respekteres. I håndbogen refereres der til et symbol på instrumentet med en forholdsregelklæring.



Dette er sikkerhedsalarmsymbolen. Overhold alle sikkerhedsmeddelelser, der følger dette symbol, for at undgå potentiel kvæstelse. Se brugsanvisningen vedrørende drifts- eller sikkerhedsoplysninger, hvis det vises på instrumentet.



Dette symbol identificerer risiko for kemisk skade og angiver, at kun personer, der er kvalificerede og uddannede til at arbejde med kemikalier, bør håndtere kemikalier eller udføre vedligeholdelse af kemiske leveringssystemer i forbindelse med udstyret.





	Dette symbol angiver, at der er risiko for elektrisk stød og/eller dødsfald pga. elektrisk stød.
	Dette symbol angiver tilstedeværelsen af enheder, der er følsomme over for elektrostatisk afladning (ESD) og angiver, at der skal udvises forsigtighed for at forhindre beskadigelse af udstyret.
	Dette symbol angiver, at der kræves en beskyttende jordforbindelse til det markerede element. Hvis instrumentet ikke er udstyret med et jordstik på en ledning, skal der laves en beskyttende jordforbindelse til beskyttelseslederterminalen
	Elektrisk udstyr mærket med dette symbol må, i Europa, ikke bortskaffes i sammen med husholdningsaffald eller offentligt affald. Returner gammelt eller udtjent udstyr til producenten til bortskaffelse uden gebyr.

DA

### 4.1.3 Kemisk og biologisk sikkerhed

<b>⚠ FARE</b>	
	Kemiske eller biologiske farer. Hvis dette instrument anvendes til at overvåge en behandlingsproces og/eller et kemisk tilførselssystem, hvor der gælder lovbestemte begrænsninger og overvågningskrav i forbindelse med folkesundhed, offentlig sikkerhed, føde- og drikkevareproduktion eller -forarbejdning, ligger ansvaret hos brugeren af instrumentet med hensyn til at kende og overholde enhver gældende bestemmelse og at sikre tilstrækkelige og egnede tiltag for at overholde gældende bestemmelser, såfremt instrumentet ikke fungerer.

## 4.2 Ikoner brugt i illustrationerne

			
Producent leverede dele	Bruger leverede dele	Se	Udfør trinnene i omvendt rækkefølge

				
Vær to om opgaven	Lyt	Brug kun fingrene	Brug ikke værktøj	Må ikke berøres

## 4.3 Tilsigtet brug

Hach EZ-seriens analysatorer er beregnet til brug af personer, der skal måle vandkvalitetsparametre kontinuerligt i prøver fra industrielle og miljømæssige anvendelsesområder. Hach EZ-seriens analysatorer behandler eller ændrer ikke på vandets sammensætning og anvendes ikke til at styre procedurer.

## 4.4 Produktkomponenter

Sørg for, at alle komponenter er modtaget. Se [Figur 4](#) på side 449. Kontakt producenten eller forhandleren med det samme, hvis der er mangler eller defekte dele i sendingen.

## Sektion 5 Installation

### ▲ FARE



Flere risici. Kun kvalificeret personale må udføre de opgaver, som er beskrevet i dette afsnit i dokumentet.

### 5.1 Installationsretningslinjer

#### ▲ ADVARSEL



Brandfare. Brugeren er ansvarlig for at sikre, at der er taget tilstrækkelige forholdsregler, når udstyret bruges sammen med metoder, der anvender brændbare væsker. Sørg for at overholde de korrekte brugerforanstaltninger og sikkerhedsprotokoller. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, kontrol af spild og lækage, korrekt ventilation, ingen ikke-overvåget brug, og at instrumentet aldrig efterlades uden overvågning, mens det er tilsluttet strøm.

#### ▲ FORSIGTIG



Fare for eksponering for kemiske stoffer. Overhold laboratoriets sikkerhedsprocedurer, og bær alt det personlige beskyttelsesudstyr, der er nødvendigt for at beskytte dig mod de kemikalier, du bruger. Se de aktuelle sikkerhedsdataark (MSDS/SDS) for sikkerhedsprotokoller.

#### ▲ FORSIGTIG



Fare for eksponering for kemiske stoffer. Bortskaf kemikalier og spildevand i overensstemmelse med lokale, regionale og nationale bestemmelser.

- Installer analysatoren indendørs i et ufarligt miljø.
- Installer analysatoren i et miljø, der er beskyttet mod ætsende væsker.
- Installer analysatoren i et rent, tørt, velventileret og temperaturstyret område.
- Installer analysatoren så tæt på prøvepunktet som muligt.
- Installer ikke analysatoren, hvor den udsættes for direkte sollys, eller i nærheden af varmekilder.
- Sørg for, at der er tilstrækkelig plads til at lave rørforbindelser og elektriske tilslutninger.
- Sørg for at efterlade tilstrækkelig plads foran analysatoren, så analysatorens dør kan åbnes. Se [Analysatorens mål](#) på side 159.
- Sørg for, at de omgivende forhold ligger inden for driftsspecifikationerne. Se [Specifikationer](#) på side 155.

Selv om analysatoren ikke er beregnet til brug sammen med brændbare prøver, bruger nogle EZ-analysatorer brændbare reagenser. Se metode- og reagensdatabladet for den relevante EZ-seriemodellen for at få flere oplysninger om reagenser, der bruges i analysatoren. Hvis analysatoren anvender brændbare reagenser, skal du sørge for at overholde de følgende sikkerhedsforanstaltninger:

- Hold analysatoren væk fra varme, gnister og åben ild.
- Der må ikke spises, drikkes eller ryges i nærheden af analysatoren.
- Brug et lokalt udsugningssystem.
- Brug gnistsikre og eksplosions sikre apparater og lyssystemer.
- Undgå elektrostatisk afladning. Se [Hensyn i forbindelse med elektrostatisk udladning \(ESD\)](#) på side 159.
- Rengør og tør instrumentet helt før brug.
- Vask hænder før pauser og ved arbejdsskiftets afslutning.
- Fjern forurenet tøj. Vask tøjet, før det bruges igen.
- Disse væsker skal håndteres i overensstemmelse med lokale myndighedskrav vedrørende tilladte eksponeringsgrænser.

## 5.2 Analysetorens mål

Se målene på analysatoren i [Figur 5](#) på side 454.

## 5.3 Mekanisk installation

### 5.3.1 Fastgør instrumentet på en væg

▲ ADVARSEL	
	Fare for personskade. Sørg for, at vægmonteringen kan holde 4 gange udstyrets vægt.

DA

▲ ADVARSEL	
	Fare for personskade. Instrumenter eller komponenter er tunge. Få hjælp ved installation eller flytning.

▲ ADVARSEL	
	Fare for personskade. Produktet er tungt. Sørg for, at udstyret er sikkert fastgjort til en væg, et bord eller gulvet for sikker betjening.

Brug de medfølgende monteringsbeslag til at fastgøre instrumentet opretstående og i vater på en flad, lodret vægflade. Se [Figur 6](#) på side 456.

Monter instrumentet et sted og i en position, hvor brugeren nemt kan frakoble instrumentet fra strømkilden.

Sørg for, at der er tilstrækkelig plads under analysatoren til at indsætte flasker.

Monteringsdelene leveres af brugeren. Sørg for, at vægbeslaget har en tilstrækkelig bæreevne (ca. 160 kg eller 353 lbs). Monteringsudstyret skal være godkendt til væggens egenskaber.

### 5.3.2 Åbn analysatordøren

Brug den medfølgende nøgle til at låse de to låse på analysatorens side op. Se [Figur 7](#) på side 456. Sørg for at lukke døren før drift for at opretholde kabinetets miljø- og sikkerhedsklassificering.

## 5.4 Elektrisk installation

▲ FARE	
	Fare for livsfarligt elektrisk stød. Frakobl altid strømmen fra instrumentet, før der udføres elektriske tilslutninger.

### 5.4.1 Hensyn i forbindelse med elektrostatisk udladning (ESD)

BEMÆRKNING	
	Potentiel instrumentskade. Følsomme elektroniske komponenter kan blive beskadiget af statisk elektricitet, hvilket resulterer i forringet ydelse eller eventuel defekt.

Se trinene i denne procedure for at undgå ESD-skader på instrumentet.

- Rør ved en metaloverflade med stelforbindelse som f.eks. et instrumentstel, et ledningsrør eller rør i metal for at aflade statisk elektricitet fra kroppen.
- Undgå overdreven bevægelse. Transporter komponenter, der er følsomme over for statisk elektricitet, i antistatiske beholdere eller emballage.
- Brug en håndledsrem, der via et kabel er forbundet til jord.
- Arbejd i et område uden statisk elektricitet med antistatisk gulvunderlag og bænkunderlag.

## 5.4.2 Elektrisk adgang

Før de eksterne enheders kabler gennem kabelforskrningerne. Se [Figur 8](#) på side 457. Opbevar propperne til de kabelforskrninger, der ikke er i brug.

[Figur 9](#) på side 460 viser komponenterne inde i analysatoren. Tænd/sluk-knappen er en afbryder, som automatisk afbryder strømforsyningen fra vekselstrømsledningen, hvis der forekommer overstrøm (f.eks. kortslutning) eller overspænding.

## 5.4.3 Tilslutning af eksterne enheder

Slut de eksterne enheder, der skal bruges sammen med analysatoren, til signal- og styreklemmerne i analysatoren. Se i [Figur 10](#) på side 463 og [Tabel 1](#) på side 160.

**Tabel 1 Signal- og styreklemmer—Beskrivelser**

Ben	Beskrivelse
AO1–AO8 (P101)	Otte analoge udgange til styring af eksterne enheder. Se .Du kan finde flere oplysninger i onlineversionen af den udvidede brugervejledning.
FCT1–FCT5 (P102)	Fem relæer (potentialfrie kontakter). Maks. belastning er 24 V DC, 0,5 A. <ul style="list-style-type: none"><li>• FCT1—Fejlarmer</li><li>• FCT2—Vedligeholdelsesalarmer</li><li>• FCT3—Analysator klar</li><li>• FCT4 og FCT5—Til fremtidig brug</li></ul>
DI1–DI7 (P103)	Syv digitale indgange til fjernstyring af analysatoren <sup>5</sup> Slut de digitale indgange til en ekstern potentialfri kontakt (24 V DC) for at få analysatoren til at starte en måling for en kanal. <ul style="list-style-type: none"><li>• DI1—Fjernstyret start for Kanal 1</li><li>• DI2—Fjernstyret start for Kanal 2</li><li>• DI3 til DI7—Til fremtidig brug</li></ul>
FB1–FB4 (P104)	Profibus DP- eller Modbus RTU-stik (RS485) <b>Profibus DP:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• FB1—A1 (indgang)</li><li>• FB2—A2 (udgang)</li><li>• FB3—B1 (indgang)</li><li>• FB4—B2 (udgang)</li><li>• SHL—Skærm</li></ul> <b>Modbus RTU:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• FB1—D (+)</li><li>• FB2—D (-)</li><li>• FB3—ikke i brug</li><li>• FB4—ikke i brug</li><li>• SHL—Skærm</li></ul> Se dokumentationen til SC4500-kontrolenheden vedrørende instruktioner til Modbus-konfiguration og telegrammærker.
24 V DC/1 A (P105)	24 V DC strømforsyning til filtreringsenhederne EZ9010 og EZ9020

<sup>5</sup> Hvis analysatoren er i vedligeholdelsestilstand, er fjernstyring deaktiveret.

**Tabel 1 Signal- og styreklemmer—Beskrivelser (fortsat)**

Ben	Beskrivelse
STR1—STR8 (P106)	Otte digitale udgange til Moduplex-panelet (ekstraudstyr). Slut de afisolerede ledninger på hver af Moduplex-panelets kanalventiler til de tilhørende STR-stik. <ul style="list-style-type: none"> <li>• STR1—Kanal 1</li> <li>• STR2—Kanal 2</li> <li>• ...</li> <li>• STR8—Kanal 8</li> </ul>
EXT9—EXT12 (P107)	Fire digitale udgange til EZ9150-filtreringspanelet (ekstraudstyr). Slut de elektriske ventiler og pumpen på EZ9150-filtreringspanelet til EXT-tilslutningsforbindelserne. <ul style="list-style-type: none"> <li>• EXT9—Skylleventil</li> <li>• EXT10—Tilbageskylningsventil</li> <li>• EXT11—Overløbsventil til afløb</li> <li>• EXT12—Filtreringspumpe</li> </ul>
D01—D06 (P108 og P109)	Seks pneumatiske ventiludløb til EZ9150-panelet. <ul style="list-style-type: none"> <li>• D01—Prøveindløbsventil</li> <li>• D02—Overløbsventil for afløb</li> <li>• D03—Kanal 1-ventil</li> <li>• D04—Kanal 2-ventil</li> <li>• D05—Kanal 3-ventil</li> <li>• D06—Kanal 4-ventil</li> </ul>

DA

#### 5.4.4 Tilslut til vekselstrøm

### ▲ FARE



Fare for elektrisk stød og brand. Sørg for, at den medfølgende ledning og ikke-låsende stik opfylder alle gældende, nationale regler.


- Kontrollér, at der er monteret en afbryder med tilstrækkelig elektrisk kapacitet på strømkablet.
- Sørg for, at der er monteret en kredsløbsafbryder eller en nødstopafbryder i nærheden af analysatoren, så analysatoren om nødvendigt straks kan frakobles strømforsyningen.
- Tilslut udstyr i overensstemmelse med de lokale, regionale eller nationale regler for elektricitet.
- Før den medfølgende netledning gennem kabelforskrningen på siden af analysatoren.
- Spænd kabelforskrningen, så den holder strømkablet fast og overholder kabinetets miljøklassificering.

Slut analysatoren til vekselstrøm med den medfølgende AC-netledning. Se **Tabel 2** på side 162 og **Figur 11** på side 468.

## BEMÆRKNING

Tænd ikke for strømafbryderen. Færdiggør alle de elektriske forbindelser og loddeforbindelserne inden opstart, ellers kan analysatoren blive beskadiget.

**Tabel 2 Oplysninger om ledningsføring – AC-strøm**

Terminal	Beskrivelse	Kabelfarve-Nordamerika og Canada	Farve på kabel-EU
L	Strømførende/ledning (L)	Sort (1)	Brun
N	Neutral (N)	Hvid (2)	Blå
	Beskyttende jordstik (PE)	Grøn med gul stribe	Grøn med gul stribe

## 5.5 Rørarbejde

### 5.5.1 Retningslinjer for prøveslange

#### ▲ FORSIGTIG



Brandfare. Dette produkt er ikke designet til brug sammen med brændbare prøver.

Vælg et godt, repræsentativt prøvested for den bedste instrumentydelse. Prøven skal være repræsentativ for hele systemet.

- Sørg for, at prøveflowet er højere end flowet til apparatet.
- Sørg for, at prøveslangen har et atmosfærisk tryk, hvis analysatoren bruger en peristaltisk pumpe til at flytte prøven over i analysebeholderen.
- Sørg for, at prøveslangen indsamler en prøve fra en lille overløbsbeholder nær analysatoren.
- Brug det medfølgende prøverør. Foretag ikke ændringer af prøverørets længde.

Prøven i overløbsbeholderen skal opdateres kontinuerligt. Hvis mængden af tørstoffer i prøven er for høj, anbefales også prøvefiltrering.

### 5.5.2 Retningslinjer for drænslange

#### ▲ ADVARSEL



Brandfare. Brugeren er ansvarlig for at sikre, at der er taget tilstrækkelige forholdsregler, når udstyret bruges sammen med metoder, der anvender brændbare væsker. Sørg for at overholde de korrekte brugerforanstaltninger og sikkerhedsprotokoller. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, kontrol af spild og lækage, korrekt ventilation, ingen ikke-overvåget brug, og at instrumentet aldrig efterlades uden overvågning, mens det er tilsluttet strøm.

#### ▲ FORSIGTIG



Fare for eksponering for kemiske stoffer. Bortskaf kemikalier og spildevand i overensstemmelse med lokale, regionale og nationale bestemmelser.

## BEMÆRKNING

Tiislut ikke drænledningerne til andre ledninger, da der ellers kan opstå modtryk og ske skade på analysatoren. Sørg for at drænledningerne er åbne mod udluftning.

## BEMÆRKNING

For at forebygge at der opstår modtryk og sker skade på analysatoren, skal du sørge for at analysatoren ligger højere end lokalets dræn, og at drænledningen har en konstant nedadgående hældning. Monter drænledningerne med en hældningsgrad på 2,54 cm (1 tomme) eller mere for hver 0,3 m (1 fod) slange.

Analysatoren bruger drænledningen til at frigøre prøven og reagenserne efter analysen. Korrekt installation af drænledningerne er vigtig for at sikre, at al væske er fjernet fra instrumentet. Forkert installation kan få væske til at løbe tilbage til instrumentet og forårsage skade. Et gulv- eller vask afløb er tilstrækkeligt til drænledningen. Den anbefalede udvendige diameter på drænledningen er 32 mm. Se [Figur 12](#) på side 469.

- Sørg for, at drænslangene er så korte som muligt.
- Sørg for, at drænet sidder lavere end analysatoren.
- Sørg for, at drænslangene har et konstant fald.
- Sørg for, at drænslangene ikke har skarpe bøjninger og ikke er klemte.
- Sørg for, at drænslangene er åbne for luft og har nul tryk.
- Sørg for, at drænslangene er lukket for omgivelserne i installationsrummet.
- Undlad at blokere eller nedsænke drænledningen.

En vandforbindelse i nærheden af analysatoren anbefales også, så vask afløb og drænslangere regelmæssigt skylles med rent vand for at undgå blokering som følge af krystallisering.

Se metode- og reagensdatabladet for den relevante EZ-seriemodellen for at få flere oplysninger om reagenser, der bruges i analysatoren. Hvis analysatoren anvender brændbare reagenser, skal du sørge for at overholde de følgende sikkerhedsforanstaltninger:

- Tøm ikke afløbsledningen i gulvafløbet.
- Bortskaf affald i overensstemmelse med lokale, regionale og nationale miljøbestemmelser.

### 5.5.3 Retningslinjer for udluftningslange

#### ▲ ADVARSEL



Brandfare. Brugeren er ansvarlig for at sikre, at der er taget tilstrækkelige forholdsregler, når udstyret bruges sammen med metoder, der anvender brændbare væsker. Sørg for at overholde de korrekte brugerforanstaltninger og sikkerhedsprotokoller. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, kontrol af spild og lækage, korrekt ventilation, ingen ikke-overvåget brug, og at instrumentet aldrig efterlades uden overvågning, mens det er tilsluttet strøm.

#### ▲ FORSIGTIG



Fare for eksponering for kemiske stoffer. Bortskaf kemikalier og spildevand i overensstemmelse med lokale, regionale og nationale bestemmelser.

## BEMÆRKNING

Tilslut ikke udluftningsslangen (port til udstødningssgas) til andre ledninger, da der ellers kan opstå modtryk og ske skade på analysatoren. Sørg for, at udluftningsslangen er åben for luft på bygningens yderside.

## BEMÆRKNING

For at forebygge at der opstår modtryk og sker skade på analysatoren, skal du sørge for at analysatoren ligger højere end udluftningsslangerne, og at disse har en konstant nedadgående hældning. Monter udluftningsslangerne med en hældningsgrad på 2,54 cm (1 tomme) eller mere for hver 0,3 m (1 fod) slange.

Analysatoren bruger udluftningsledningen til at holde analysebeholderen på atmosfærisk tryk. Korrekt montering af udluftningsledningen er vigtig for at sikre, at der ikke trænger væske ind i analysebeholderen fra udluftningsledningen under pumpedrift. Forkert installation kan få gas til at sive tilbage til instrumentet og forårsage skade. Den anbefalede udvendige diameter for skærebordets rør på udluftningsslangen er 32 mm. Se [Figur 12](#) på side 469.

- Sørg for, at udluftningsslangen er så kort som muligt.
- Sørg for, at udluftningsslangen har et konstant fald.

- Sørg for, at udluftningsslangen ikke har skarpe bøjninger og ikke er klemt.
- Sørg for, at udluftningsslangen er lukket for omgivelserne i installationsrummet og er ved nul tryk.
- Sørg for, at udluftningsslangen altid er placeret højere end afløbet.
- Undlad at blokere eller nedsænke udluftningsslangen.

Hvis analysatoren anvender brændbare reagenser, skal du sørge for at overholde de følgende sikkerhedsforanstaltninger:

- Tøm ikke udluftningsslangen i gulv afløbet.
- Bortskaf affald i overensstemmelse med lokale, regionale og nationale miljøbestemmelser.

## 5.5.4 Afprop analysatoren til komponenttesten


### ▲ FORSIGTIG




Brandfare. Dette produkt er ikke beregnet til brug sammen med brændbare væsker.

Før analysatoren med alle reagenserne tages i brug, skal der udføres en komponenttest med demineraliseret vand. Se de illustrerede trin og [Udfør komponenttestene](#) på side 168.

1. Monter de fire klemventilslinger, som vist i det illustrerede trin 1, på følgende måde.
  - a. Tryk på den sorte knap, og tryk derefter slangen ind i ventilen.
  - b. Slip knappen, når slangen er monteret korrekt.
2. Sørg for, at aftapningsslangen er korrekt monteret i prøvebeholderen. Se det efterfølgende illustrerede trin 2.
3. Sørg for, at slangen til rådnetanken er monteret korrekt i rådnetankbeholderen. Se det efterfølgende illustrerede trin 3.
4. Stik alle analysatorens væskeslanger ned i en stor flaske med demineraliseret vand for at udføre en test a komponenterne. Se det efterfølgende illustrerede trin 3. Slangerne er monteret fra fabrikken.



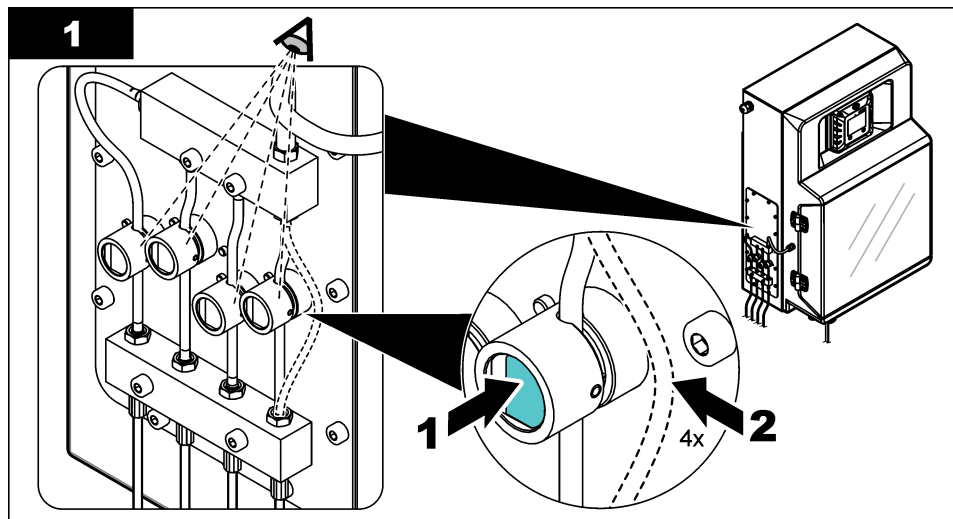


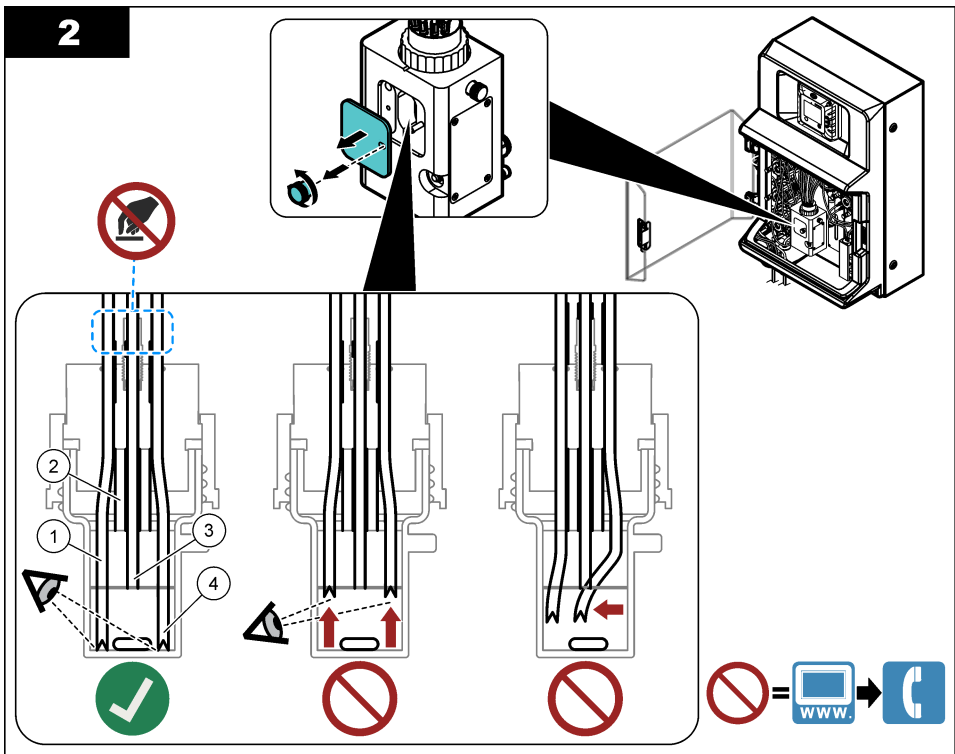**2**

DA

1 Drænslange	3 Prøveslange
2 Reagens- og udluftningsslanger (øverste slanger)	4 Slange til rådnetank


3

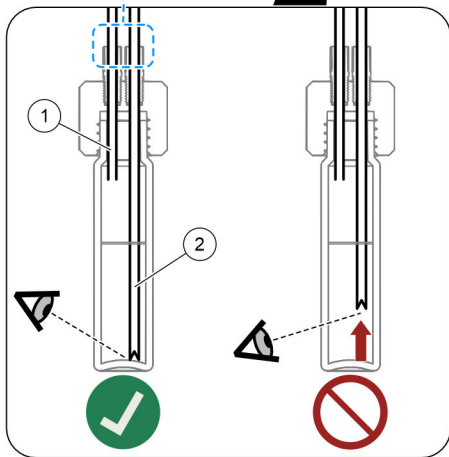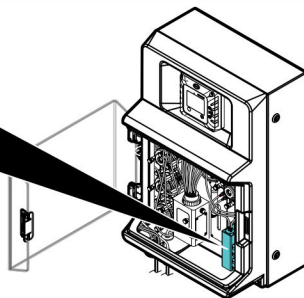

1 Udluftningsslange

2 Slange til rådnetank

4

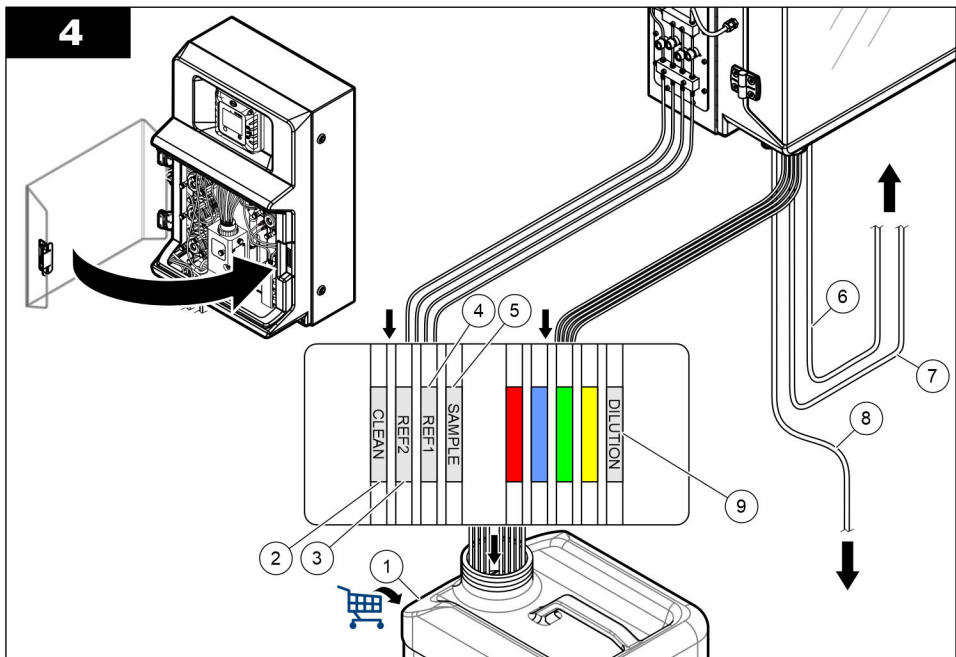

DA

1 Afioniseret vand	4 Slange til Reference 1-opløsning (REF1)	7 Ventil til rådnetank
2 Renseopløsningsslange	5 Prøveindløbslange	8 Drænslange
3 Slange til Reference 2-opløsning (REF2)	6 Udluftningslange	9 Mikropumpeslanger til fortynding og reagenser

## Sektion 6 Opstart

### 6.1 Første ibrugtagning

**BEMÆRK:** Sørg for, at montering, slanger og elektriske installationer er fuldført helt inden ibrugtagning. Se [Installation](#) på side 158.

Når analysatoren tændes første gang, hjælper en opstartsassistent med de første trin til at fuldføre opsætningen. Fuldfør alle de efterfølgende trin for at sikre, at analysatoren fungerer korrekt.

**BEMÆRK:** Sørg for at bruge de rigtige reagenser til det valgte måleområde. Du kan finde flere oplysninger i onlineversionen af den udvidede brugervejledning.

1. Åbn analysatordøren. Se [Åbn analysatordøren](#) på side 159.
2. Sæt tænd/sluk-knappen i positionen ON. Se [Figur 9](#) på side 460.
3. Luk analysatordøren med den medfølgende nøgle.
4. Vent, indtil initialiseringsproceduren er udført.
5. Besvar meddelelserne på displayet for at vælge sprog, tidszone, dato og klokkeslæt.  
Se i dokumentationen til SC4500-kontrolenheden, hvordan man konfigurerer kontrolenhedens øvrige indstillinger.
6. Tryk på displayet for at få vist **EZ2700sc**-menuen.
7. Vælg **Enhedsmenu** for at starte opstartsassistenten.  
Velkomstkærm-billedet vises.
8. Fuldfør de trin, der vises på displayet, for at vælge det pågældende måleområde. Tryk på **OK**.

9. Hvis der er monteret en filtreringsenhed, vælges **On**. Hvis ikke, vælges **Off**.
10. Vælg antal kanaler på analysatoren. Tryk på **OK**.
11. Hvis konfigurationen, der vises på oversigtssiden, er korrekt, skal du trykke på **OK**. Hovedmenuen på **EZ2700sc** vises.
12. Fortsæt med komponenttesten. Se [Udfør komponenttestene](#) på side 168.

## 6.2 Udfør komponenttestene

### ▲ ADVARSEL



Fare for klemning. Bevægelige dele kan klemme og medføre personskade. Undgå at berøre bevægelige dele.

Udfør komponenttestene, inden analysatoren tages i brug. Brug menuen **Vedligeholdelse** til at starte analysatorens forskellige funktioner og undersøge komponentdriften.

#### Forudsætninger:

- Hvis analysatoren er i driftstilstand, vælges **Vedligeholdelse > Start vedligeholdelsestilstand**.
- Sørg for, at prøve-, reagens- og opløsningssslangerne er i beholderen med demineraliseret vand. Se [Afprop analysatoren til komponenttesten](#) på side 164.

#### 6.2.1 Efterse omrøreren

1. Fjern lysskærmen fra fotometerenheden. Se [Figur 13](#) på side 472.
2. Sørg for at omrøreren er i bunden af prøvebeholderen.  
***BEMÆRK:** Undersøg omrøreren under primingproceduren for at sikre, at omrøreren roterer korrekt. Primingproceduren startes om [Efterse pumperne og klemventilerne](#) på side 168.*
3. Monter lysskærmen på fotometeret.

#### 6.2.2 Efterse pumperne og klemventilerne

1. Efterse pumpernes og klemventilernes funktion for at sikre, at der ikke er lækager.
2. Sørg for, at analysebeholderen bliver fyldt med demineraliseret vand. Se [Figur 14](#) på side 473.
3. Sørg for, at demineraliseret vand løber ud i afløbsslangerne.
4. Vælg **Vedligeholdelse > Start priming**, og klargør alle væskerne separat.

Hvis der opstår en lækage, skal du undersøge alle tilslutningerne, og du kan samtidig finde flere oplysninger i onlineversionen af den udvidede brugervejledning.

- a. Vælg **Klargør reference 1**, og tryk på **OK**.
- b. Vælg **Klargør reference 2**, og tryk på **OK**.
- c. Vælg **Klargør renseopløsning**, og tryk på **OK**.
- d. Vælg **Klargør skylning**, og tryk på **OK**.
- e. Vælg **Klargør dispenser**, og tryk på **OK**.
- f. Vælg **Klargør kanal > Klargør alle kanaler**, og tryk på **OK**.  
Hver klargøringsprocedure stopper automatisk, når proceduren er fuldført.

#### 6.2.3 Efterse mikropumperne

Undersøg, om mikropumperne lækker eller indeholder luftbobler.

1. Fjern lysskærmen fra fotometeret.
2. Vælg **Vedligeholdelse > Start priming > Klargør alle reagenser**.

3. Sørg for, at det demineraliserede vand kommer ind i mikropumpen gennem hver af mikropumpens (reagensens) slanger. Derefter ind i analysebeholderen kontinuerligt uden luftbobler. Se [Figur 15](#) på side 475.
4. Hvis mikropumperne ikke fungerer korrekt (bobler i slangerne), skal du bruge sprøjteproceduren til at presse demineraliseret vand ind i den pågældende slange for at fjerne boblerne. Se [Figur 16](#) på side 476.
5. Monter lysskærmen på fotometeret.

### 6.2.4 Udfør kontrol af fotometer

Sørg for, at ydersiden af analysebeholderen er ren, før kontrol af fotometeret, så kontrollen kan udføres korrekt. Hvis du vil rengøre analysatorkomponenterne, kan du få flere oplysninger i den udvidede brugervejledning, som er tilgængelig online.

1. Tryk på hovedmenuikonet, og vælg derefter **Enheder**.
2. Vælg **EZ2700sc**.
3. Rul ned til bunden af skærmbilledet, og vælg **Enhedsmenu**.
4. Vælg **Vedligeholdelse > Kontrol af fotometer**
5. Tryk på **OK** for at starte målingen.  
Når den mørke kalibrering er fuldført, vises resultatet på displayet.
6. Tryk på **OK** for at fortsætte.
7. Sørg for, at "REF1"-slangen er sluttet til en beholder, der er fyldt med demineraliseret vand. Sørg for, at lysskærmen er monteret. Se [Figur 18](#) på side 478.
8. Tryk på **OK**.  
Vent, indtil analysebeholderen er fyldt.
9. Brug en skruetrækker til at justere sensorudgangens spænding til 9 V. Se [Figur 17](#) på side 476.
10. Vent, indtil værdien 9 V vises på skærmen. Tryk derefter på **OK**.
11. Tryk på **OK** for at fortsætte.

### 6.3 Udfør en signaltest af indgang

Udfør en test af de digitale indgange, før analysatoren tages i brug.

**Forudsætninger:** Slut de digitale indgange til en ekstern potentialfri kontakt (24 V DC).

Udfør en test af digitale indgange og analoge udgange på følgende måde:

1. Tryk på hovedmenuikonet, og vælg derefter **Enheder**.
2. Vælg **EZ2700sc**.
3. Rul ned til bunden af skærmbilledet, og vælg **Enhedsmenu**.
4. Vælg **Diagnosticering > Signals**.  
Signaler ved de digitale indgange vises.
5. Sammenlign de digitale indganges status på displayet med de spændinger, der sendes til de digitale indgange (24 V = On, 0 V = Off).

### 6.4 Udfør en signaltest af udgang

Udfør en test af de analoge udgange, før analysatoren tages i brug.

**Forudsætninger:** Konfigurer de analoge udgange (AO1–AO8, P101) for at vælge den kanalmåling, der repræsenteres af hver analog udgang. Du kan finde flere oplysninger i onlineversionen af den udvidede brugervejledning.

Udfør en signaltest af analog udgang på følgende måde:

1. Tryk på hovedmenuikonet.
2. Vælg **Udgange > mA udgange AOC > Test/vedligeholdelse**.

Indstilling	Beskrivelse
<b>Funktionstest</b>	Udfør en test af udgangene på det valgte modul.
<b>Status for udgang</b>	Viser tilstanden for udgangene på det valgte modul.

3. Brug et multimeter til at måle mA-værdien ved hver analog udgang.
4. Sammenlign den målte mA-værdi ved de analoge udgange med de forventede mA-værdier.

## 6.5 Angiv kanalsekvensen




Vælg den sekvens, hvormed kanalerne måles, antal gange hver kanal måles og ventetiden, før en kanal måles. Indtast maks. 16 linjer med hver maks. 16 cyklusser.

1. Tryk på hovedmenuikonet, og vælg derefter **Enheder**.
2. Vælg **EZ2700sc**.
3. Rul ned til bunden af skærbilledet, og vælg **Enhedsmenu**.
4. Hvis analysatoren er i driftstilstand, vælges **Vedligeholdelse > Start vedligeholdelsestilstand**. Vent, indtil analysatoren er i vedligeholdelsestilstand.
5. Vælg **Konfiguration > Opsætning af kanalsekvens**.
6. Brug pilene på sidebjælken til at vælge en position (nummer i sekvensen), og tryk derefter på **OK** for at konfigurere den pågældende position.
7. Vælg en funktion.

Indstilling	Beskrivelse
<b>Vælg</b>	Vælger den pågældende kanal eller ventetid.
<b>Antal målinger</b>	Angiver antal målinger for en kanal.
<b>Ventetid</b>	Angiver ventetiden for den valgte kanal.

8. Tryk på **OK** for at gemme ændringerne.

## 6.6 Omrør opløsningerne og prøven

▲ FORSIGTIG	
	Fare for eksponering for kemiske stoffer. Overhold laboratoriets sikkerhedsprocedurer, og bær alt det personlige beskyttelsesudstyr, der er nødvendigt for at beskytte dig mod de kemikalier, du bruger. Se de aktuelle sikkerhedsdataark (MSDS/SDS) for sikkerhedsprotokoller.
▲ FORSIGTIG	
	Fare for eksponering for kemiske stoffer. Bortskaf kemikalier og spildevand i overensstemmelse med lokale, regionale og nationale bestemmelser.
▲ FORSIGTIG	
	Brandfare. Dette produkt er ikke beregnet til brug sammen med brændbare væsker.

Reagensbeholderne følger med analysatoren. Se [Figur 18](#) på side 478. Beholderne til Reference 1-opløsning, Reference 2-opløsning og afioniseret vand leveres af brugeren. Yderligere beholdere kan købes hos producenten.

Monter beholderne

- så tæt på analysatoren som muligt
- 1 meter under bunden af analysatoren

Se [Figur 18](#) på side 478 vedrørende beholdermontering.

Reagenserne og opløsningerne leveres af brugeren. Brug kun reagenser leveret af en certificeret virksomhed, eller brug producentens dedikerede reagenser. Som et alternativ kan reagenser klargøres af brugeren. Følg vejledningen i metode- og reagensdatabladet for den pågældende model på producentens websted.

Slangerne er monteret fra fabrikken. Læs etiketten på hver slange for at finde frem til den korrekte rørforbindelse. Se det gældende metode- og reagensdatablad for den model, der findes på producentens websted, vedrørende korrekte reagenser, opløsninger og standarder.

1. Når komponenttestene er udført, monteres slangerne "CLEAN" (rensopløsning) "REF1" (Reference 1-opløsning) og "REF2" (Reference 2-opløsning) i de tilhørende beholdere. Se [Figur 18](#) på side 478.
2. Monter hver farvekodet reagensslange i reagensbeholderen med den samme farve på mærkatens.
3. Sæt prøvekilden (eller Moduplex-panelets eller filterpanelets prøveudløb) i analysatorens prøveindløbslange. Se [Figur 18](#) på side 478.
4. Tryk på hovedmenuikonet, og vælg derefter **Enheder**.
5. Vælg **EZ2700sc**.
6. Rul ned til bunden af skærbilledet, og vælg **Enhedsmenu**.
7. Vælg **Vedligeholdelse > Start priming > Klargør alt**.

## 6.7 Foretag en validering før første opstart.

Foretag en validering for at sikre, at målingerne ligger inden for toleranceområdet. Du kan finde flere oplysninger i onlineversionen af den udvidede brugervejledning.

1. Tryk på hovedmenuikonet, og vælg derefter **Enheder**.
2. Vælg **EZ2700sc**.
3. Rul ned til bunden af skærbilledet, og vælg **Enhedsmenu**.
4. Vælg **Kalibrering > Validering > Start validering** for at starte en validering.  
Valideringen måler det demineraliserede vand i Reference 2-flasken.
5. Vælg en mulighed for at få vist resultaterne:
  - **Kalibrering > Validering > Valideringsoversigt**
  - **Diagnosticering > Historiske data > Validering**

## 6.8 Starter analysatoren

Sådan startes analysatoren:

1. Tryk på hovedmenuikonet, og vælg derefter **Enheder**.
2. Vælg **EZ2700sc**.
3. Rul ned til bunden af skærbilledet, og vælg **Enhedsmenu**.
4. Vælg **Vedligeholdelse > Start driftstilstand**.

## Spis treści

- |   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| 1 | <a href="#">Dodatkowe informacje</a> na stronie 172     | 4 | <a href="#">Ogólne informacje</a> na stronie 174 |
| 2 | <a href="#">Charakterystyka produktu</a> na stronie 172 | 5 | <a href="#">Instalacja</a> na stronie 176        |
| 3 | <a href="#">Dane techniczne</a> na stronie 173          | 6 | <a href="#">Rozruch</a> na stronie 186           |

## Rozdział 1 Dodatkowe informacje

Podstawowa instrukcja użytkownika zawiera wystarczające informacje do uruchomienia. Rozszerzona instrukcja użytkownika dostępna jest online i zawiera dodatkowe informacje.

### ⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO



Wiele zagrożeń! Więcej informacji przedstawiono w poszczególnych sekcjach rozszerzonej instrukcji użytkownika pokazanych poniżej.

- Interfejs użytkownika i nawigacja
- Obsługa
- Konserwacja
- Rozwiązywanie problemów
- Listy części zamiennych

Zeskanuj poniższe kody QR, aby przejść do rozszerzonej instrukcji obsługi.



Języki europejskie



Języki amerykańskie i azjatyckie

## Rozdział 2 Charakterystyka produktu

Hach EZ2700sc to analizator online, który mierzy jeden parametr w próbkach wody z zastosowań przemysłowych i środowiskowych. Patrz [Rysunek 1](#) na stronie 439, [Rysunek 2](#) na stronie 443 i [Rysunek 3](#) na stronie 447.

Jest to analizator kolorymetryczny online do ogólnej analizy wody (np. zawartość azotanów, fosforanów). Analizator jest wyposażony w funkcje zdalnego startu, automatycznej walidacji, automatycznej kalibracji, automatycznego czyszczenia i Modbus.

Próbka wody wpływa do analizatora przez rurkę próbki. Pompy, zawory i strzykawki w analizatorze doprowadzają próbkę i odczynniki do komórki pomiarowej w panelu analizatora. Gdy procesy w naczyniu analitycznym zostaną zakończone, analizator odprowadza próbkę przez rurkę spustową. Wyniki analizy są pokazywane na wyświetlaczu przetwornika SC4500. Przetwornik SC4500 zapisuje dane analizatora (w dzienniku danych, dzienniku zdarzeń, dzienniku ustawień i dzienniku serwisowym). Przetwornik SC4500 służy do obsługi i konfiguracji analizatora.

W celu zwiększenia liczby strumieni próbek (kanałów), w których analizator może wykonywać pomiary (2, 4 lub 8), należy wraz z analizatorem nabyć panel wielostrumieniowy Moduplex.

W celu umożliwienia wstępnego kondycjonowania próbek (filtracja, osiadanie) należy wraz z analizatorem nabyć panel filtracyjny EZ9010, EZ9020, EZ9150, EZ9200 lub EZ9250.

## Rozdział 3 Dane techniczne

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Dane techniczne	Informacje szczegółowe
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	460 x 688 x 340 mm
Obudowa	IP44; ABS, PMMA i stal powlekana
Ekran	IP66, kolorowy wyświetlacz 3,5 cala TFT z pojemnościowym panelem dotykowym
Masa	40 kg
Wymagania dotyczące zasilania	100 - 240 V AC $\pm$ 10%, 50/60 Hz
Pobór mocy	Maksymalnie 240 VA
Wysokość n.p.m.	Maks. 2000 m
Kategoria przepięcia	II
Warunki środowiskowe	Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach
Stopień zanieczyszczenia	2
Temperatura podczas pracy	Od 10 do 30°C; od 5 do 95% wilgotności względnej, bez kondensacji, bez korozji
Temperatura podczas przechowywania	Od -20 do 60°C, maks. 95% wilgotności względnej, bez kondensacji
Wloty próbek	Jeden
Ciśnienie próbki	Przez zewnętrzne naczynie przelewowe (otwarty na ciśnienie atmosferyczne)
Natężenie przepływu próbki	Od 100 do 300 mL/min
Temperatura próbki	Od 10 do 30°C
Jakość próbki	Cząstki stałe < 100 $\mu$ m, maks. < 0,1 g/L Mętność < 50 NTU
Przedmuchiwanie powietrzem w środowiskach korozyjnych	0,2 bar (20 kPa lub 3 psi); suche i czyste powietrze
Odpływ	Pod ciśnieniem atmosferycznym, wentylowany, min. $\varnothing$ 32 mm
Uziemienie	Suchy i czysty pręt uziemiający o niskiej impedancji (< 1 $\Omega$ ) z przewodem uziemiającym > 2,5 mm <sup>2</sup> (13 AWG)
Wyjścia analogowe	Maks. osiem wyjść analogowych 0 - 20 mA (lub 4 - 20 mA) <b>Uwaga:</b> Wyjścia analogowe zapewniają zasilanie pętli. Nie można dostarczyć zasilania do styków systemu SCADA lub PLC.
Wejścia cyfrowe	Siedem wejść cyfrowych: dwa wejścia cyfrowe do zdalnego startu. Pozostałe wejścia cyfrowe będą wykorzystywane w przyszłości.
Wyjścia cyfrowe	Cztery zasilane wyjścia cyfrowe do obsługi zaworów i pomp panelu EZ9150; osiem zasilanych wyjść cyfrowych do obsługi zaworów panelu Moduplex; 24 V DC, 500 mA.
Przełączniki	Pięć styków bezpotencjałowych (FCT), obciążenie maksymalne 24 V DC, 0,5 A (obciążenie rezystancyjne)

PL

Dane techniczne	Informacje szczegółowe
Połączenia Ethernet	Złącze Claros Ethernet i złącze Modbus TCP/IP Ethernet; wersja LAN; 10/100 Mbps lub Profinet lub Ethernet IP
Komunikacja RS485	Profibus DP lub Modbus RTU
Certyfikaty	CE, ETL zgodnie z normami bezpieczeństwa UL i CSA, UKCA
Gwarancja	1 rok (UE: 2 lata)

## Rozdział 4 Ogólne informacje

W żadnej sytuacji producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek nieprawidłowego używania produktu lub nieprzestrzegania instrukcji podanych w podręczniku. Producent zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszej instrukcji obsługi i w produkcie, której dotyczy w dowolnym momencie, bez powiadomienia lub zobowiązania. Na stronie internetowej producenta można znaleźć poprawione wydania.

### 4.1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego stosowania albo użytkowania tego produktu, w tym, bez ograniczeń za szkody bezpośrednio, przypadkowe i wtórne, oraz wyklucza odpowiedzialność za takie szkody w pełnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Użytkownik jest jedynie odpowiedzialny za zidentyfikowanie najistotniejszych zagrożeń związanych z obsługą i wprowadzeniem odpowiednich mechanizmów ochronnych podczas ewentualnej awarii sprzętu.

Prosimy przeczytać całą niniejszą instrukcję obsługi przed rozpakowaniem, włączeniem i rozpoczęciem użytkowania urządzenia. Należy zwrócić uwagę na wszystkie informacje dotyczące niebezpieczeństwa i kroków zapobiegawczych. Niezastosowanie się do tego może spowodować poważne obrażenia obsługującego lub uszkodzenia urządzenia.

Jeśli urządzenie jest używane w sposób, który nie został określony przez producenta, ochrona zapewniana przez urządzenie może zostać osłabiona. Nie używać, ani nie instalować tego sprzętu w sposób inny niż określony w tej instrukcji.

#### 4.1.1 Korzystanie z informacji o zagrożeniach

#### ⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Wskazuje potencjalnie lub bezpośrednio niebezpieczną sytuację, która — jeśli się jej nie zapobiegnie — doprowadzi do śmierci lub poważnych obrażeń.

#### ⚠ OSTRZEŻENIE

Wskazuje na potencjalną lub bezpośrednio niebezpieczną sytuację, która, jeżeli się jej nie uniknie, może doprowadzić do śmierci lub ciężkich obrażeń.

#### ⚠ UWAGA

Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może doprowadzić do mniejszych lub umiarkowanych obrażeń.

#### POWIADOMIENIE







Wskazuje sytuację, która — jeśli się jej nie zapobiegnie — może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia. Informacja, która wymaga specjalnego podkreślenia.

#### 4.1.2 Etykiety ostrzegawcze

Przeczytaj wszystkie etykiety dołączone do urządzenia. Nieprzestrzeganie zawartych na nich ostrzeżeń może doprowadzić do obrażeń ciała i/lub uszkodzenia urządzenia. Symbol umieszczony


<sup>2</sup> Informacje dotyczące konfiguracji Ethernet i konfiguracji Modbus zamieszczono w dokumentacji przetwornika SC4500.

na urządzeniu jest zamieszczony w podręczniku i opatrzony informacją o należytych środkach ostrożności.

	Ten symbol ostrzega o niebezpieczeństwie. Aby uniknąć obrażeń ciała, należy przestrzegać wszystkich instrukcji, którym towarzyszy ten symbol. Jeśli ten symbol jest umieszczony na urządzeniu, należy zapoznać się z informacjami bezpieczeństwa użytkowania zamieszczonymi w instrukcji obsługi urządzenia.
	Ten symbol ostrzega o niebezpieczeństwie natury chemicznej i informuje, że jedynie osoby odpowiednio wykwalifikowane i przeszkolone do pracy z substancjami chemicznymi powinny mieć styczność z takimi substancjami i wykonywać prace konserwacyjne przy systemach doprowadzania substancji chemicznych do urządzenia.
	Ten symbol wskazuje niebezpieczeństwo szoku elektrycznego i/lub porażenia prądem elektrycznym.
	Ten symbol informuje o obecności urządzeń wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne (ESD) i oznacza, że należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić urządzeń.
	Ten symbol informuje o konieczności uziemienia oznakowanego elementu. Jeśli przyrząd nie jest wyposażony we wtyczkę uziemiającą na przewodzie, należy utworzyć ochronne uziemienie do ochronnej końcówki przewodnika.
	Urządzeń elektrycznych oznaczonych tym symbolem nie wolno wyrzucać do europejskich publicznych systemów utylizacji odpadów. Wyeksploatowane urządzenia należy zwrócić do producenta w celu ich utylizacji. Producent ma obowiązek przyjąć je bez pobierania dodatkowych opłat.

PL

### 4.1.3 Bezpieczeństwo chemiczne i biologiczne

<b>⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO</b>	
	Zagrożenia chemiczne lub biologiczne. Jeżeli to urządzenie jest wykorzystywane do monitorowania systemów uzdatniania lub dozowania substancji chemicznych, których działanie definiują przepisy prawa oraz wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa publicznego czy też normy dotyczące wytwarzania lub przetwarzania żywności lub napojów, to na użytkownika spoczywa odpowiedzialność za znajomość i przestrzeganie tychże przepisów, regulacji i norm oraz stosowanie właściwych urządzeń pozwalających działać zgodnie z przepisami w razie nieprawidłowego działania niniejszego urządzenia.

## 4.2 Ikony użyte na ilustracjach

			
Części dostarczone przez producenta	Części dostarczone przez użytkownika	Obserwuj	Wykonaj czynności w odwrotnej kolejności

				
Wykonuj w dwie osoby	Słuchaj	Używaj tylko palców	Nie używaj narzędzi	Nie dotykać

### 4.3 Przeznaczenie

Analizatory serii EZ firmy Hach są przeznaczone do stałego pomiaru parametrów jakości wody w próbkach pochodzących z zastosowań przemysłowych i środowiskowych. Analizatory serii EZ firmy Hach nie uzdatniają ani nie modyfikują wody i nie są służą do przeprowadzania procedur kontrolnych.

### 4.4 Elementy produktu

Upewnij się, że zostały dostarczone wszystkie elementy. Patrz [Rysunek 4](#) na stronie 452. W przypadku braku lub uszkodzenia jakiegokolwiek elementu niezwłocznie skontaktuj się z producentem lub z jego przedstawicielem handlowym.

## Rozdział 5 Instalacja

### ▲ NIEBEZPIECZEŃSTWO



Wiele zagrożeń. Tylko wykwalifikowany personel powinien przeprowadzać prace opisane w tym rozdziale niniejszego dokumentu.

### 5.1 Wskazówki dotyczące instalacji

#### ▲ OSTRZEŻENIE



Niebezpieczeństwo pożaru. Użytkownik musi zadbać o zastosowanie odpowiednich środków ostrożności w przypadku użytkowania sprzętu z metodami wykorzystującymi łatwopalne płyny. Należy przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności i przestrzegać stosownych procedur bezpieczeństwa. Są to m.in. procedury postępowania w przypadku wycieków, stosowania odpowiedniej wentylacji, zakazu użytkowania bez nadzoru oraz pozostawiania włączonego urządzenia bez nadzoru.

#### ▲ UWAGA



Narażenie na działanie substancji chemicznych. Stosować się do procedur bezpieczeństwa w laboratoriach i zakładach sprzęt ochrony osobistej, odpowiedni dla używanych substancji chemicznych. Protokoły warunków bezpieczeństwa można znaleźć w aktualnych kartach charakterystyki (MSDS/SDS) materiałów.

#### ▲ UWAGA



Narażenie na działanie substancji chemicznych. Usuwać substancje chemiczne i odpady zgodnie z przepisami lokalnymi, regionalnymi i państwowymi.

- Zainstalować analizator w pomieszczeniu, w środowisku, w którym nie występują zagrożenia.
- Analizator należy zainstalować w miejscu zabezpieczonym przed działaniem płynów żrących.
- Zainstalować analizator w czystym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu z regulacją temperatury.
- Zainstalować analizator możliwie jak najbliżej punktu poboru próbek.
- Nie instalować analizatora w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym ani w pobliżu źródeł ciepła.
- Zapewnić wystarczająco dużo miejsca do wykonania połączeń hydraulicznych i elektrycznych.
- Pozostawić wystarczająco dużo miejsca z przodu analizatora, aby umożliwić otwarcie jego drzwiczek. Patrz [Rozmiary analizatora](#) na stronie 177.

- Upewnić się, że warunki otoczenia mieszczą się w granicach parametrów roboczych. Patrz [Dane techniczne](#) na stronie 173.

Analizator nie jest przeznaczony do użytku z próbkami łatwopalnymi, jednak niektóre analizatory EZ wykorzystują odczynniki łatwopalne. W celu uzyskania dodatkowych informacji o odczynnikach stosowanych w analizatorze należy zapoznać się z arkuszem metod i odczynników odpowiedniej serii modeli EZ. Jeśli analizator wykorzystuje odczynniki łatwopalne, należy przestrzegać następujących środków ostrożności:




- Analizator nie może znajdować się w pobliżu źródeł ciepła, iskier lub otwartego ognia.
- W pobliżu analizatora nie wolno jeść, pić ani palić tytoniu.
- Należy stosować miejscowy układ wentylacji wywiewnej.
- Należy korzystać urządzeń i systemów oświetleniowych w wykonaniu przeciwwiskrowym i przeciwwybuchowym.
- Należy zapobiegać powstawaniu wyładowań elektrostatycznych. Patrz [Uwagi dotyczące wyładowań elektrostatycznych \(ESD\)](#) na stronie 178.
- Przed użyciem należy dokładnie wyczyścić i osuszyć urządzenie.
- Myć ręce przed przerwami oraz po zakończeniu pracy.
- Zdjąć skażoną odzież. Wyprać odzież przed ponownym użyciem.
- Z płynami należy obchodzić się zgodnie z wymaganiami lokalnych agencji regulacyjnych dotyczącymi dopuszczalnych wartości granicznych stężeń.

## 5.2 Rozmiary analizatora

W celu uzyskania rozmiarów analizatora patrz [Rysunek 5](#) na stronie 454.

## 5.3 Instalacja mechaniczna

### 5.3.1 Montaż urządzenia na ścianie

<b>⚠ OSTRZEŻENIE</b>	
	Niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała. Upewnić się, że montaż na ścianie jest w stanie unieść ciężar 4 razy większy od wagi urządzenia.
<b>⚠ OSTRZEŻENIE</b>	
	Niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała. Urządzenia lub jego komponenty są ciężkie. Korzystać z pomocy przy instalacji lub przenoszeniu.
<b>⚠ OSTRZEŻENIE</b>	
	Niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała. Przedmiot jest ciężki. Zadbać o prawidłowe zamocowanie przyrządu do ściany, stołu lub podłogi, aby zapewnić bezpieczeństwo pracy.

Przy użyciu dostarczonych uchwytów montażowych zamocuj urządzenie pionowo i wyrównaj względem płaskiej pionowej powierzchni. Patrz [Rysunek 6](#) na stronie 456.

Urządzenie należy zainstalować w takim miejscu i w taki sposób, aby użytkownik mógł łatwo odłączyć je od źródła zasilania.

Poniżej analizatora musi być wystarczająco dużo wolnego miejsca do zainstalowania butelek.

Osprzęt montażowy jest dostarczany przez użytkownika. Należy zadbać, aby mocowanie ścienne miało wystarczającą nośność (około 160 kg). Elementy montażowe muszą być odpowiednio dobrane do ściany.

### 5.3.2 Otwórz drzwi analizatora

Użyj dostarczonego klucza, aby odblokować dwa zamki z boku analizatora. Patrz [Rysunek 7](#) na stronie 456. Przed rozpoczęciem pracy należy zamknąć drzwi, aby zachować klasę środowiskową obudowy i klasę bezpieczeństwa.

## 5.4 Instalacja elektryczna

### ⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO



Niebezpieczeństwo śmiertelnego porażenia prądem elektrycznym. Przed wykonaniem podłączeń elektrycznych należy zawsze odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

### 5.4.1 Uwagi dotyczące wyładowań elektrostatycznych (ESD)

#### POWIADOMIENIE



Potencjalne uszkodzenie przyrządu. Elektryczność statyczna może doprowadzić do uszkodzenia wrażliwych wewnętrznych komponentów elektronicznych, powodując pogorszenie parametrów roboczych urządzenia lub jego awarię.

Wykonaj czynności dla tej procedury, aby zapobiec wyładowaniom elektrostatycznym, które mogłyby uszkodzić przyrząd:

- Dotknij uziemionej metalowej powierzchni (np. obudowy przyrządu lub metalowej rury), aby rozładować napięcie elektrostatyczne swojego ciała.
- Unikaj wykonywania gwałtownych ruchów. Elementy wrażliwe na ładunki elektrostatyczne należy transportować w opakowaniach antystatycznych.
- Załóż opaskę na nadgarstek połączoną z uziemieniem.
- Pracuj w środowisku wyłożonym antystatycznymi płytkami podłogowymi i okładziną na stole.

### 5.4.2 Porty elektryczne

Przeprowadź przewody urządzeń zewnętrznych przez dławiki kablowe. Patrz [Rysunek 8](#) na stronie 458. W nieużywanych dławikach kablowych pozostaw zaślepki.

[Rysunek 9](#) na stronie 461 pokazuje komponenty we wnętrzu analizatora. Wyłącznik zasilania jest wyłącznikiem automatycznym, który automatycznie odcina zasilanie sieciowe w przypadku wystąpienia przetężenia (np. zwarcia) lub przepięcia.

### 5.4.3 Podłączenie urządzeń zewnętrznych

Podłącz urządzenie zewnętrzne, które będzie używane wspólnie z analizatorem do współpracy z przyłączami sygnałowymi i sterującymi analizatora. Patrz [Rysunek 10](#) na stronie 465 i [Tabela 1](#) na stronie 178.

Tabela 1 Przyłącza sygnałowe i sterujące — opisy

Styk	Opis
AO1–AO8 (P101)	Osiem wyjść analogowych do sterowania urządzeniami zewnętrznymi. Więcej informacji można znaleźć w rozszerzonej wersji instrukcji użytkownika online.
FCT1–FCT5 (P102)	Pięć przekaźników (ze stykami bezpotencjałowymi). Maksymalne obciążenie: 24 V DC, 0,5 A. <ul style="list-style-type: none"><li>• FCT1 — alarm usterki</li><li>• FCT2 — alarm konserwacji</li><li>• FCT3 — analizator jest gotowy</li><li>• FCT4 i FCT5 — do wykorzystania w przyszłości</li></ul>

**Tabela 1 Przyłącza sygnałowe i sterujące — opisy (ciąg dalszy)**

Styk	Opis
DI1–DI7 (P103)	<p>Siedem wejść cyfrowych do współpracy z systemem zdalnego sterowania analizatorem<sup>5</sup> Połącz wejścia cyfrowe z zewnętrznymi stykami bezpotencjałowymi (24 VDC), aby móc przesyłać do analizatora sygnał rozpoczęcia pomiaru w określonym kanale.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DI1 — zdalne uruchomienie kanału 1</li> <li>• DI2 — zdalne uruchomienie kanału 2</li> <li>• DI3 do DI7 — do wykorzystania w przyszłości</li> </ul>
FB1–FB4 (P104)	<p>Złącza Profibus DP lub Modbus RTU (RS485)</p> <p><b>Profibus DP:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FB1–A1 (wejście)</li> <li>• FB2–A2 (wyjście)</li> <li>• FB3–B1 (wejście)</li> <li>• FB4–B2 (wyjście)</li> <li>• SHL — ekran</li> </ul> <p><b>Modbus RTU:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FB1–D (+)</li> <li>• FB2–D (-)</li> <li>• FB3 — nie używane</li> <li>• FB4 — nie używane</li> <li>• SHL — ekran</li> </ul> <p>W dokumentacji przetwornika SC4500 instrukcje konfiguracji Modbus i informacje dotyczące znaczników Telegram.</p>
24 V DC / 1 A (P105)	Zasilanie 24 V DC modułów filtracyjnych EZ9010 i EZ9020
STR1–STR8 (P106)	<p>Ośmiem wyjść cyfrowych do współpracy z opcjonalnym panelem Moduplex. Podłącz niez izolowane przewody każdego zaworu kanału panelu Moduplex do odpowiednich złączy STR.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• STR1 — kanał 1</li> <li>• STR2 — kanał 2</li> <li>• ...</li> <li>• STR8 — kanał 8</li> </ul>
EXT9–EXT12 (P107)	<p>Cztery wyjścia cyfrowe do współpracy z opcjonalnym panelem filtracyjnym EZ9150. Podłącz zawory i pompy elektryczne panelu filtracyjnego EZ9150 do złączy EXT.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EXT9 — zawór płukania</li> <li>• EXT10 — zawór przepłukiwania wstecznego</li> <li>• EXT11 — zawór przelewowy spustu</li> <li>• EXT12 — pompa filtracyjna</li> </ul>
D01–D06 (P108 i P109)	<p>Sześć wyjść zaworów pneumatycznych dla panelu EZ9150.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• D01 — zawór wlotowy próbki</li> <li>• D02 — zawór przelewowy odpływu</li> <li>• D03 — zawór kanału 1</li> <li>• D04 — zawór kanału 2</li> <li>• D05 — zawór kanału 3</li> <li>• D06 — zawór kanału 4</li> </ul>

<sup>5</sup> Gdy analizator jest w trybie konserwacji, zdalne sterowanie jest wyłączone.

## 5.4.4 Podłączenie do źródła prądu przemiennego

### ⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO



Ryzyko porażenia prądem i pożaru. Upewnij się, że dostarczony przewód i wtyczka bez blokady spełniają obowiązujące wymogi przepisów danego kraju.

- Upewnij się, że w linii zasilającej został zainstalowany wyłącznik o odpowiedniej wartości prądu znamionowego.
- Upewnij się, że wyłącznik automatyczny lub wyłącznik awaryjny jest zainstalowany w pobliżu analizatora, aby w razie potrzeby można było natychmiast odłączyć analizator od zasilania.
- Urządzenia należy podłączyć zgodnie z lokalnymi lub krajowymi przepisami elektrycznymi.
- Zainstaluj dostarczony przewód zasilania, wsuwając do dławika kablowego z boku analizatora.
- Dokręć dławik kablowy, aby przewód zasilania był pewnie zamocowany i aby obudowa spełniała wymagania stopnia ochrony.

Podłącz analizator do sieci prądu przemiennego przy użyciu dostarczonego przewodu zasilania z sieci prądu przemiennego. Patrz [Tabela 2](#) na stronie 180 i [Rysunek 11](#) na stronie 468.

### POWIADOMIENIE

Nie ustawiaj przełącznika zasilania w położeniu włączenia. Przed uruchomieniem wykonać wszystkie połączenia elektryczne i hydrauliczne, ponieważ w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia analizatora.

**Tabela 2 Informacje dotyczące okablowania — zasilanie AC**

Zacisk	Opis	Kolor kabla - Ameryka Północna i Kanada	Kolor kabla - UE
L	Przewód napięciowy/linia (L)	Czarny (1)	Brązowy
N	Przewód zerowy	Biały (2)	Niebieski
	Uziemienie ochronne (PE)	Zielony z żółtym paskiem	Zielony z żółtym paskiem

## 5.5 Przyłączenia

### 5.5.1 Wtyczne dotyczące linii próbek

#### ⚠ UWAGA



Niebezpieczeństwo pożaru. Produkt nie jest przeznaczony do użytku z łatwopalnymi próbkami.

Należy wybrać w pełni reprezentatywny punkt poboru próbki, aby otrzymać jak najlepsze wyniki. Analizowana próbka musi być reprezentatywna dla całego systemu.

- Natężenie przepływu próbki powinno być wyższe niż natężenie przepływu do analizatora.
- Jeśli w analizatorze stosowana jest pompa perystaltyczna do doprowadzania próbki do naczynia analitycznego, w linii próbki powinno panować ciśnienie atmosferyczne.
- Linia próbki powinna pobierać próbkę z małego naczynia przelewowego znajdującego się w pobliżu analizatora.
- Użyj dostarczonej linii próbkowania. Nie zmieniaj długości linii próbkowania.

Należy stale uzupełniać próbkę w naczyniu przelewowym. Jeśli próbka zawiera zbyt duże cząstki stałe, zaleca się także filtrowanie próbki.

## 5.5.2 Wytyczne dotyczące przewodów odpływowych

### ⚠ OSTRZEŻENIE



Niebezpieczeństwo pożaru. Użytkownik musi zadbać o zastosowanie odpowiednich środków ostrożności w przypadku użytkowania sprzętu z metodami wykorzystującymi łatwopalne płyny. Należy przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności i przestrzegać stosownych procedur bezpieczeństwa. Są to m.in. procedury postępowania w przypadku wycieków, stosowania odpowiedniej wentylacji, zakazu użytkowania bez nadzoru oraz pozostawiania włączonego urządzenia bez nadzoru.

### ⚠ UWAGA



Narażenie na działanie substancji chemicznych. Usuwać substancje chemiczne i odpady zgodnie z przepisami lokalnymi, regionalnymi i państwowymi.

### POWIADOMIENIE

Nie należy podłączać przewodów odpływowych do innych przewodów, ponieważ może powstać ciśnienie zwrotne lub dojść do uszkodzenia analizatora. Należy się upewnić, że przewody odpływowe znajdują się na otwartym powietrzu.

### POWIADOMIENIE

Aby uniknąć powstania ciśnienia zwrotnego i uszkodzenia analizatora, należy umieścić analizator wyżej niż odpływ z obiektu oraz zapewnić stałe nachylenie w dół przewodu odpływowego. Zainstalować przewody odpływowe ze spadkiem wynoszącym co najmniej 2,54 cm (1 cal) na każde 0,3 m (1 stopa) długości przewodu.

Przewody odpływowe służą w analizatorze do odprowadzania próbki i odczynników po zakończeniu analizy. Tylko prawidłowa instalacja przewodów odpływowych zapewni, że cały płyn zostanie odprowadzony z przyrządu. Nieprawidłowa instalacja może spowodować powrót płynów do wnętrza przyrządu i jego uszkodzenie. Dla przewodu odpływowego wystarczy odpływ w podłodze lub zlewie. Zalecana średnica zewnętrzna przewodu odpływowego wynosi 32 mm. Patrz [Rysunek 12](#) na stronie 471.

- Przewody odpływowe muszą być jak najkrótsze.
- Należy się upewnić, że odpływ znajduje się poniżej poziomu analizatora.
- Przewody odpływowe muszą mieć stałe nachylenie w dół.
- Przewody odpływowe nie mogą mieć ostrych zagięć ani być ściśnięte.
- Przewody odpływowe muszą być otwarte na powietrze, a ciśnienie w nich musi być zerowe.
- Przewody odpływowe muszą być zamknięte na warunki otoczenia w pomieszczeniu, w którym znajduje się instalacja.
- Nie wolno zatykać ani zanurzać przewodu odpływowego.

Zalecane jest także przyłączyć wody w pobliżu analizatora w celu regularnego przepłukiwania zlewu i przewodu odpływowego czystą wodą, co pozwala uniknąć niedrożności spowodowanej przez krystalizację.

W celu uzyskania dodatkowych informacji o odczynnikach stosowanych w analizatorze należy zapoznać się z arkuszem metod i odczynników odpowiedniej serii modeli EZ. Jeśli analizator wykorzystuje odczynniki łatwopalne, należy przestrzegać następujących środków ostrożności:

- Nie wolno podłączać przewodu odpływowego do odpływu podłogowego.
- Odpady należy usuwać zgodnie z lokalnymi, regionalnymi i krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

### 5.5.3 Wytyczne dotyczące przewodów wentylacyjnych

#### ⚠ OSTRZEŻENIE



Niebezpieczeństwo pożaru. Użytkownik musi zadbać o zastosowanie odpowiednich środków ostrożności w przypadku użytkowania sprzętu z metodami wykorzystującymi łatwopalne płyny. Należy przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności i przestrzegać stosownych procedur bezpieczeństwa. Są to m.in. procedury postępowania w przypadku wycieków, stosowania odpowiedniej wentylacji, zakazu użytkowania bez nadzoru oraz pozostawiania włączonego urządzenia bez nadzoru.

#### ⚠ UWAGA



Narażenie na działanie substancji chemicznych. Usuwać substancje chemiczne i odpady zgodnie z przepisami lokalnymi, regionalnymi i państwowymi.

#### POWIADOMIENIE

Nie należy podłączać przewodu wentylacyjnego (port wylotowy gazów) do innych przewodów, ponieważ może powstać ciśnienie zwrotne lub dojść do uszkodzenia analizatora. Przewód wentylacyjny musi być otwarty na powietrze na zewnątrz budynku.

#### POWIADOMIENIE

Aby uniknąć powstania ciśnienia zwrotnego i uszkodzenia analizatora, należy umieścić analizator wyżej niż otwory wentylacyjne obiektu oraz zapewnić stałe nachylenie w dół przewodu wentylacyjnego. Zainstalować przewód wentylacyjny ze spadkiem wynoszącym co najmniej 2,54 cm (1 cal) na każde 0,3 m (1 stopa) długości przewodu.

Analizator wykorzystuje przewód wentylacyjny do utrzymywania w naczyniu analitycznym ciśnienia atmosferycznego. Prawidłowa instalacja przewodu wentylacyjnego jest bardzo ważna. Nieprawidłowa instalacja może spowodować przedostawanie się płynu z przewodu wentylacyjnego do naczynia analitycznego podczas pracy pompy. Nieprawidłowa instalacja może spowodować powrót gazu do wnętrza analizatora i jego uszkodzenie. Zalecana średnica zewnętrzna rury kolektora przewodu wentylacyjnego wynosi 32 mm. Patrz [Rysunek 12](#) na stronie 471.

- Przewód wentylacyjny powinien być jak najkrótszy.
- Przewód wentylacyjny musi mieć stałe nachylenie w dół.
- Przewód wentylacyjny nie może mieć ostrych zagięć ani być ściśnięty.
- Przewód wentylacyjny musi być zamknięty na warunki otoczenia w pomieszczeniu, w którym znajduje się instalacja, a ciśnienie w przewodzie musi być zerowe.
- Upewnij się, że przewód odpowietrzający znajduje się zawsze wyżej niż odpływ.
- Nie wolno zatykać ani zanurzać przewodu wentylacyjnego.

Jeśli analizator wykorzystuje odczynniki łatwopalne, należy przestrzegać następujących środków ostrożności:

- Nie wolno podłączać przewodu wentylacyjnego do odpływu podłogowego.
- Odpady należy usuwać zgodnie z lokalnymi, regionalnymi i krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

### 5.5.4 Podłącz analizator do testu komponentów


#### ⚠ UWAGA





Niebezpieczeństwo pożaru. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania z łatwopalnymi cieczami.

Przed uruchomieniem analizatora ze wszystkimi odczynnikiem należy przeprowadzić test komponentów z użyciem wody dejonizowanej. Patrz ilustrowana procedura i [Wykonanie testu komponentów](#) na stronie 187.

1. Zainstaluj cztery rurki zaworu zaciskowego, jak pokazano w kroku 1 na ilustracji poniżej.
  - a. Naciśnij czarny przycisk, po czym wciśnij rurkę do zaworu.
  - b. Gdy rurka jest prawidłowo zainstalowana, zwolnij przycisk.
2. Upewnij się, że przewód spustowy jest prawidłowo zainstalowany w naczyniu na próbkę. Instrukcję przedstawiono w ilustrowanym kroku 2 poniżej.
3. Upewnij się, że rurka fermentacyjna jest prawidłowo zainstalowana w naczyniu fermentatora. Patrz ilustrowany krok 3 poniżej.
4. Podłącz wszystkie płyny analizatora do dużej butelki z wodą dejonizowaną, aby wykonać test komponentów. Patrz ilustrowany krok 3 poniżej. Rurki są zainstalowane fabrycznie.

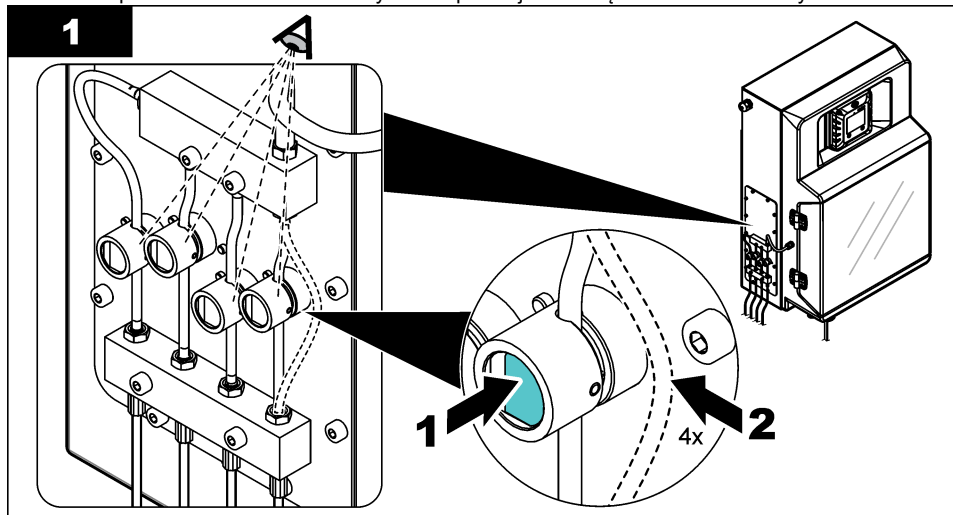

2

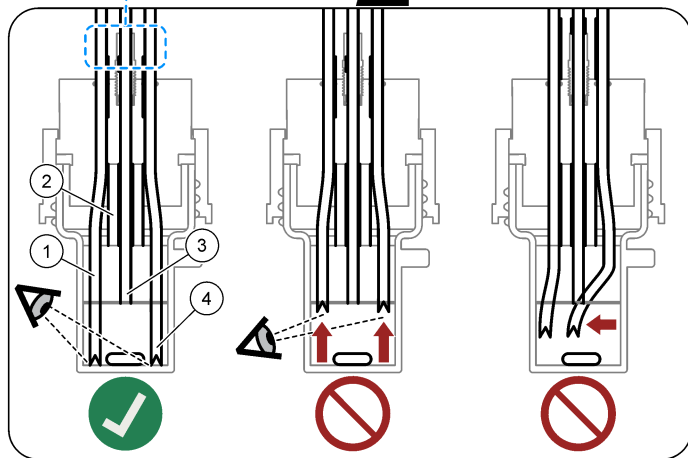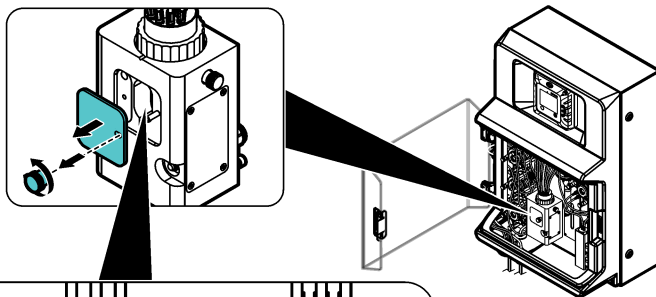


1 Przewód spustowy

3 Przewody do poboru próbek

2 Rurki odczynników i odpowietrzające (górne rurki)

4 Rurka fermentacyjna


3

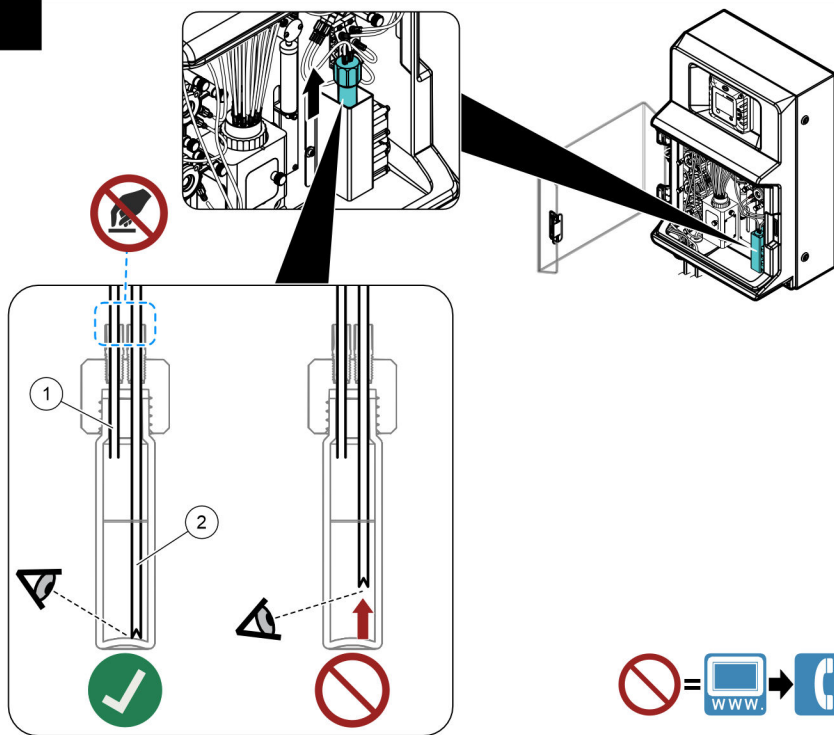

PL

1 Przewód odpowietrzający

2 Rurka fermentacyjna

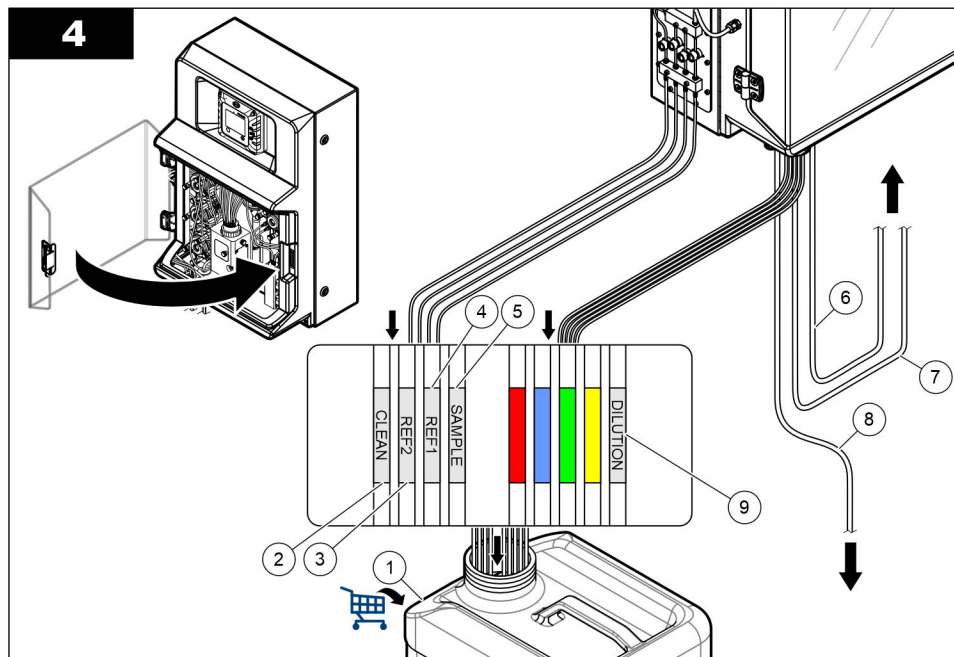

1 Woda dejonizowana	4 Rurka roztworu Wzorec 1 (REF1)	7 Odpowietrznik fermentatora
2 Rurka roztworu czyszczącego	5 Rurka wlotu próbki	8 Przewód spustowy
3 Rurka roztworu Wzorec 2 (REF2)	6 Przewód odpowietrzający	9 Rurki mikropomp do rozcieńczania i odczynników

## Rozdział 6 Rozruch

### 6.1 Pierwsze uruchomienie

**Uwaga:** Należy upewnić się, że montaż, przewody i instalacja elektryczna jest w pełni ukończona przed uruchomieniem. Patrz [Instalacja](#) na stronie 176.

Kiedy analizator jest włączony po raz pierwszy, asystent uruchomienia pomoże w przejściu przez pierwsze kroki w celu ukończenia konfiguracji. Należy wykonać wszystkie następujące kroki, aby upewnić się, że analizator działa prawidłowo.

**Uwaga:** Użyj odpowiednich odczynników dla wybranego zakresu pomiarowego. Więcej informacji można znaleźć w rozszerzonej wersji instrukcji użytkownika online.

- Otwórz drzwi analizatora. Patrz [Otwórz drzwi analizatora](#) na stronie 178.
- Ustaw przełącznik zasilania w położeniu ON (włączenia). Patrz [Rysunek 9](#) na stronie 461.
- Zamknij drzwi analizatora za pomocą dostarczonego klucza.
- Poczekaj na zakończenie procedury inicjalizacji.
- Aby wybrać język, strefę czasową, datę i godzinę, postępuj zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.  
Informacje o konfigurowaniu innych ustawień przetwornika podano w dokumentacji przetwornika SC4500.
- Dotknij wyświetlacz, aby wyświetlić menu **EZ2700sc**.
- Wybierz **Menu urządzenia**, aby włączyć asystenta uruchomienia.

Zostanie wyświetlony ekran powitalny.

8. Wykonaj czynności pokazane na wyświetlaczu, aby wybrać odpowiedni zakres pomiarowy. Naciśnij **OK**.
9. Jeśli zainstalowany jest moduł filtrujący, wybierz **Wł.**. W przeciwnym razie wybierz **Wył.**.
10. Wybierz liczbę kanałów dla analizatora. Naciśnij **OK**.
11. Jeśli konfiguracja wyświetlona na stronie podsumowania jest prawidłowa, naciśnij **OK**. Wyświetlone zostanie menu główne **EZ2700sc**.
12. Kontynuuj test komponentów. Patrz [Wykonanie testu komponentów](#) na stronie 187.

## 6.2 Wykonanie testu komponentów

### ⚠ OSTRZEŻENIE



Niebezpieczeństwo zgniecenia. Ruchome części mogą zgnieść palce i spowodować obrażenia. Nie dotykać ruchomych części.

Przed rozpoczęciem pracy analizatora wykonaj testy komponentów. Użyj menu **Konserwacja**, aby uruchomić różne funkcje analizatora w celu sprawdzenia działania komponentów.

#### Warunki wstępne:

- Jeśli analizator jest w trybie pracy, wybierz opcję **Konserwacja > Rozpocznij tryb serwisowy**.
- Upewnij się, że rurki próbki, odczynnika i roztworu znajdują się w pojemniku z wodą dejonizowaną. Patrz [Podłącz analizator do testu komponentów](#) na stronie 182.

#### 6.2.1 Sprawdzenie mieszadła

1. Zdejmij osłonę światła z modułu fotometru. Patrz [Rysunek 13](#) na stronie 472.
2. Upewnij się, że mieszadło znajduje się u dna naczynia z próbką.  
*Uwaga:* Sprawdź mieszadło podczas procedury napełniania, aby upewnić się, że obraca się prawidłowo. Procedura napełniania rozpoczyna się w [Sprawdzenie pompy i zaworów zaciskowych](#) na stronie 187.
3. Zainstaluj osłonę światła na fotometrze.

#### 6.2.2 Sprawdzenie pompy i zaworów zaciskowych

1. Sprawdź działanie pomp i zaworów zaciskowych, aby upewnić się, że nie ma żadnych wycieków.
2. Upewnij się, że naczynie analityczne wypełnia się wodą dejonizowaną. Patrz [Rysunek 14](#) na stronie 474.
3. Upewnij się, że woda dejonizowana wypływa z rurki spustowej.
4. Wybierz **Konserwacja > Rozpocznij zalewanie** i oddzielnie zalej wszystkimi płynami.  
Jeśli dojdzie do wycieku, należy sprawdzić wszystkie połączenia i zapoznać się z rozszerzoną wersją instrukcji obsługi online, aby uzyskać więcej informacji.
  - a. Wybierz **Zalej wzorzec 1** i naciśnij **OK**.
  - b. Wybierz **Zalej wzorzec 2** i naciśnij **OK**.
  - c. Wybierz **Zalej roztwór czyszczący** i naciśnij **OK**.
  - d. Wybierz **Zalej przepłukiwanie** i naciśnij **OK**.
  - e. Wybierz **Zalej dozownik** i naciśnij **OK**.
  - f. Wybierz **Napełnij kanał > Napełnij wszystkie kanały** i naciśnij **OK**.  
Po zakończeniu każdej procedury zalewania zostanie ona automatycznie zatrzymana.

### 6.2.3 Sprawdzenie mikropompy

Sprawdź mikropompy pod kątem wycieków i pęcherzyków powietrza.

1. Zdejmij osłonę światła z fotometru.
2. Wybierz **Konserwacja > Rozpocznij zalewanie > Zalej wszystkie odczynniki**.
3. Upewnij się, że woda dejonizowana dociera do mikropompy przez każdą rurkę mikropompy (odczynnika). Po czym nieprzerwanie do naczynia analitycznego bez pęcherzyków powietrza. Patrz [Rysunek 15](#) na stronie 475.
4. Jeśli mikropompy nie działają prawidłowo (pęcherzyki w rurkach), zastosuj procedurę z użyciem strzykawki, aby doprowadzić wodę dejonizowaną do odpowiedniej rurki w celu usunięcia pęcherzyków. Patrz [Rysunek 16](#) na stronie 476.
5. Zainstaluj osłonę światła na fotometrze.

### 6.2.4 Wykonanie kontroli za pomocą fotometru

Aby zagwarantować powodzenie kontroli za pomocą fotometru, przed przystąpieniem do niej upewnij się, że naczynie analityczne jest czyste od zewnątrz. W celu oczyszczenia podzespołów analizatora należy zapoznać się z dodatkowymi informacjami dostępnymi online w rozszerzonej wersji instrukcji obsługi.

1. Naciśnij ikonę głównego menu, następnie wybierz **Urządzenia**.
2. Wybierz **EZ2700sc**.
3. Przewiń do dołu ekranu, następnie wybierz **Menu urządzenia**.
4. Wybierz **Konserwacja > Sprawdzenia fotometru**.
5. Naciśnij **OK**, aby rozpocząć pomiar.  
Po zakończeniu kalibracji ciemności wynik zostanie wyświetlony na wyświetlaczu.
6. Naciśnij **OK**, aby kontynuować.
7. Upewnij się, że przewód „REF1” jest podłączony do zbiornika wypełnionego wodą dejonizowaną. Upewnij się, że jest zainstalowana osłona światła. Patrz [Rysunek 18](#) na stronie 479.
8. Naciśnij **OK**.  
Zaczekaj, aż naczynie analityczne zostanie napełnione.
9. Przy użyciu wkrętaka ustaw napięcie na wyjściu czujnika na wartość 9 V. Patrz [Rysunek 17](#) na stronie 476.
10. Zaczekaj, aż na ekranie wyświetli się wartość 9 V. Następnie naciśnij **OK**.
11. Naciśnij **OK**, aby kontynuować.

## 6.3 Wykonywanie testu sygnałów wejściowych

Przed rozpoczęciem pracy analizatora wykonaj test wejść cyfrowych.

**Warunki wstępne:** Podłącz wejścia cyfrowe do zewnętrznego styku bezpotencjałowego (24 V DC).

Wykonaj test sygnału wejścia cyfrowego i sygnału wyjścia analogowego w następujący sposób:

1. Naciśnij ikonę głównego menu, a następnie wybierz **Urządzenia**.
2. Wybierz **EZ2700sc**.
3. Przewiń do dołu ekranu, następnie wybierz **Menu urządzenia**.
4. Wybierz **Diagnostyka > Sygnały**.  
Pokazują się sygnały na wejściach cyfrowych.
5. Porównaj stan wejść cyfrowych pokazywany na wyświetlaczu z napięciami podawanymi do wejść cyfrowych (24 V = Wł.; 0 V = Wył.).

## 6.4 Wykonywanie testu sygnałów wyjściowych

Przed rozpoczęciem pracy analizatora wykonaj test wyjść analogowych.

**Warunki wstępne:** Skonfiguruj wyjścia analogowe (AO1–AO8, P101), aby wybrać kanał pomiarowy reprezentowany przez każde wyjście analogowe. Więcej informacji można znaleźć w rozszerzonej wersji instrukcji użytkownika online.

Wykonaj test sygnału wyjścia analogowego w następujący sposób:

1. Naciśnij ikonę głównego menu.
2. Wybierz **Wyjścia > Wyjścia mA AOC > Test/Konserwacja**.

Opcja	Opis
Test funkcjonalny	Wykonanie testu na wyjściach wybranego modułu.
Stan wyjścia	Wyświetlenie stanu wyjść wybranego modułu.

3. Przy użyciu multimetru zmierz wartość mA na każdym wyjściu analogowym.
4. Porównaj zmierzone i przewidywane wartości mA na wyjściach analogowych.

## 6.5 Ustawienie sekwencji kanału



Wybierz sekwencję pomiarową kanałów, liczbę pomiarów dla każdego kanału i czas oczekiwania przed pomiarem każdego kanału. Wprowadź maksymalnie 16 linii z maksymalnie 16 cyklami w każdej linii.

1. Naciśnij ikonę głównego menu, następnie wybierz **Urządzenia**.
2. Wybierz **EZ2700sc**.
3. Przewiń do dołu ekranu, następnie wybierz **Menu urządzenia**.
4. Jeśli analizator jest w trybie pracy, wybierz opcję **Konserwacja > Rozpocznij tryb serwisowy**. Poczekaj, aż analizator przejdzie w tryb konserwacji.
5. Wybierz **Konfiguracja > Konfiguracja sekwencji kanałów**.
6. Przy użyciu strzałek na bocznym pasku wybierz pozycję (numer w sekwencji), po czym naciśnij **OK**, aby skonfigurować tę pozycję.
7. Wybierz opcję.

Opcja	Opis
Wybierz	Wybiera odpowiedni kanał lub czas oczekiwania.
Liczba pomiarów	Ustawia liczbę pomiarów dla kanału.
Czas oczekiwania	Ustawia czas oczekiwania dla wybranego kanału.

8. Naciśnij **OK**, aby zapisać zmiany.

## 6.6 Podłączenie roztworu i próbki

▲ UWAGA	
	Narażenie na działanie substancji chemicznych. Stosować się do procedur bezpieczeństwa w laboratoriach i zakładać sprzęt ochrony osobistej, odpowiedni dla używanych substancji chemicznych. Protokoły warunków bezpieczeństwa można znaleźć w aktualnych kartach charakterystyki (MSDS/SDS) materiałów.
▲ UWAGA	
	Narażenie na działanie substancji chemicznych. Usuwać substancje chemiczne i odpady zgodnie z przepisami lokalnymi, regionalnymi i państwowymi.

## ▲ UWAGA



Niebezpieczeństwo pożaru. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania z łatwopalnymi cieczami.

Zasobniki z odczynnikami są dostarczane razem z analizatorem. Patrz [Rysunek 18](#) na stronie 479. Pojemniki na roztwór Wzorzec 1, roztwór Wzorzec 2 i wodę dejonizowaną musi zapewnić użytkownik. Dodatkowe pojemniki można zakupić u producenta.

Zainstaluj pojemniki

- możliwie jak najbliżej analizatora,
- 1 metr pod jego spodem

Więcej informacji na temat instalacji zbiornika można znaleźć w [Rysunek 18](#) na stronie 479.

Odczynniki i roztwory muszą być zapewnione przez użytkownika. Używaj wyłącznie odczynników od certyfikowanych dostawców lub dedykowanych odczynników producenta. Odczynniki mogą być też przygotowywane przez użytkownika. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w arkuszu metod i odczynników dla odpowiedniego modelu, który można znaleźć na stronie internetowej producenta.

Przewody są zainstalowane fabrycznie. Właściwe połączenia hydrauliczne można zidentyfikować na podstawie etykiet przewodów. Właściwe odczynniki, roztwory i wzorce można znaleźć w odpowiednim arkuszu metod i odczynników dla danego modelu dostępnym na stronie internetowej producenta.

1. Po zakończeniu testów komponentów zainstaluj rurki "CLEAN" (roztwór czyszczący), "REF1" (roztwór Wzorzec 1) i "REF2" (roztwór Wzorzec 2) w odpowiednich pojemnikach. Patrz [Rysunek 18](#) na stronie 479.
2. Zainstaluj każdą rurkę odczynnika oznaczoną kolorem w pojemniku odczynnika oznaczonym tym samym kolorem na etykiecie.
3. Podłącz źródło próbki (lub wylot próbki panelu Moduplex, lub filtra) do rurki wlotu próbki analizatora. Patrz [Rysunek 18](#) na stronie 479.
4. Naciśnij ikonę głównego menu, następnie wybierz **Urządzenia**.
5. Wybierz **EZ2700sc**.
6. Przewiń do dołu ekranu, następnie wybierz **Menu urządzenia**.
7. Wybierz **Konserwacja > Rozpocznij zalewanie > Zalej wszystkie**.

## 6.7 Wykonaj walidację przed pierwszym uruchomieniem

Wykonuj walidację, aby upewnić się, że pomiary mieszczą się w zakresie tolerancji. Więcej informacji można znaleźć w rozszerzonej wersji instrukcji użytkownika online.

1. Naciśnij ikonę głównego menu, następnie wybierz **Urządzenia**.
2. Wybierz **EZ2700sc**.
3. Przewiń do dołu ekranu, następnie wybierz **Menu urządzenia**.
4. Aby rozpocząć walidację, wybierz **Kalibracja > Walidacja > Rozpocznij walidację**.  
Walidacja polega na pomiarze wody dejonizowanej w butelce odniesienia 2.
5. Aby wyświetlić wyniki, wybierz opcję:
  - **Kalibracja > Walidacja > Historia walidacji**
  - **Diagnostyka > Dane historyczne > Walidacja**

## 6.8 Uruchomienie analizatora

Aby uruchomić analizator:

1. Naciśnij ikonę głównego menu, następnie wybierz **Urządzenia**.
2. Wybierz **EZ2700sc**.
3. Przewiń do dołu ekranu, następnie wybierz **Menu urządzenia**.
4. Wybierz **Konserwacja > Rozpocznij tryb pracy**.

# Innehållsförteckning

- 1 Mer information på sidan 192
- 2 Produktöversikt på sidan 192
- 3 Specifikationer på sidan 193

- 4 Allmän information på sidan 194
- 5 Installation på sidan 196
- 6 Start på sidan 205

## Avsnitt 1 Mer information

Den grundläggande användarhandboken innehåller information som är tillräcklig för driftsättning. En utökad användarhandbok finns tillgänglig online och innehåller mer information.

### ⚠ FARA



Flera risker! Mer information ges i de enskilda avsnitten i den utökade användarhandboken som visas nedan.

- Användargränssnitt och navigering
- Drift
- Underhåll
- Felsökning
- Reservdelslistor

Skanna QR-koderna som följer för att gå till den utökade användarmanualen.



Europeiska språk



Amerikanska och asiatiska språk

## Avsnitt 2 Produktöversikt

Hach EZ2700sc-analysatorn är en onlineanalysator som mäter en parameter i vattenprover från industri- och miljötillämpningar. Se [Figur 1](#) på sidan 439, [Figur 2](#) på sidan 444 och [Figur 3](#) på sidan 448.

Analysatorn är en kolorimetrisk onlineanalysator för allmän vattenanalys (till exempel nitrat, fosfat). Analysatorn har alternativ för fjärrstart, automatisk validering, automatisk kalibrering, automatisk rengöring och Modbus.

Provvattnet leds in i analysatorn genom provslangen. Analysatorns pumpar, ventiler och sprutor leder prov och reagens till mätcellen på analyspanelen. När analysen i kärlet är klar kasserar analysatorn provet genom dräneringsslangen. Analysresultatet visas på SC4500-styrenhetens skärm. SC4500-styrenheten sparar analysdata (datalogg, händelselogg, inställningslogg och servicelogg). Använd SC4500-styrenheten till att hantera och konfigurera analysatorn.

Om du vill öka antalet provströmmar (kanaler) som analysatorn kan mäta (2, 4 eller 8) köper du Moduplex-panelen för flera strömmar till analysatorn.

Om du vill förbehandla provet (filtrering, stabilisering) köper du filtreringspanelen EZ9010, EZ9020, EZ9150, EZ9200 eller EZ9250 till analysatorn.

## Avsnitt 3 Specifikationer

Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Specifikation	Tekniska data
Mått (B x H x D)	460 x 688 x 340 mm (18,1 x 27,1 x 13,4 tum)
Hölje	IP44, ABS, PMMA och lackerat stål
Display	IP66, 3,5-tums TFT-färgskärm med kapacitiv pekplatta
Vikt	40 kg (88 lb)
Effektkrav	100 till 240 V AC, $\pm 10\%$ , 50/60 Hz
Effektförbrukning	240 VA maximalt
Höjd	2000 m (6560 ft) maximalt
Överspanningskategori	II
Miljöförhållanden	Endast för inomhusbruk
Föreningegrad	2
Drifttemperatur	10 till 30 °C (50 till 86 °F); 5 till 95 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande, icke-korrosiv
Förvaringstemperatur	-20 till 60 °C (-4 till 140 °F), 95 % relativ luftfuktighet, ej kondenserande
Provinlopp	Ett
Provtryck	Via externt överflödeskärl (öppen för atmosfärstryck)
Provflödes hastighet	100 till 300 mL/min
Provtemperatur	10 till 30 °C (50 till 86 °F)
Provkvalitet	< 100 $\mu\text{m}$ partiklar, <0,1 g/l max Turbiditet <50 NTU
Luftspolning i korrosiva miljöer	0,2 bar (20 kPa eller 3 psi), torr och ren luft
Utlopp	Atmosfärstryck, ventilerat, minst $\varnothing$ 32 mm
Jordanslutning	Torr och rent jordspett med låg impedans (<1 $\Omega$ ) med en jordkabel på >2,5 mm <sup>1</sup> (13 AWG)
Analoga utgångar	Högst åtta analoga utgångar på 0 - 20 mA (eller 4 - 20 mA) <b>Observera:</b> De analoga utgångarna försörjer slingströmmen. Ström kan inte tillföras till kontakterna i SCADA- eller PLC-systemet.
Digitala ingångar	Sju digitala ingångar: Två digitala ingångar för fjärrstart. Återstående digitala ingångar är avsedda för framtida bruk.
Digitala utgångar	Fyra strömförande digitala utgångar för ventilerna och pumparna på EZ9150-panelen; åtta aktiverade digitala utgångar för ventilerna på Moduplex-panelen; 24 VDC, 500 mA.
Reläer	Fem spänningsfria kontakter (FCT), maximal belastning 24 VDC, 0,5 A (resistiv belastning)
Ethernet-anslutningar	Claras Ethernet-anslutning och Modbus TCP/IP Ethernet-anslutning, LAN-version, 10/100 Mbit/s, Profinet eller Ethernet IP
RS485-kommunikation	Profibus DP eller Modbus RTU

<sup>2</sup> Information om Ethernet-konfiguration och Modbus-konfiguration finns i dokumentationen SC4500-styrenheten.

Specifikation	Tekniska data
Certifieringar	CE- och ETL-certifierad enligt UL- och CSA-säkerhetsstandarder, UKCA
Garanti	1 år (EU: 2 år)

## Avsnitt 4 Allmän information

Tillverkaren kommer under inga omständigheter att hållas ansvarig för skador som uppstår på grund av felaktig användning av produkten eller underlåtenhet att följa instruktionerna i manualen.

Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna bruksanvisning och i produkterna som beskrivs i den när som helst och utan föregående meddelande och utan skyldigheter. Reviderade upplagor finns på tillverkarens webbsida.

### 4.1 Säkerhetsinformation

Tillverkaren tar inget ansvar för skador till följd av att produkten används på fel sätt eller missbrukas. Det omfattar utan begränsning direkta skador, oavsiktliga skador eller följdskador. Tillverkaren avsäger sig allt ansvar i den omfattning gällande lag tillåter. Användaren är ensam ansvarig för att identifiera kritiska användningsrisker och installera lämpliga mekanismer som skyddar processer vid eventuella utrustningsfel.

Läs igenom hela handboken innan instrumentet packas upp, monteras eller startas. Följ alla faro- och försiktighetshänvisningar. Om inte hänsyn tas till dessa kan operatören råka i fara eller utrustningen ta skada.

Om utrustningen används på ett sätt som inte specificeras av tillverkaren kan det skydd som utrustningen ger försämrats. Använd eller installera inte utrustningen på något annat sätt än vad som anges i denna bruksanvisning.

#### 4.1.1 Anmärkning till information om risker

##### ▲ FARA

Indikerar en potentiellt eller överhängande riskfylld situation som kommer att leda till livsfarliga eller allvarliga skador om den inte undviks.

##### ▲ VARNING

Indikerar en potentiellt eller överhängande riskfylld situation som kan leda till livsfarliga eller allvarliga skador om situationen inte undviks.

##### ▲ FÖRSIKTIGHET

Indikerar en potentiellt riskfylld situation som kan resultera i lindrig eller måttlig skada.

##### ANMÄRKNING:

Indikerar en potentiellt riskfylld situation som kan medföra att instrumentet skadas. Information som användaren måste ta hänsyn till vid hantering av instrumentet.

#### 4.1.2 Säkerhetsetiketter





Beakta samtliga dekaler och märken på instrumentet. Personskador eller skador på instrumentet kan uppstå om de ej beaktas. En symbol på instrumentet beskrivs med en försiktighetsvarning i bruksanvisningen .




Detta är symbolen för säkerhetsvarningar. Följ alla säkerhetsanvisningar som följer efter denna symbol för att undvika potentiella skador. Om den sitter på instrumentet - se bruksanvisningen för information om drift eller säkerhet.



Denna symbol visar på risk för kemisk skada och indikerar att endast personer som är kvalificerade och utbildade för att arbeta med kemikalier bör hantera kemikalier eller utföra underhåll på system för tillförsel av kemikalier till utrustningen.






	Denna symbol indikerar risk för elektrisk stöt och/eller elchock.
	Denna symbol indikerar utrustning som är känslig för elektrostatisk urladdning (ESD). Särskilda åtgärder måste vidtas för att förhindra att utrustningen skadas.
	Den här symbolen visar att den märkta produkten kräver skyddsjordning. Om instrumentet inte levereras med en jordningskontakt eller -kabel gör du den jordade anslutningen skyddsjordanslutningen till skyddsledarplinten.
	Elektrisk utrustning markerad med denna symbol får inte avyttras i europeiska hushållsavfallssystem eller allmänna avfallssystem. Returnera utrustning som är gammal eller har nått slutet på sin livscykel till tillverkaren för avyttring, utan kostnad för användaren.

### 4.1.3 Kemisk och biologisk säkerhet

▲ FARA	
	Kemisk eller biologisk fara. Om detta instrument används för att övervaka en behandlingsprocess och/eller kemiskt matningssystem som det finns regelverk och övervakningskrav för vad gäller folkhälsa, allmän säkerhet, mat- eller dryckestillverkning eller bearbetning, är det användarens ansvar att känna till och följa gällande lagstiftning och att använda tillräckliga och lämpliga säkerhetsmekanismer enligt gällande bestämmelser i händelse av fel på instrumentet.

## 4.2 Ikoner som används i illustrationerna

			
Från tillverkaren medföljande delar	Delar som tillhandahålls av användaren	Titta	Utför steg i omvänd ordning

				
För två personer	Lyssna	Använd endast fingrar	Använd inte verktyg	Vidrör inte

## 4.3 Avsedd användning

Analysatorerna i Hach EZ-serien är avsedda för användning av personer som kontinuerligt måste mäta vattenkvalitetsparametrar i prover från industri- och miljöanvändningsområden. Analysatorerna i Hach EZ-serien används inte till att behandla eller ändra vatten eller till att styra procedurer.

## 4.4 Produktens komponenter

Se till att alla komponenter har tagits emot. Se [Figur 4](#) på sidan 453. Om några komponenter saknas eller är skadade ska du genast kontakta tillverkaren eller en återförsäljare.

## Avsnitt 5 Installation

### ▲ FARA



Flera risker. Endast kvalificerad personal får utföra de moment som beskrivs i den här delen av dokumentet.

### 5.1 Riktlinjer för installation

SV  
SE

### ▲ VARNING



Brandfara. Användaren ansvarar för att se till att tillräckliga försiktighetsåtgärder vidtas när utrustningen används med metoder som använder brandfarliga vätskor. Utför försiktighetsåtgärder och följ säkerhetsanvisningar. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, kontroll av spill och läckage, ordentlig ventilation, ingen oönskad användning och att instrumentet aldrig lämnas utan tillsyn när strömmen är ansluten.

### ▲ FÖRSIKTIGHET



Risk för kemikalieexponering. Följ laboratoriets säkerhetsanvisningar och bär all personlig skyddsutrustning som krävs vid hantering av kemikalier. Läs aktuella datablad (MSDS/SDS) om säkerhetsanvisningar.

### ▲ FÖRSIKTIGHET



Risk för kemikalieexponering. Kassera kemikalier och avfall enligt lokala, regionala och nationella lagar.

- Installera analysatorn inomhus i en riskfri miljö.
- Installera analysatorn i en miljö som är skyddad mot frätande vätskor.
- Installera analysatorn på en ren, torr, välventilerad och temperaturstyrd plats.
- Installera analysatorn så nära provtagningspunkten som möjligt.
- Installera inte analysatorn i direkt solljus eller i närheten av en värmekälla.
- Se till att det finns tillräckligt mycket utrymme för rördragning och elektriska anslutningar.
- Se till att lämna tillräckligt med utrymme framför analysatorn så att den går att öppna analysatorluckan. Se [Analysatorns mått](#) på sidan 197.
- Se till att omgivningsförhållandena är inom driftspecifikationerna. Se [Specifikationer](#) på sidan 193.

Även om analysatorn inte är avsedd att användas med brandfarliga prover används brandfarliga reagens i vissa EZ-analysatorer. Se metod- och reagensbladet för tillämplig modell i EZ-serien för mer information om reagens som används i analysatorn. Om du använder brandfarliga reagens i analysatorn måste du följa följande säkerhetsföreskrifter:




- Se till att analysatorn inte är i närheten av värme, gnistor eller öppen eld.
- Ät, drick och rök inte i närheten av analysatorn.
- Använd ett lokalt avgasventilationssystem.
- Använd gnist- och explosionssäker utrustning och gnist- och explosionssäkra belysningsystem.
- Förhindra att det uppstår elektrostatiska urladdningar. Se [Elektrostatisk urladdning \(ESD\), överväganden](#) på sidan 197.
- Rengör och torka instrumentet före användning.
- Tvätta händerna före pauser och vid arbetsskiftets slut.
- Avlägsna kontaminerade kläder. Tvätta dem innan du använder dem igen.
- Du måste hantera den här typen av vätskor enligt lokala lagar och regler för exponeringsgränser.

## 5.2 Analysatorns mått

Se [Figur 5](#) på sidan 454 för analysatorns mått.

## 5.3 Mekanisk installation

### 5.3.1 Ansluta instrumentet till en vägg

▲ VARNING	
	Risk för personskada. Se till att väggupphängningen håller 4 gånger utrustningens vikt.
▲ VARNING	
	Risk för personskada. Instrument och komponenter är tunga. Ta hjälp vid installation eller flytt.
▲ VARNING	
	Risk för personskada. Föremålet är tungt. Se till att instrumentet är ordentligt monterat mot en vägg, ett bord eller golv för säker drift.

Använd de medföljande monteringsfästena och fäst instrumentet upprätt och plant på en jämn, vertikal väggyta. Mer information finns i [Figur 6](#) på sidan 456.

Installera instrumentet på en plats där användaren enkelt kan koppla bort det från strömkällan.

Se till att det finns tillräckligt med utrymme under analysatorn för att montera flaskorna.

Montagematerial tillhandahålls av användaren. Se till att väggfästet har tillräcklig bärkraft (cirka 160 kg eller 353 lb). Monteringsmaterialet måste vara godkänt för väggens egenskaper.


### 5.3.2 Öppna analysatorns dörr

Använd den medföljande knappen för att låsa upp de två låsningarna på analysatorns sida. Mer information finns i [Figur 7](#) på sidan 456. Se till att stänga luckan före användning så att du bibehåller höljets miljöklassning och säkerhetsklassning.

## 5.4 Elektrisk installation

▲ FARA	
	Risk för dödande elchock. Koppla alltid bort strömmen till instrumentet innan du gör elektriska kopplingar.

### 5.4.1 Elektrostatisk urladdning (ESD), överväganden

ANMÄRKNING:	
	Möjlig skada på instrumentet. Ömtåliga interna elektroniska komponenter kan skadas av statisk elektricitet, vilket kan leda till försämrad funktion hos instrumentet eller till att det inte fungerar.

Följ stegen i den här proceduren för att förhindra att instrumentet skadas av elektrostatisk urladdning:

- Vidrör en jordad metallyta som ytterhöljets på ett instrument, en metalledning eller ett metallrör för att ladda ur statisk elektricitet från enheten.
- Undvik onödiga rörelser. Transportera komponenter känsliga för statisk elektricitet i antistatiska behållare eller förpackningar.
- Bär en handledsrem som är ansluten till jord med en sladd.
- Arbeta på en statiskt säker plats med antistatiska mattor på golv och arbetsbänkar.

## 5.4.2 Elektrisk åtkomst

Dra kablarna till de externa enheterna genom packboxarna. Se [Figur 8](#) på sidan 459. Behåll pluggarna i de packboxar som inte används.

[Figur 9](#) på sidan 461 visar komponenterna i analysatorn. Strömbrytaren är en krets brytare som automatiskt stänger av strömtillförseln från AC-strömledningen om ett tillstånd med överström (till exempel kortslutning) eller överspänning inträffar.

## 5.4.3 Anslut de externa enheterna

Anslut de externa enheter som ska användas med analysatorn till analysatorns signal- och styruttag. Se [Figur 10](#) på sidan 466 och [Tabell 1](#) på sidan 198.

**Tabell 1 Signal- och styruttag – beskrivningar**

Stift	Beskrivning
AO1–AO8 (P101)	Åtta analoga utgångar för styrning av externa enheter. Se den utökade versionen av användarhandboken online för mer information.
FCT1–FCT5 (P102)	Fem reläer (spänningsfria kontakter). Maximal belastning är 24 VDC, 0,5 A. <ul style="list-style-type: none"><li>• FCT1 – felfunktionslarm</li><li>• FCT2 – underhållslarm</li><li>• FCT3 – analysatorn klar</li><li>• FCT4 och FCT5 – för framtida bruk</li></ul>
DI1–DI7 (P103)	Sju digitala ingångar för fjärrstyrning av analysatorn <sup>5</sup> Anslut de digitala ingångarna till en extern spänningsfri kontakt (24 VDC) för att få analysatorn att starta en mätning för en kanal. <ul style="list-style-type: none"><li>• DI1 – fjärrstart för kanal 1</li><li>• DI2 – fjärrstart för kanal 2</li><li>• DI3 till DI7 – för framtida bruk</li></ul>
FB1–FB4 (P104)	Anslutningar för Profibus DP eller Modbus RTU (RS485) <b>Profibus DP:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• FB1 – A1 (ingång)</li><li>• FB2 – A2 (utgång)</li><li>• FB3 – B1 (ingång)</li><li>• FB4 – B2 (utgång)</li><li>• SHL – skärm</li></ul> <b>Modbus RTU:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• FB1 – D (+)</li><li>• FB2 – D (-)</li><li>• FB3 – används inte</li><li>• FB4 – används inte</li><li>• SHL – skärm</li></ul> Du kan läsa mer om instruktioner och telegramtaggar för Modbus-konfigurationen i dokumentationen för SC4500-styrenheten.
24 VDC/1 A (P105)	24 V DC strömförsörjning för filtreringsenheterna EZ9010 och EZ9020

<sup>5</sup> Om analysatorn är i underhållsläge är fjärrstyrningen inaktiv.

**Tabell 1 Signal- och styruttag – beskrivningar (fortsättning)**

Stift	Beskrivning
STR1–STR8 (P106)	<p>Åtta digitala utgångar för Moduplex-panelen (tillval). Anslut de blottade ledningarna för respektive kanalventil på Moduplex-panelen till motsvarande STR-anlutningar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• STR1 – kanal 1</li> <li>• STR2 – kanal 2</li> <li>• ...</li> <li>• STR8 – kanal 8</li> </ul>
EXT9–EXT12 (P107)	<p>Fyra digitala utgångar för EZ9150-filtreringspanelen (tillval). Anslut de elektriska ventilerna och pumpen på EZ9150-till EXT-anlutningarna.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EXT9 – sköljventil</li> <li>• EXT10 – backspolningsventil</li> <li>• EXT11 – avtappningens överflödesventil</li> <li>• EXT12 – filtreringspump</li> </ul>
D01–D06 (P108 och P109)	<p>Sex pneumatiska utloppsventiler för EZ9150-panelen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• D01 — Provinloppsventil</li> <li>• D02 — Ventil för överflödesdränering</li> <li>• D03 — Kanal 1-valv</li> <li>• D04 — Kanal 2-valv</li> <li>• D05 — Kanal 3-valv</li> <li>• D06 — Kanal 4-valv</li> </ul>

#### 5.4.4 Ansluta till AC-ström


⚠ FARA	
	<p>Risk för elektriska stötar och brand. Se till att den medföljande kabeln och icke-låsande kontakten uppfyller tillämpliga landskodskrav.</p>

- Kontrollera att en krets brytare med tillräcklig elektrisk strömkapacitet är installerad i nätsladden.
- Se till att strömbrytaren eller nödfallsbrytaren installeras nära analysatorn så att analysatorn omedelbart kan kopplas bort från nättaggregatet om nödvändigt.
- Anslut utrustningen i enlighet med lokala, regionala och nationella elektriska föreskrifter.
- Montera den medföljande strömkabeln genom packboxen på analysatorns sida.
- Dra åt packboxen så att strömkabeln sitter säkert och husets miljöklassning bibehålls.

Anslut analysatorn till växelström med den medföljande strömkabeln. Se [Tabell 2](#) på sidan 199 och [Figur 11](#) på sidan 468.

ANMÄRKNING:
<p>Slå inte på strömmen. Dra alla elektriska anslutningar och röranslutningar innan du startar analysatorn, annars kan den skadas.</p>

**Tabell 2 Kabelinformation - växelström**

Plint	Beskrivning	Kabelfärg-Nordamerika och Kanada	Kabelfärg-EU
L	Strömförande/ledning (L)	Svart (1)	Brun
N	Nolla (N)	Vit (2)	Blå
	Skyddsjord (PE)	Grön med gul rand	Grön med gul rand

## 5.5 Rörläbena

### 5.5.1 Riktlinjer för provledning

#### ▲ FÖRSIKTIGHET



Brandfara. Denna produkt är inte avsedd för användning med lättantändliga prover.

Välj en bra, representativ provtagningspunkt för optimala instrumentprestanda. Provet måste vara representativt för hela systemet.

- Se till att provflödet är högre än flödet till analysatorn.
- Se till att provledningen är vid atmosfärstryck om analysatorn använder en peristaltisk pump för att flytta över provet till analyskärlet.
- Se till att provledningen samlar in prov från ett litet bränningskäril i närheten av analysatorn.
- Använd provledningen som medföljer. Ändra inte längden på provledningen.

Provet i bränningskärlet måste förnyas kontinuerligt. Om storleken på fasta partiklar i provet är för hög rekommenderas även provfiltrering.

### 5.5.2 Riktlinjer för dräneringsledning

#### ▲ VARNING



Brandfara. Användaren ansvarar för att se till att tillräckliga försiktighetsåtgärder vidtas när utrustningen används med metoder som använder brandfarliga vätskor. Utför försiktighetsåtgärder och följ säkerhetsanvisningar. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, kontroll av spill och läckage, ordentlig ventilation, ingen oönskad användning och att instrumentet aldrig lämnas utan tillsyn när strömmen är ansluten.

#### ▲ FÖRSIKTIGHET



Risk för kemikalieexponering. Kassera kemikalier och avfall enligt lokala, regionala och nationella lagar.

#### ANMÄRKNING:

Anslut inte utloppsledningarna till andra ledningar. Baktryck eller skador på analysatorn kan uppstå. Se till att utloppsledningarna är öppna mot luften.

#### ANMÄRKNING:

Förhindra uppkomst av baktryck och skador på analysatorn genom att se till att analysatorn är högre placerad än utloppen i anläggningen, samt att utloppsledningen hela tiden lutar nedåt. Montera utloppsledningarna med en 2,54 cm (1 tum) eller större vertikal minskning för varje 0,3 m-slanglängd (1 fot).

Analysatorn använder utloppsledningen för att släppa ut prov och reagens efter analys. Korrekt installation av dräneringsledningarna är viktig för att se till att all vätska har avlägsnats från instrumentet. Felaktig installation kan orsaka att vätska återvänder in i instrumentet och orsakar skador. En golvbrunn eller diskho lämpar sig för utloppsledningen. Den rekommenderade yttre diametern för avlopps-slangen är 32 mm. Se [Figur 12](#) på sidan 471.

- Gör dräneringsledningarna så korta som möjligt.
- Kontrollera att avtappningen är på en lägre nivå än analysatorn.
- Kontrollera att dräneringsledningarna har en konstant lutning nedåt.
- Se till att dräneringsledningarna inte har skarpa böjar och inte kläms.
- Kontrollera att dräneringsledningarna är öppna för luft och har noll i tryck.
- Se till att dräneringsledningarna är stängda mot installationrummets omgivning.
- Blockera inte och sänk inte ned utloppsledningen i vätska.

En vattenanslutning nära analysatorn rekommenderas också så att diskhon och avloppsledningen regelbundet spolas med rent vatten vilket förhindrar blockering till följd av kristallisering.

Se metod- och reagensbladet för tillämplig modell i EZ-serien för mer information om reagens som används i analysatorn. Om du använder brandfarliga reagens i analysatorn måste du följa följande säkerhetsföreskrifter:

- Töm inte avloppsledningen i golvavlopp.
- Kassera avfall enligt lokala, regionala och nationella bestämmelser.

### 5.5.3 Riktlinjer för ventilationsledning

#### ▲ VARNING



Brandfara. Användaren ansvarar för att se till att tillräckliga försiktighetsåtgärder vidtas när utrustningen används med metoder som använder brandfarliga vätskor. Utför försiktighetsåtgärder och följ säkerhetsanvisningar. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, kontroll av spill och läckage, ordentlig ventilation, ingen oönskad användning och att instrumentet aldrig lämnas utan tillsyn när strömmen är ansluten.

#### ▲ FÖRSIKTIGHET



Risk för kemikalieexponering. Kassera kemikalier och avfall enligt lokala, regionala och nationella lagar.

#### ANMÄRKNING:

Anslut inte ventilationsledningen (avgasporten) till andra ledningar. Baktryck eller skador på analysatorn kan uppstå. Se till att ventilationsledningen är öppen för luft på byggnadens utsida.

#### ANMÄRKNING:

Förhindra uppkomst av baktryck och skador på analysatorn genom att se till att analysatorn är högre placerad än ventiler i anläggningen, samt att ventilationsledningen hela tiden lutar nedåt. Montera ventilation med en 2,54 cm (1 tum) eller större vertikal minskning för varje 0,3 m-slanglängd (1 fot).

Analysatorn använder ventilationsledningen till att bibehålla atmosfäriskt tryck i analyskärlet. Det är viktigt att ventilationsledningen monteras korrekt så att ingen vätska tränger in i analyskärlet via ventilationsledningen när pumpen används. Felaktig installation kan orsaka att gas återvänder in i analysatorn och orsakar skador. Den rekommenderade ytterdiametern för ventilationsledningens huvudslang är 32 mm. Se [Figur 12](#) på sidan 471.

- Gör ventilationsledningen så kort som möjligt.
- Kontrollera att ventilationsledningarna har en konstant lutning nedåt.
- Se till att ventilationsledningen inte har skarpa böjar och inte kläms.
- Se till att ventilationsledningen är stängd för omgivningen i installationsrummet och har ett nolltryck.
- Se till att ventilationsledningen alltid är belägen högre än utloppet.
- Blockera inte och sänk inte ned ventilationsledningen i vätska.

Om du använder brandfarliga reagens i analysatorn måste du följa följande säkerhetsföreskrifter:

- Töm inte ventilationsledningen i golvavlopp.
- Kassera avfall enligt lokala, regionala och nationella bestämmelser.

### 5.5.4 Anslut analysatorn för att testa komponenterna


#### ▲ FÖRSIKTIGHET




Brandfara. Denna produkt är inte avsedd för användning med brandfarliga vätskor.

Komponenterna måste testas med avjoniserat vatten innan analysatorn med dess reagens kan sättas i drift. Se de illustrerade stegen och [Testa komponenterna](#) på sidan 206.

1. Montera de fyra klämventilslangarna enligt illustrationen i steg 1 nedan.
  - a. Tryck på den svarta knappen och tryck sedan in slangen i ventilen.
  - b. Släpp knappen när slangen är korrekt monterad.
2. Se till att dräneringsslangen är ordentligt installerad i provkärlet. Se det illustrerade steg 2 som följer.
3. Se till att nedbrytningsslangen är korrekt installerad i nedbrytningskärlet. Se det illustrerade steg 3 som följer.
4. Anslut analysatorns vätskeslangar till en stor flaska avjoniserat vatten för att testa komponenterna. Se det illustrerade steg 3 som följer. Slangen är fabriksmonterad.

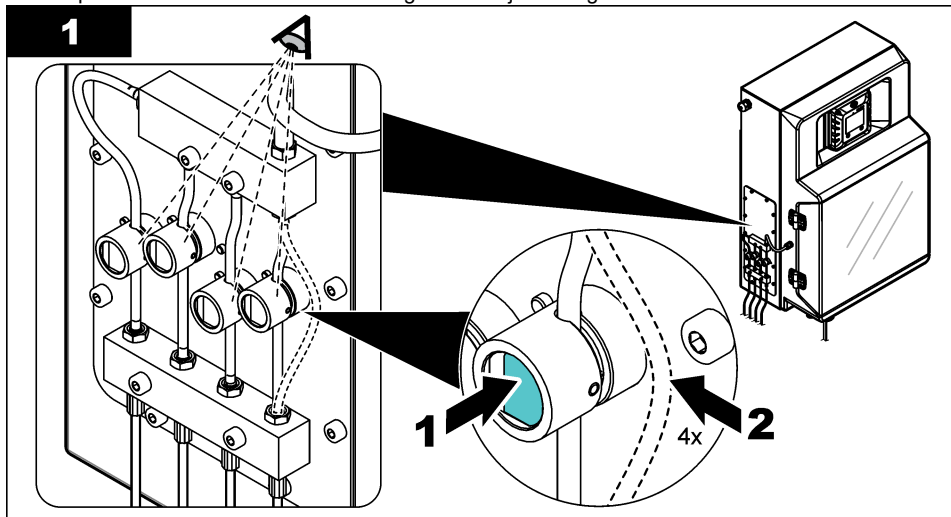




2

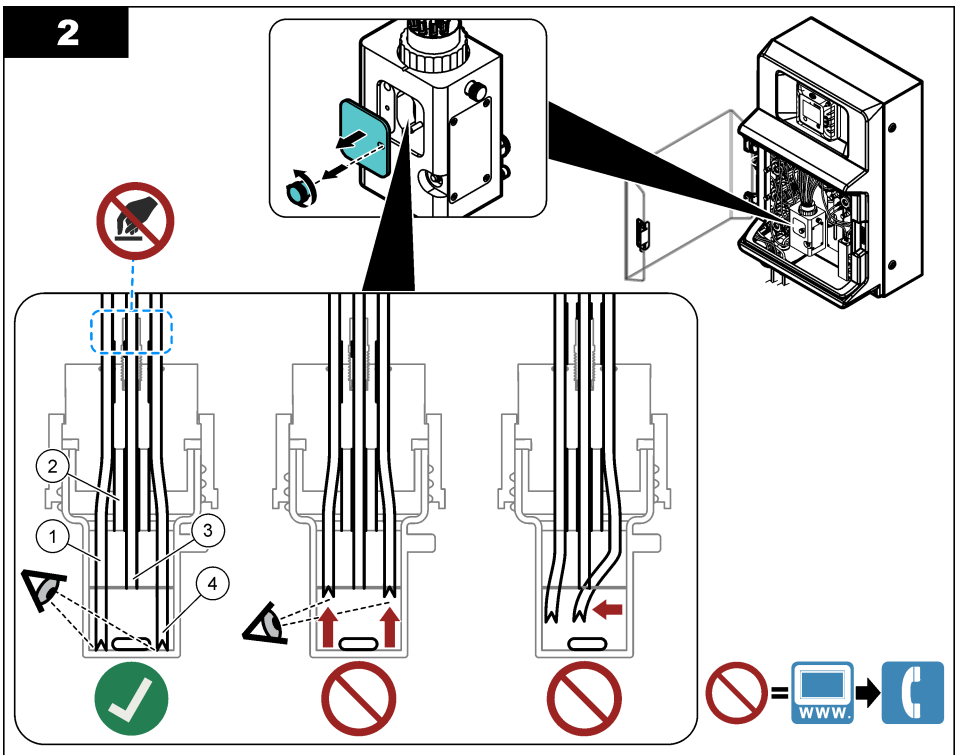

SV  
-  
SE

1 Dräneringslang	3 Provslangar
2 Slangar för reagens och ventilerung (övre slangar)	4 Nedbrytningslang


3

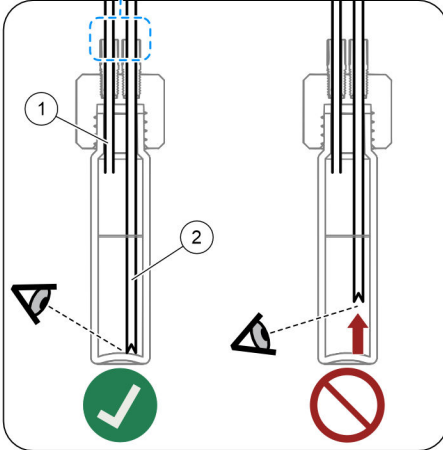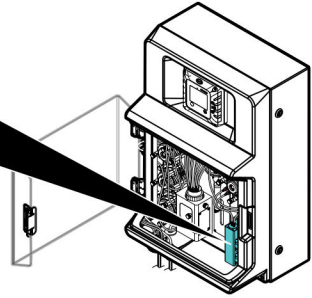

1 Ventilslang

2 Nedbrytnings slang

4

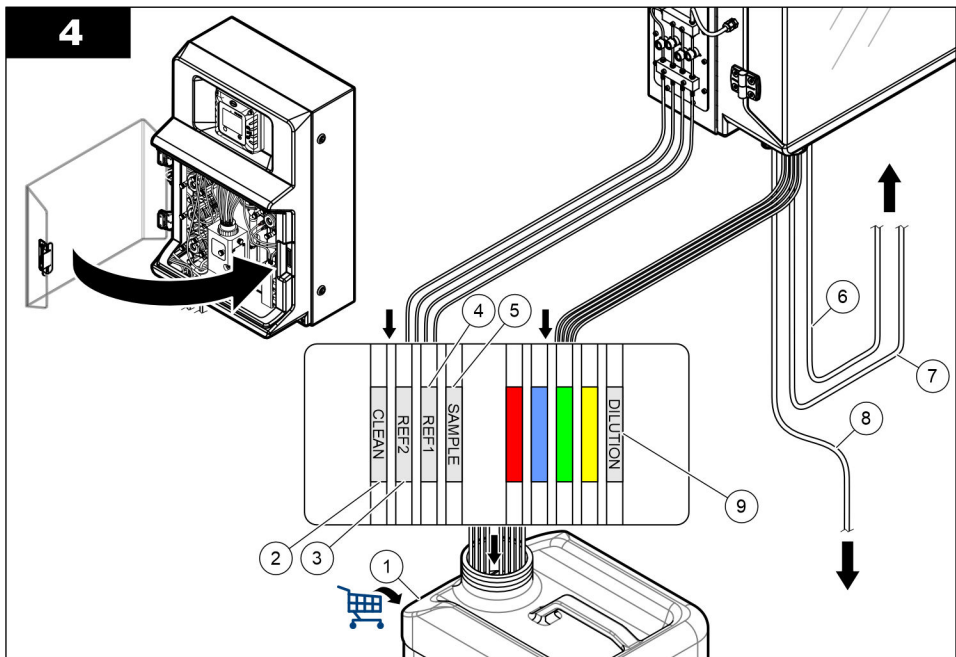

1 Avjoniserat vatten	4 Slang för Referens 1-lösning (REF1)	7 Nedbrytningsventil
2 Slang för rengöringslösning	5 Provinloppsslang	8 Dräneringsslang
3 Slang för Referens 2-lösning (REF2)	6 Ventilslang	9 Mikropumpslangar för spädning och reagens

## Avsnitt 6 Start

### 6.1 Första start

**Observera:** Se till att montering, slang- och elinstallationer är helt slutförda före start. Se [Installation](#) på sidan 196.

När analysatorn slås på första gången hjälper en startassistent till med de första stegen för att slutföra konfigurationen. Följ alla stegen för att se till att analysatorn fungerar korrekt.

**Observera:** Se till att använda korrekta reagens för det valda mätområdet. Se den utökade versionen av användarhandboken online för mer information.

- Öppna analysatorns dörr. Se [Öppna analysatorns dörr](#) på sidan 197.
- Sätt strömbrytaren i läget PÅ. Se [Figur 9](#) på sidan 461.
- Stäng analysatordörren med nyckeln som medföljer.
- Vänta tills initieringen är klar.
- Följ anvisningarna på displayen för att välja språk, tidszon, datum och tid.  
Information om hur du konfigurerar övriga styrenhetsinställningar finns i dokumentationen till SC4500-styrenheten.
- Tryck på displayen för att visa menyn **EZ2700sc**.
- Välj **Enhet, meny** för att starta startassistenten.  
Välkomstsärmen visas.
- Slutför stegen som visas på displayen för att välja tillämpligt mätområde. Tryck på **OK**.

- Om en filtreringsenhet är installerad väljer du **På**. Om inte väljer du **Av**.
- Välj antal kanaler för analysatorn. Tryck på **OK**.
- Om konfigurationen som visas på sidan sammanfattning stämmer trycker du på **OK**.  
Huvudmenyn **EZ2700sc** visas.
- Fortsätt med komponenttest Se [Testa komponenterna](#) på sidan 206.

## 6.2 Testa komponenterna

### ▲ VARNING



Klämrisk. Delar som kan klämma och orsaka skada. Vidrör inte rörliga delar.

Testa komponenterna innan du börjar använda analysatorn. Använd menyn **Underhåll** och starta de olika analysatorfunktionerna så att du ser att komponenterna fungerar.

#### Förutsättningar:

- Om analysatorn är i driftsläge väljer du **Underhåll > Starta underhållsläget**.
- Se till att slangarna för prov, reagens och lösning är i en behållare med avjoniserat vatten. Se [Anslut analysatorn för att testa komponenterna](#) på sidan 201.

#### 6.2.1 Undersök omröraren

- Ta bort ljusskyddet från fotometerenheten. Se [Figur 13](#) på sidan 472.
- Se till att omröraren når botten på provkärlet.  
*Observera: Undersök omröraren under förpumpningsåtgärden för att kontrollera att omröraren fungerar korrekt. Förpumpningsåtgärden startar om [Undersök pumparna och klämventilerna](#) på sidan 206.*
- Montera ljusskyddet på fotometern.

#### 6.2.2 Undersök pumparna och klämventilerna

- Kontrollera att pumparna och klämventilerna fungerar som de och att de inte läcker.
- Se till att analyskärlet fylls med avjoniserat vatten. Se [Figur 14](#) på sidan 475.
- Se till att avjoniserat vatten rinner ut ur dräneringsslangen.
- Välj **UnderhållStarta förpumpning** och förpumpa alla vätskor separat.  
Om en läcka inträffar ska du undersöka alla anslutningar och läsa i den utökade versionen av användarhandboken online för mer information.
  - Välj **Förpumpa, referens 1** och tryck på **OK**.
  - Välj **Förpumpa, referens 2** och tryck på **OK**.
  - Välj **Förpumpa rengöringslösning** och tryck på **OK**.
  - Välj **Förpumpningssköljning** och tryck på **OK**.
  - Välj **Förpumpa dispenser** och tryck på **OK**.
  - Välj **Fyll på kanal > Fyll på alla kanaler** och tryck på **OK**.  
Varje förpumpningsprocedur stoppas automatiskt när proceduren är slutförd.

#### 6.2.3 Undersök mikropumparna

Kontrollera läckor och luftbubblor i mikropumparna.

- Ta bort ljusskyddet från fotometern.
- Välj **Underhåll > Starta förpumpning > Förpumpa alla reagenser**.
- Se till att avjoniserat vatten förs in i mikropumpen via respektive mikropumpslang (reagens).  
Sedan ska det flöda kontinuerligt till analyskärlet utan luftbubblor. Se [Figur 15](#) på sidan 475.

- Om mikropumparna inte fungerar korrekt (bubblor i slangen) använder du proceduren med sprutan för att trycka in avjoniserat vatten i den aktuella slangen för att avlägsna bubblorna. Se [Figur 16](#) på sidan 476.
- Montera ljusskyddet på fotometern.

#### 6.2.4 Utför en fotometerkontroll

Se till att analyskärlets utsida är ren före fotometerkontrollen så att kontrollen kan utföras på bästa sätt. Information om att rengöra analysatorkomponenter finns i den utökade versionen av användarhandboken online.

- Tryck på huvudmenyikonen och välj sedan **Enheter**.
- Välj **EZ2700sc**.
- Bläddra ned till slutet av skärmen och välj **Enhet, meny**.
- Välj **Underhåll > Fotometerkontroll**.
- Starta mätningen genom att trycka på **OK**.  
När mörk kalibrering är färdig visas resultatet på displayen.
- Tryck på **OK** för att fortsätta.
- Kontrollera att "REF1"-slangarna är anslutna till en behållare med avjoniserat vatten. Se till att ljusskyddet är monterat på rätt sätt. Se [Figur 18](#) på sidan 479.
- Tryck på **OK**.  
Vänta tills analyskärlet är fullt.
- Använd en skruvmejsel och justera spänningen för givarens utgång till 9 V. Se [Figur 17](#) på sidan 476.
- Vänta tills värdet 9 V visas på skärmen. Tryck sedan på **OK**.
- Tryck på **OK** för att fortsätta.

#### 6.3 Utföra ett insignaltest

Utför ett test av de digitala ingångarna innan analysatorn tas i drift.

**Förutsättningar:** Anslut de digitala ingångarna till en extern spänningsfri kontakt (24 VDC).

Testa de digitala ingångssignalerna och analoga utgångssignalerna så här:

- Tryck på huvudmenyikonen och välj sedan **Enheter**.
- Välj **EZ2700sc**.
- Bläddra ned till slutet av skärmen och välj **Enhet, meny**.
- Välj **Diagnostik > Signaler**.  
Signalerna vid de digitala ingångarna visas.
- Jämför de digitala ingångarnas status på skärmen med de spänningar som matas till de digitala ingångarna (24 V = På, 0 V = Av).

#### 6.4 Utföra ett utsignaltest

Utför ett test av de analoga utgångarna innan analysatorn tas i drift.

**Förutsättningar:** Konfigurera de analoga utgångarna (AO1–AO8, P101) och välj den kanal mätning som respektive analog utgång representerar. Se den utökade versionen av användarhandboken online för mer information.

Testa de analoga utgångssignalerna så här:

1. Tryck på huvdmenyikonen.
2. Välj **Utgångar > mA-utgångar AOC > Test/underhåll**.

Alternativ	Beskrivning
<b>Funktionstest</b>	Testar utgångarna på vald modul.
<b>Status för utgång</b>	Visar utgångarnas status på vald modul.

3. Använd en multimeter och mät mA-värdet vid respektive analog utgång.
4. Jämför det mA-värde som uppmätts vid de analoga utgångarna med de förväntade mA-värdena.

## 6.5 Ställ in kanalsekvensen

Välj i vilken sekvens kanalerna ska mätas, hur många gånger varje kanal mäts och väntetiden innan en kanal mäts. Ange högst 16 rader med högst 16 cykler vardera.

1. Tryck på huvdmenyikonen och välj sedan **Enheter**.
2. Välj **EZ2700sc**.
3. Bläddra ned till slutet av skärmen och välj **Enhet, meny**.
4. Om analysatorn är i driftsläge väljer du **Underhåll > Starta underhållsläget**. Vänta till analysatorn är i underhållsläget.
5. Välj **Konfiguration > Inställning av kanalsekvens**.
6. Använd pilarna i sidofältet och välj en position (nummer i sekvensen) och tryck på **OK** för att konfigurera positionen.
7. Välj ett alternativ.

Alternativ	Beskrivning
<b>Välj</b>	Väljer kanal eller väntetid.
<b>Antal mätningar</b>	Anger antal mätningar för en kanal.
<b>Väntetid</b>	Anger väntetiden för den valda kanalen.

8. Tryck på **OK** för att spara ändringarna.

## 6.6 Anslut lösningarna och provet

### ▲ FÖRSIKTIGHET



Risk för kemikalieexponering. Följ laboratoriets säkerhetsanvisningar och bär all personlig skyddsutrustning som krävs vid hantering av kemikalier. Läs aktuella datablad (MSDS/SDS) om säkerhetsanvisningar.

### ▲ FÖRSIKTIGHET



Risk för kemikalieexponering. Kassera kemikalier och avfall enligt lokala, regionala och nationella lagar.

### ▲ FÖRSIKTIGHET



Brandfara. Denna produkt är inte avsedd för användning med brandfarliga vätskor.

Reagensbehållarna medföljer analysatorn. Se [Figur 18](#) på sidan 479. Behållarna för referens 1-lösning och referens 2-lösning och avjoniserat vatten tillhandahålls av användaren. Fler behållare kan köpas från tillverkaren.

## Installera behållarna

- så nära analysatorn som möjligt
- 1 meter under analysatorns botten

Se [Figur 18](#) på sidan 479 för montering av behållare.

Reagens och lösningar tillhandahålls av användaren. Använd endast reagens från ett certifierat företag eller som tillverkaren har angivit. Alternativt kan användaren förbereda reagens. Följ instruktionerna i metod- och reagensbladet för tillämplig modell som finns på tillverkarens webbplats.

Slangen är fabriksmonterad. Läs etiketten på varje ledning för att identifiera rätt anslutning vid ledningsdraging. Se tillämpligt metod- och reagensblad för modellen som finns på tillverkarens webbplats för korrekta reagens, lösningar och standarder.

1. När du har testat komponenterna monterar du slangarna för CLEAN (rengöringslösning), REF1 (Referens 1-lösning) och REF2 (Referens 2-lösning) i motsvarande behållare. Se [Figur 18](#) på sidan 479.
2. Montera den färgkodade reagensslangen i reagensbehållaren med motsvarande färg på etiketten.
3. Anslut provkällan (eller provutloppet på Moduplex-panelen eller filterpanelen) till analysatorns provinloppsslang. Läs i [Figur 18](#) på sidan 479.
4. Tryck på huvudmenyikonen och välj sedan **Enheter**.
5. Välj **EZ2700sc**.
6. Bläddra ned till slutet av skärmen och välj **Enhet, meny**.
7. Välj **Underhåll > Starta förpumpning > Förpumpa allt**.

## 6.7 Validera innan första start

Utför validering för att kontrollera så att mätningarna ligger inom toleransområdet. Se den utökade versionen av användarhandboken online för mer information.

1. Tryck på huvudmenyikonen och välj sedan **Enheter**.
2. Välj **EZ2700sc**.
3. Bläddra ned till slutet av skärmen och välj **Enhet, meny**.
4. Välj **Kalibrering > Validering > Starta validering** för att starta en validering.  
Valideringen mäter det avjoniserade vattnet i referensflaska 2.
5. Välj ett alternativ för att visa resultaten:
  - **Kalibrering > Validering > Valideringshistorik**
  - **Diagnostik > Historiska data > Validering**

## 6.8 Starta analysatorn

Så här startar du analysatorn:

1. Tryck på huvudmenyikonen och välj sedan **Enheter**.
2. Välj **EZ2700sc**.
3. Bläddra ned till slutet av skärmen och välj **Enhet, meny**.
4. Välj **Underhåll > Starta driftläget**.

# Sisällysluettelo

1 Lisätiedot sivulla 210

2 Tuotteen yleiskuvaus sivulla 210

3 Tekniset tiedot sivulla 211

4 Yleistietoa sivulla 212

5 Asentaminen sivulla 213

6 Käynnistys sivulla 223

## Osa 1 Lisätiedot

Peruskäyttöopas sisältää käyttöönottoa varten riittävät tiedot. Laajennettu käyttöopas on saatavilla verkossa, ja se sisältää lisätietoja.

### VAARA



Useita vaaroja! Lisätietoja on jäljempänä esitetyissä laajennetun käyttöoppaan yksittäisissä kohdissa.

- Käyttöliittymä ja selaaminen
- Käyttö
- Maintenance (Huolto)
- Vianmääritys
- Varaosat

Skannaa seuraavat QR-koodit siirtyäksesi laajennettuun käyttöoppaaseen.



Eurooppalaiset kielet



Amerikan ja Aasian kielet

## Osa 2 Tuotteen yleiskuvaus

Hach EZ2700sc-analysaattori on verkossa toimiva laite, joka mittaa yhtä paramteria teollisuus- ja luonnonvesistä otetuista näytteistä. Katso [Kuva 1](#) sivulla 438, [Kuva 2](#) sivulla 442 ja [Kuva 3](#) sivulla 446.

Analysaattori on kolorimetrista mittaustekniikkaa käyttävä, verkkoyhteyteen liitettävä analysaattori, jolla voidaan analysoida vesinäytteen yleiset ominaisuudet (esim. nitraatti, fosfaatti). Analysaattori mahdollistaa etäkäynnistyksen, automaattisen vahvistuksen, automaattisen kalibroinnin, automaattisen puhdistuksen ja Modbusin lisätoiminnot.

Näytevesi tulee analysaattoriin näyteletkun kautta. Näytteen ja reagenssien siirtämisessä analytiikkapaneelin mittauskennoon käytetään analysaattorin pumppuja, venttiileitä ja ruiskuja. Kun analyysiprosessi astiassa on valmis, analysaattori poistaa näytteen tyhjennysletkua pitkin. Analyysitulokset näytetään SC4500-ohjaimen näytössä. SC4500-ohjain tallentaa analysaattorin tiedot (datalogin, tapahtumalokin, asetuslokin ja huoltolokin). Käytä analysaattoria ja tee sen määrittäykset SC4500-ohjaimen avulla.

Kun haluat lisätä analysaattorin mittaamien näytevirtojen (kanavien) määrää (2, 4 tai 8), osta usean virran Moduplex-paneeli analysaattorin kanssa.

Osta EZ9010-, EZ9020-, EZ9150-, EZ9200- tai EZ9250-suodatinpaneeli analysaattorin kanssa näytteen esikäsittelyä (suodatusta, asettumista) varten.

## Osa 3 Tekniset tiedot

Tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta.

Ominaisuus	Tiedot
Mitat (L x K x S)	460 x 688 x 340 mm (18,1 x 27,1 x 13,4 tuumaa)
Kotelo	IP44; ABS, PMMA ja pinnoitettu teräs
Näyttö	IP66, 3,5 tuuman TFT-värinäyttö ja kapasitiivinen kosketuslevy
Paino	40 kg (88 lb)
Tehovaatimukset	100–240 VAC ±10%, 50/60 Hz
Tehonkulutus	Enintään 240 VA
Korkeus	Enintään 2000 m (6560 jalkaa)
Ylijänniteluokka	II
Ympäristöolosuhteet	Vain sisäkäyttöön
Ympäristöhaittaluokka	2
Käyttölämpötila	10–30 °C (50–86 °F), suhteellinen ilmankosteus 5–95 %, tiivistymätön, syövyttämätön
Säilytyslämpötila	–20...60 °C (–4...140 °F); enintään 95 %:n suhteellinen kosteus, ei tiivistymistä
Näytetulot	Yksi
Näytteen paine	Ulkoisella ylivuotoastialla (avoin ilmanpaineelle)
Näytteen virtausnopeus	100–300 mL/min
Näytteen lämpötila	10...30 °C (50...86 °F)
Näytteen laatu	<100 µm:n hiukkaset, enintään <0,1 g/L Sameus <50 NTU
Ilmanpoisto syövyttävissä ympäristöissä	0,2 bar (20 kPa tai 3 psi); kuiva ja puhdas ilma
Viemäri	Ilmanpaine, ilmanpoistoaukko, halkaisija vähintään 32 mm
Maadoitusliitäntä	Kuiva ja puhdas maadoitusnapa, pieni impedanssi (<1 Ω) ja maadoituskaapeli >2,5 mm <sup>2</sup> (13 AWG)
Analogilähdöt	Enintään kahdeksan 0–20 mA:n (tai 4–20 mA:n) analogista lähtöä <b>Huomautus:</b> Analogilähdöt antavat virtaa virtasiimukalle. Koskettimet eivät voi saada virtaa SCADA- tai PLC-järjestelmistä.
Digitaalitulot	Seitsemän digitaalista tuloa: kaksi etäkäynnistyksen digitaalista tuloa. Muut digitaaliset tulot ovat tulevaa käyttöä varten.
Digitaaliset lähdöt	Neijä jännitteellistä digitaalista lähtöä EZ9150-paneelin venttiileille ja pumpeille; kahdeksan jännitteellistä digitaalista lähtöä Moduplex-paneelin venttiileille; 24 VDC, 500 mA.
Releet	Viisi jännitteetöntä kosketinta (FCT), suurin sallittu kuormitus 24 VDC, 0,5 A (resistiivinen kuorma)
Ethernet-liitännät	Claros Ethernet -liitäntä ja Modbus TCP/IP Ethernet -liitin; LAN-versio; 10/100 Mbit/s, vaihtoehtoisesti Profinet tai Ethernet IP
RS485-tiedonsiirto	Profibus DP tai Modbus RTU

FI

<sup>2</sup> Katso tiedot Ethernetin tai Modbusin määrittämiseen SC4500-ohjaimen asiakirjoista.

Ominaisuus	Tiedot
Sertifiointit	CE-, ETL-sertifioitu UL- ja CSA-turvallisuusstandardien mukaisesti, UKCA
Takuu	1 vuosi (EU: 2 vuotta)

## Osa 4 Yleistietoa

Valmistaja ei ole missään tilanteessa vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen epäasianmukaisesta käytöstä tai käyttöoppaan ohjeiden noudattamatta jättämisestä. Valmistaja varaa oikeuden tehdä tähän käyttöohjeeseen ja kuvaamaan tuotteeseen muutoksia koska tahansa ilman eri ilmoitusta tai velvoitteita. Päivitetyt käyttöohjeet ovat saatavilla valmistajan verkkosivuilla.

### 4.1 Turvallisuustiedot

Valmistaja ei ole vastuussa mistään virheellisestä käytöstä aiheuvista vahingoista mukaan lukien rajoituksetta suorista, satunnaisista ja välillisistä vahingoista. Valmistaja sanoutuu irti tällaisista vahingoista soveltuvien lakien sallimissa rajoissa. Käyttäjä on yksin vastuussa sovellukseen liittyvien kriittisten riskien arvioinnista ja sellaisten asianmukaisten mekanismien asentamisesta, jotka suojaavat prosesseja laitteen toimintahäiriön aikana.

Lue nämä käyttöohjeet kokonaan ennen tämän laitteen pakkauksesta purkamista, asennusta tai käyttöä. Kiinnitä huomiota kaikkiin vaara- ja varotoimilausekkeisiin. Varoitusten noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavia vammoja käyttäjälle tai vaurioittaa laitetta.

Jos laitetta käytetään tavalla, jota valmistaja ei ole määritellyt, laitteen antama suojaus voi heikentyä. Laitetta ei saa asentaa tai käyttää muulla tavoin kuin näiden ohjeiden mukaisesti.

#### 4.1.1 Vaaratilanteiden merkintä

##### ▲ VAARA

Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tai välittömän vaaran aiheuttavasta tilanteesta, joka aiheuttaa kuoleman tai vakavan vamman.

##### ▲ VAROITUS

Ilmoittaa potentiaalisesti tai uhkaavasti vaarallisen tilanteen, joka, jos sitä ei vältetä, voi johtaa kuolemaan tai vakavaan vammaan.

##### ▲ VAROTOIMI




Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa lievän tai kohtalaisen vamman.




##### HUOMAUTUS

Ilmoittaa tilanteesta, joka saattaa aiheuttaa vahinkoa laitteelle. Tieto, joka vaatii erityistä huomiota.

#### 4.1.2 Varoitustarrat


Lue kaikki laitteen tarrat ja merkinnät. Ohjeiden laiminlyönnistä voi seurata henkilövamma tai laitevaurio. Laitteen symboliin viitataan käyttöohjeessa, ja siihen on liitetty varoitus.

	Tämä on turvahälytysymboli. Noudata symboliin jälkeen annettuja turvavaroituksia, jotta vältyt mahdollisilta vammoilta. Jos tarralla on laitteessa, laitteen käyttö- tai turvallisuustiedot on annettu laitteen käyttöohjeessa.
	Tämä symboli varoittaa kemiallisten vahinkojen vaarasta ja ilmaisee, että ainoastaan kemikaalien kanssa työskentelyyn pätevät ja asianmukaisesti koulutetut henkilöt saavat käsitellä kemikaaleja tai huoltaa laitteen kemikaalinäytinjärjestelmiä.
	Tämä symboli ilmoittaa sähköiskun ja/tai hengenvaarallisen sähköiskun vaarasta.










	Tämä symboli ilmoittaa, että laitteet ovat herkkiä sähköstaattisille purkauksille (ESD) ja että laitteita on varottava vahingoittamasta.
	Tämä symboli tarkoittaa, että merkityssä tuotteessa on käytettävä suojaavaa maadoitusta. Jos laitteen virtajohdossa ei ole maadoituspistoketta, yhdistä laite suojamaajohtimen liittimeen.
	Sähkölaitteita, joissa on tämä symboli, ei saa hävittää yleisille tai kotitalousjätteille tarkoitetuissa eurooppalaisissa jätteiden hävitysjärjestelmissä. Vanhat tai käytöstä poistetut laitteet voi palauttaa maksutta valmistajalle hävittämistä varten.

FI

#### 4.1.3 Kemiallinen ja biologinen turvallisuus

<b>⚠ VAARA</b>	
	Kemialliset tai biologiset vaarat. Jos laitteella valvotaan sellaista käsittelyprosessia tai kemiallista syöttöjärjestelmää, jota koskevat viranomaissäädökset tai yleiseen terveyteen, yleiseen turvallisuuteen tai elintarvikkeiden/juomien valmistamiseen tai käsittelyyn liittyvät valvontavaatimukset, soveltuvien säädösten noudattaminen on käyttäjän vastuulla. Käyttäjän on myös varmistettava, että laitteen toimintahäiriön aikana on käytettävissä säädösten mukaiset riittävät ja asianmukaiset varamekanismit.

#### 4.2 Kuvissa käytetyt kuvakkeet

				
Valmistajan toimittamat osat	Käyttäjän hankkimat osat	Katso	Suorita vaiheet käänteisesti	
				
Edellyttää kahta henkilöä	Kuuntele	Käytä vain sormia	Älä käytä työkaluja	Älä kosketa

#### 4.3 Käyttötarkoitus

Hachin EZ-sarjan analysaattorit on tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden on mitattava jatkuvasti veden laatuparametreja teollisuuden ja ympäristön käyttösovelluksista saatujen näytteiden avulla. Hach EZ -sarjan analysaattorit eivät käsittele tai muuta vettä, eikä niitä käytetä ohjaustoimiin.

#### 4.4 Tuotteen osat

Varmista, että laitteen mukana on toimitettu kaikki tarvittavat osat. Katso [Kuva 4](#) sivulla 450. Jos jokin tarvikkeista puuttuu tai on viallinen, ota välittömästi yhteys valmistajaan tai toimittajaan.

### Osa 5 Asentaminen

<b>⚠ VAARA</b>	
	Useita vaaroja. Vain ammattitaitoinen henkilö saa suorittaa käyttöohjeen tässä osassa kuvatut tehtävät.

## 5.1 Asennusohjeet

### ▲ VAROITUS



Tulipalon vaara. Käyttäjä on vastuussa riittävästä turvatoimista silloin, kun laitteistoa käytetään syttyviä nesteitä käyttäviin menetelmiin kanssa. Varmista, että oikeita turvallisuusmääräyksiä ja turvatoimia noudatetaan. Näihin kuuluu muun muassa läikymisen ja vuotamisen seuranta, kunnollinen tuuletus, valvomattoman käytön kieltäminen ja laitteiston jatkuva valvonta aina virran ollessa kytkettynä.

### ▲ VAROTOIMI



Kemikaalille altistumisen vaara. Noudata laboratorion turvallisuusohjeita ja käytä käsiteltäville kemikaaleille soveltuvia suojavarusteita. Lue turvallisuusprotokollat ajan tasalla olevista käyttöturvatiiedoista (MSDS/SDS).

### ▲ VAROTOIMI



Kemikaalille altistumisen vaara. Hävitä kemikaalit ja muut jätteet paikallisten ja kansallisten säädösten mukaisesti.

- Analyyttori on asennettava turvalliseen paikkaan sisätiloihin.
- Asenna analyyttori ympäristöön, jossa se on suojattu syövyttäviltä nesteiltä.
- Asenna analyyttori puhtaaseen ja kuivaan, hyvin ilmastoituun tilaan, jonka lämpötila pysyy vakaana.
- Asenna analyyttori mahdollisimman lähelle näytteenottopistettä.
- Analyyttoria ei saa asentaa suoraan auringonpaisteeseen eikä lähelle lämmönlähdettä.
- Huolehdi, että letkuliitännöiden ja sähkökytkentöiden tekemiselle on riittävästi tilaa.
- Huolehdi, että analyyttorin edessä on riittävästi tilaa analyyttorin luukun avaamiseen. Katso kohtaa [Analyyttorin mitat](#) sivulla 214.
- Varmista, että asennusympäristön olosuhteet vastaavat käyttöympäristölle asetettuja vaatimuksia. Katso kohtaa [Tekniset tiedot](#) sivulla 211.

Vaikka analyyttoria ei ole tarkoitettu käytettäväksi herkästi syttyvien näytteiden kanssa, joissakin EZ-analyyttoreissa käytetään herkästi syttyviä reagensseja. Katso lisätietoja analyyttorissa käytetystä reagentista kunkin EZ-sarjan mallin Method & Reagent Sheet -tietolomakkeesta. Jos analyyttorissa käytetään herkästi syttyviä reagensseja, noudata seuraavia varotoimia:


- Pidä analyyttori etäällä lämmöstä, kipinöistä ja avotulesta.
- Älä syö, juo tai tupakoi analyyttorin lähellä.
- Käytä paikallista poistoilmajärjestelmää.
- Käytä kipinöitä ja räjähdystä kestäviä laitteita ja valaisujärjestelmää.
- Estä sähköstaattiset purkaukset. Katso [Huomattavaa sähköstaattisesta varauksesta](#) sivulla 215.
- Puhdista ja kuivaa laite täysin ennen käyttöä.
- Pese kädet ennen taukoja ja työpäivän lopussa.
- Riisu kontaminoitunut vaatetus. Pese vaatteet ennen niiden käyttämistä uudelleen.
- Näitä nesteitä on käsiteltävä sallittuja altistusrajoja koskevien paikallisten viranomaisten vaatimusten mukaisesti.

## 5.2 Analyyttorin mitat

Katso analyyttorin mitat kohdasta [Kuva 5](#) sivulla 454.

## 5.3 Mekaaninen asennus

### 5.3.1 Laitteen kiinnittäminen seinään

▲ VAROITUS	
	Henkilövahinkojen vaara. Varmista, että seinäkiinnitys kannattaa laitteen painon nelinkertaisesti.

▲ VAROITUS	
	Henkilövahinkojen vaara. Laitteet tai komponentit ovat raskaita. Älä asenna tai siirrä niitä yksin.

▲ VAROITUS	
	Henkilövahinkojen vaara. Laite on painava. Varmista, että laite on tukevasti kiinni seinässä, pöydässä tai lattiasa, jotta käyttö on turvallista.

Kiinnitä laite toimitukseen sisältyvillä kiinnikkeillä pystyasentoon tasaiselle ja pystysuoralle seinäpinnalle. Katso kohtaa [Kuva 6](#) sivulla 456.

Asenna laite sellaiseen paikkaan, jossa käyttäjä voi helposti irrottaa sen virtalähteestä.

Huolehdi, että analysaattorin alla on riittävästi tilaa pulloille.

Kiinnitysvälineiden hankkiminen on käyttäjän vastuulla. Varmista, että seinäkiinnike kestää tarpeeksi kuormaa (noin 160 kg, 353 lb). Kiinnittimien on oltava hyväksytyjä seinälle sen ominaisuuksien perusteella.


### 5.3.2 Avaa analysaattorin ovi

Käytä mukana toimitettua näppäintä lukitsemalla kaksi lukkoa analysaattorin puolella. Katso kohtaa [Kuva 7](#) sivulla 456. Varmista, että luukku suljetaan ennen käyttöä, jotta kotelon ympäristö- ja turvallisuusluokitus säilyvät.

## 5.4 Sähköasennus

▲ VAARA	
	Tappavan sähköiskun vaara. Laitteesta on aina katkaistava virta ennen sähköliitännöiden tekemistä.

### 5.4.1 Huomattavaa sähköstaattisesta varauksesta

HUOMAUTUS	
	Mittarin rikkoutumisvaara. Herkät sisäosien sähkökomponentit voivat vahingoittua staattisen sähköin voimasta, mikä johtaa laitteen heikentyneeseen suorituskykyyn ja jopa rikkoutumiseen.

Estä sähköstaattisen varauksen aiheuttamat laitevauriot näiden ohjeiden avulla:

- Poista staattinen sähkö koskettamalla maadoitettua metallipintaa, kuten laitteen runkoa, metallikanavaa tai -putkea.
- Vältä tarpeettomia liikkeitä. Kuljeta staattiselle sähkölle alltiita komponentteja antistaattisissa säiliöissä tai pakkauksissa.
- Käytä rannehihnaa, joka on kytketty johdolla maadoitukseen.
- Työskentele staattiselta sähköltä suojatulla alueella ja käytä staattiselta sähköltä suojaavia lattia- ja työpenkkialustoja.

## 5.4.2 Sähköliitännät

Vie ulkoisten laitteiden kaapelit kaapeliläpivientien läpi. Katso [Kuva 8](#) sivulla 458. Pidä tulpat niissä kaapeliläpivienneissä, joita ei käytetä.

[Kuva 9](#) sivulla 461 näyttää osat, jotka ovat analyysointin sisällä. Virtakytkin on katkaisin, joka katkaisee verkkovirran syötön automaattisesti ylivirta- (esimerkiksi oikosulku) tai ylijännitetilanteessa.

## 5.4.3 Ulkoisten laitteiden liittäminen

Liitä analyysointin kanssa käytettävät ulkoiset laitteet analyysointin signaali- ja ohjausliitännöihin. Katso kohtia [Kuva 10](#) sivulla 464 ja [Taulukko 1](#) sivulla 216.

**Taulukko 1 Signaali- ja ohjausliitännät – kuvaukset**

Nasta	Kuvaus
AO1–AO8 (P101)	Kahdeksan analogista lähtöä ulkoisten laitteiden ohjaamiseen. Katso lisätietoja laajennetun käyttöoppaan verkkoversiosta.
FCT1–FCT5 (P102)	Viisi relettä (jännitteettömät koskettimet). Enimmäiskuorma on 24 VDC, 0,5 A. <ul style="list-style-type: none"><li>• FCT1 — Toimintahäiriöhälytys</li><li>• FCT2 — Huoltohälytys</li><li>• FCT3 — Analyysointin valmis</li><li>• FCT4 ja FCT5 — Tulevaan käyttöön</li></ul>
DI1–DI7 (P103)	Seitsemän digitaalista lähtöä analyysointin etäohjaukseen. <sup>5</sup> Liitä digitaaliset lähdöt ulkoiseen jännitteettömään koskettimeen (24 VDC), mikä saa analyysointin käynnistämään kanavan mittauksen. <ul style="list-style-type: none"><li>• DI1 — Kanavan 1 etäkäynnistys</li><li>• DI2 — Kanavan 2 etäkäynnistys</li><li>• DI3–DI7 — Tulevaan käyttöön</li></ul>
FB1–FB4 (P104)	Profibus DP- tai Modbus RTU (RS485) -liitännät <b>Profibus DP:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• FB1—A1 (tulo)</li><li>• FB2—A2 (lähtö)</li><li>• FB3—B1 (tulo)</li><li>• FB4—B2 (lähtö)</li><li>• SHL – suojaus</li></ul> <b>Modbus RTU:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• FB1—D (+)</li><li>• FB2—D (-)</li><li>• FB3 — ei käytössä</li><li>• FB4 — ei käytössä</li><li>• SHL – suojaus</li></ul> Katso Modbus-määrittelyohjeet ja sähkömääritteet SC4500-ohjaimen asiakirjoista.
24VDC/1A (P105)	EZ9010- ja EZ9020-suodatinyksikköjen 24 VDC:n virtalähde
STR1–STR8 (P106)	Kahdeksan digitaalista lähtöä valinnaiselle Moduplex-paneelille. Kytke kunkin kanavan paljaat johdot Moduplex-paneelista niiden STR-liittimiin. <ul style="list-style-type: none"><li>• STR1 — kanava 1</li><li>• STR2 — kanava 2</li><li>• ...</li><li>• STR8 — kanava 8</li></ul>

<sup>5</sup> Jos analyysointin on huoltotilassa, etäohjaus ei ole käytössä.

**Taulukko 1 Signaali- ja ohjausliitännät – kuvaukset (jatk.)**

Nasta	Kuvaus
EXT9–EXT12 (P107)	Neljä digitaalista lähtöä valinnaiselle EZ9150-suodatinpaneelille. Kytke EZ9150-suodatinpaneelin sähköventtiilit ja pumppu EXT-liittimiin. <ul style="list-style-type: none"> <li>• EXT9 — huuhteluventtiili</li> <li>• EXT10 — takaisinvirtausventtiili</li> <li>• EXT11 — tyhjennyksen ylivuotoventtiili</li> <li>• EXT12 — suodatuspumppu</li> </ul>
D01–D06 (P108 ja P109)	Kuusi paineilmaventtiililähtöä EZ9150-paneelille. <ul style="list-style-type: none"> <li>• D01 — näytteen tuloventtiili</li> <li>• D02 — tyhjennyksen ylivuotoventtiili</li> <li>• D03 — kanavan 1 venttiili</li> <li>• D04 — kanavan 2 venttiili</li> <li>• D05 — kanavan 3 venttiili</li> <li>• D06 — kanavan 4 venttiili</li> </ul>

FI

#### 5.4.4 Kytkeminen verkkovirtaan

### ⚠ VAARA



Sähköiskun ja tulipalon vaara. Varmista, että laitteen mukana toimitettava virtajohto ja lukittu pistoke täyttävät soveltuvat maakohtaiset vaatimukset.


- Varmista, että linjaan on asennettu katkaisin, jonka virtakapasiteetti on riittävä.
- Varmista, että analyysointilaitteen läheisyyteen on asennettu virrankatkaisin tai hätäkytkin, jotta analyysointilaitteita voidaan tarvittaessa kytkeä heti irti virransyötöstä.
- Liitä laite paikallisten tai kansallisten sähköturvallisuusmääräysten mukaisesti.
- Asenna toimitukseen sisältyvä virtajohto analyysointilaitteen sivussa olevan kaapeliläpiviennin läpi.
- Kiristä kaapeliläpivienni, jotta virtajohto pysyy varmasti paikallaan ja jotta koteloinnin ympäristöluokitus säilyy ennallaan.

Kytke analyysointilaitteita verkkovirtaan sen mukana toimitetulla virtajohtolla. Katso [Taulukko 2](#) sivulla 217 ja [Kuva 11](#) sivulla 468.

### HUOMAUTUS


Älä aseta virtakytkintä ON-asentoon. Tee kaikki sähkö- ja putkiliitännät ennen käynnistystä, muuten analyysointilaitteita voi vahingoittua.

**Taulukko 2 Johdotus — verkkovirta (AC)**

Liitin	Kuvaus	Kaapelin väri-Pohjois-Amerikka ja Kanada	Kaapelin väri-EU
L	Latautunut/jännitteinen (L)	Musta (1)	Ruskea
N	Nolla (N)	Valkoinen (2)	Sininen
	Suojamaadoitus (PE)	Vihreä, jossa keltainen raita	Vihreä, jossa keltainen raita

## 5.5 Letkujen kytkeminen

### 5.5.1 Näytteenottoletkuja koskevat ohjeet


▲ VAROTOIMI	
	Tulipalon vaara. Laitetta ei ole suunniteltu käytettäväksi herkästi syttyvien näyte kanssa.


Mittauslaite toimii parhaiten, kun näytteenottoaika on hyvin valittu. Näytteen on oltava koko järjestelmää edustava.

- Varmista, että näytteen virtaus on suurempi kuin virtaus analysaattoriin.
- Jos analysaattori käyttää näytteen vetämisessä analysointiasiaan peristalttista pumppua, varmista, että näytteenottoletkussa vallitsee normaali ilmanpaine.
- Huolehdi, että näytteenottoletku kerää näytteen lähellä analysaattoria sijaitsevasta pienestä ylivuotoastiasta.
- Käytä mukana toimitettua näyteputkea. Älä muuta näyteputken pituutta.

Ylivuotoastiassa olevan näytteen on vaihdettava jatkuvasti. Näytteen suodattamista suositellaan, jos näytteen sisältämän kiinteän aineksen koko on liian suuri.

### 5.5.2 Poistoletkuja koskevat ohjeet

▲ VAROITUS	
	Tulipalon vaara. Käyttäjä on vastuussa riittävästä turvatoimista silloin, kun laitteistoa käytetään syttyviä nesteitä käyttäviin menetelmiin kanssa. Varmista, että oikeita turvallisuusmääräyksiä ja turvatoimia noudatetaan. Näihin kuuluu muun muassa läikkymisen ja vuotamisen seuranta, kunnollinen tuuletus, valvomattoman käytön kieltö ja laitteiston jatkuva valvonta aina virran ollessa kytkettynä.

▲ VAROTOIMI	
	Kemikaalille altistumisen vaara. Hävitä kemikaalit ja muut jätteet paikallisten ja kansallisten säästöjen mukaisesti.

HUOMAUTUS	
Älä kytke poistoletkuja muihin letkuihin, jottei synny paluupainetta eikä analysaattori vaurioitu. Varmista, että poistoletkujen päät ovat avoimia.	

HUOMAUTUS	
Paluupaineen ja analysaattorin vaurioitumisen ehkäisemiseksi analysaattori on asennettava käytössä olevaa viemäriä ylempään ja poistoletkun on vietettävä koko matkaltaan alaspäin. Asenna poistoletkut siten, että ne laskevat vähintään 2,54 cm (1") jokaista 0,3 metriä (1 jalkaa) kohden.	

Analysin jälkeen näyte ja reagenssit tyhjennetään analysaattorista poistoletkua pitkin. Poistoletkut on asennettava oikein, jotta kaikki neste varmasti poistuu laitteesta. Väärin asennustavan seurauksena laitteeseen saattaa päästä sisään nestettä, mikä voi aiheuttaa vaurioita. Poistoletkun voi johtaa lattiakaivoon tai lavuaarin viemäriin. Poistoletkun suositeltu ulkohalkaisija on 32 mm. Katso [Kuva 12](#) sivulla 470.


- Pidä poistoletkut mahdollisimman lyhyinä.
- Varmista, että poistoletku on analysaattoria alempana.
- Varmista, että poistoletkut viettävät koko matkaltaan alaspäin.
- Varmista, että poistoletkuissa ei ole teräviä mutkia eivätkä ne ole puristuksissa.
- Varmista, että poistoletkujen päät ovat avoimia ja letkut ovat nollapaineessa.
- Varmista, että poistoletkujen päät eivät ole avoimia ympäröivälle asennushuoneen ilmalle.
- Poistoletkua ei saa tukkia eikä upottaa.


On myös suositeltavaa, että analysaattorin lähellä on vesiliitäntä, jotta lavaaarin viemäriputki ja poistoletkut voidaan huuhdella säännöllisesti ja kiteytymisen aiheuttamat tukokset välttää.

Katso lisätietoja analysaattorissa käytetystä reagenssista kunkin EZ-sarjan mallin Method & Reagent Sheet -tietolomakkeesta. Jos analysaattorissa käytetään herkästi syttyviä reagensseja, noudata seuraavia varotoimia:

- Älä vie poistoletkun päätä viemäriin.
- Hävitä jäte paikallisten, alueellisten ja kansallisten säädösten mukaisesti.

### 5.5.3 Huohotinletkua koskevat ohjeet

<b>▲ VAROITUS</b>	
	Tulipalon vaara. Käyttäjä on vastuussa riittävästä turvatoimista silloin, kun laitteistoa käytetään syttyviä nesteitä käyttäviin menetelmiin kanssa. Varmista, että oikeita turvallisuusmääryksiä ja turvatoimia noudatetaan. Näihin kuuluu muun muassa läikkymisen ja vuotamisen seuranta, kunnollinen tuuletus, valvomattoman käytön kieltäminen ja laitteiston jatkuva valvonta aina virran ollessa kytkettynä.

<b>▲ VAROTOIMI</b>	
	Kemikaalille altistumisen vaara. Hävitä kemikaalit ja muut jätteet paikallisten ja kansallisten säädösten mukaisesti.

<b>HUOMAUTUS</b>	
Älä kytke huohotinletkua (pakokaasuporttia) muihin letkuihin, jottei synny paluupainetta eikä analysaattori vaurioidu. Varmista, että huohotinletkun pää on avoinna rakennuksen ulkopuoliselle ilmalle.	

<b>HUOMAUTUS</b>	
Paluupaineen ja analysaattorin vaurioitumisen ehkäisemiseksi analysaattori on asennettava käytössä olevia tuuletusaukkoja ylemmäs ja huohotinletkun on vietettävä koko matkaltaan alaspäin. Asenna huohotinletku siten, että se laskee vähintään 2,54 cm (1 tuuman) jokaista 0,3 metriä (1 jalkaa) kohden.	

Analysaattori pitää analysointiastian ilmakehän paineessa huohotinletkun avulla. Huohotinletku on asennettava oikein, jotta voidaan varmistaa, että huohotinletkusta ei pääse nestettä analysointiastiaan pumpun käytön aikana. Väärän asennustavan seurauksena analysaattoriin saattaa päästä sisään kaasua, mikä voi aiheuttaa vaurioita. Huohotinlinjan pääletkun suositeltu ulkohalkaisija on 32 mm. Katso [Kuva 12](#) sivulla 470.

- Pidä huohotinletku mahdollisimman lyhyenä.
- Varmista, että huohotinletku viettää koko matkaltaan alaspäin.
- Varmista, että huohotinletkussa ei ole teräviä mutkia eikä se ole puristuksissa.
- Varmista, että huohotinletkun pää ei ole avoinna ympäröivälle asennushuoneen ilmalle ja että letku on nollapaineessa.
- Varmista, että huohotinletku on aina tyhjennystä korkeammalla.
- Huohotinletkua ei saa tukkia eikä upottaa.

Jos analysaattorissa käytetään herkästi syttyviä reagensseja, noudata seuraavia varotoimia:


- Älä vie huohotinletkun päätä viemäriin.
- Hävitä jäte paikallisten, alueellisten ja kansallisten säädösten mukaisesti.

### 5.5.4 Analysaattorin liittäminen osien testaamista varten


<b>▲ VAROTOIMI</b>	
	Tulipalon vaara. Laitetta ei ole suunniteltu käytettäväksi herkästi syttyvien nesteiden kanssa.

Ennen kuin analysaattori ja kaikki reagenssit otetaan käyttöön, osat on testattava ionivaihdetulla vedellä. Katso kuvalliset ohjeet ja kohta [Osien testaaminen](#) sivulla 224.

1. Asenna neljä puristusventtiililettoa seuraavan kuvan vaiheen 1 mukaisesti.
  - a. Paina mustaa painiketta ja paina letku sitten venttiiliin.
  - b. Vapauta painike, kun letku on asennettu oikein.
2. Varmista, että tyhjennysletku on asennettu oikein näyteastiaan. Noudata seuraavaa kuvallista ohjetta 2.
3. Varmista, että hajotusletku on asennettu oikein hajotusastiaan. Noudata seuraavaa kuvallista ohjetta 3.
4. Liitä osien testaamista varten kaikki analysaattorin nesteletkut suureen pulloon, jossa on ionivaihdettua vettä. Noudata seuraavaa kuvallista ohjetta 3. Letkut on asennettu tehtaalla.

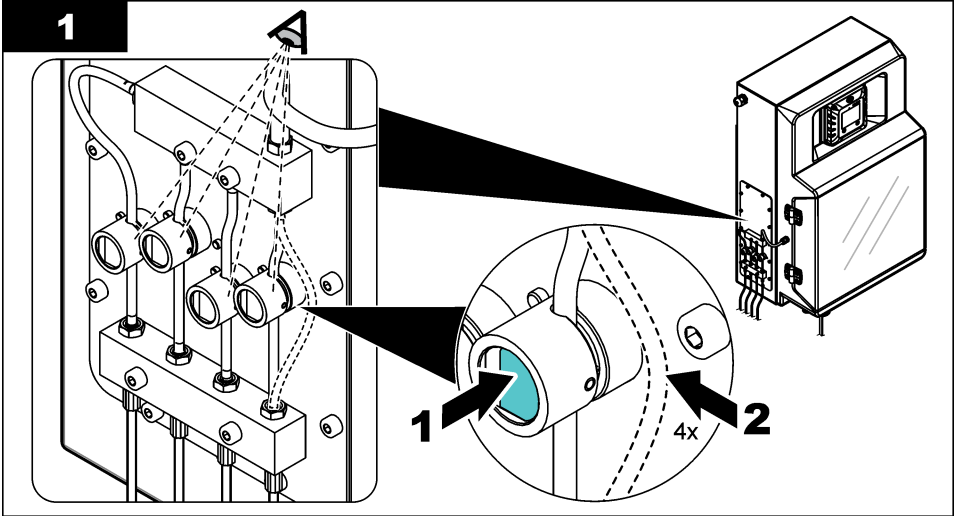

2



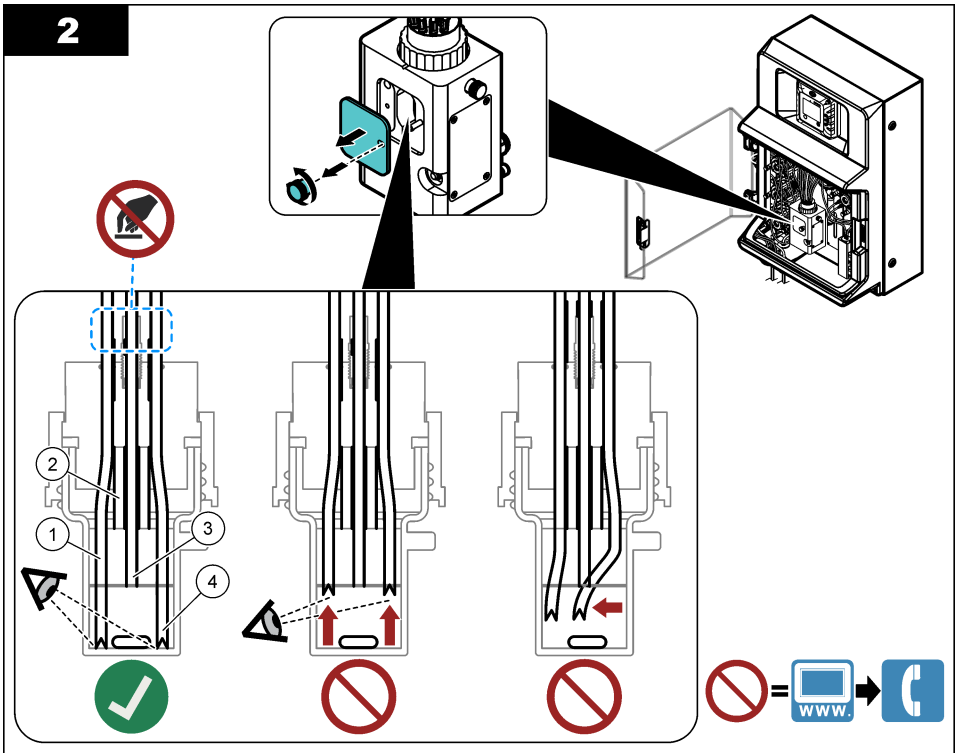


FI

1 Tyhjennysletku	3 Näytteenottoletku
2 Reagenssi- ja ilmanpoistoletku (yläletku)	4 Hajotusletku

3


FI

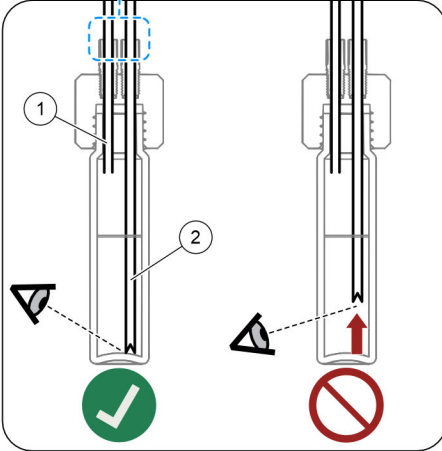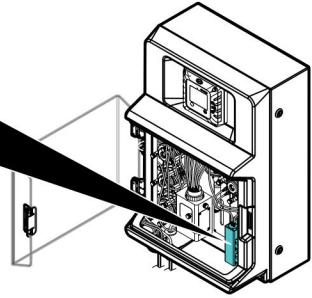

1 Ilmanpoistoletku

2 Hajotusletku

4

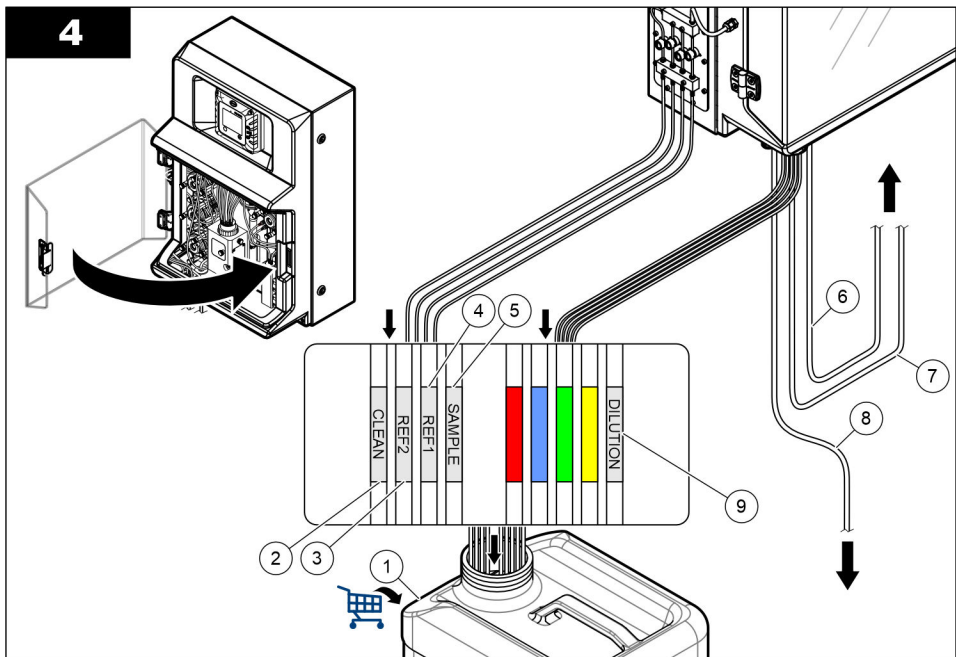

1 Ionivaihdettu vesi	4 Viitteen 1 liuoksen (REF1) letku	7 Hajotusventtiili
2 Puhdistusliuoksen letku	5 Näytetuloletku	8 Tyhjennysletku
3 Viitteen 2 liuoksen (REF2) letku	6 Ilmanpoistoputki	9 Laimennus- ja reagenssimikropumpun letku

## Osa 6 Käynnistys

### 6.1 Ensimmäinen käynnistys

**Huomautus:** Varmista ennen käynnistystä, että kiinnitys, letkut ja sähköasennukset ovat täysin valmiit. Katso [Asentaminen](#) sivulla 213.

Kun analysaattori käynnistetään ensimmäisen kerran, käyttöönottoavustaja auttaa käyttöönoton ensimmäisissä vaiheissa. Suorita kaikki seuraavat vaiheet, jotta analysaattori toimii varmasti oikein.

**Huomautus:** Varmista, että käytät oikeita reagensseja valitulla mittausalueella. Katso lisätietoja laajennetun käyttöoppaan verkkoversiosta.

1. Avaa analysaattorin luukku. Katso [Avaa analysaattorin ovi](#) sivulla 215.
2. Paina virtakytkin ON-asentoon. Katso kohtaa [Kuva 9](#) sivulla 461.
3. Sulje analysaattorin luukku mukana toimitetulla avaimella.
4. Odota, kunnes alustus on valmis.
5. Valitse kieli, aikavyöhyke, päivämäärä ja aika näytön ohjeiden mukaisesti.  
Katso ohjeet muiden ohjainasetusten määrittämiseen SC4500-ohjaimen asiakirjoista.
6. Näytä **EZ2700sc**-valikko napauttamalla näyttöä.
7. Käynnistä käyttöönottoavustaja valitsemalla **Device menu (Laitervalikko)**.  
Tervetulonäyttö tulee näkyviin.
8. Valitse sovellettava mittausalue näytön ohjeiden mukaisesti. Valitse **OK**.

9. Jos suodatinyksikkö on asennettu, valitse **On (Käytössä)**. Jos sitä ei ole, valitse **Off (Ei käytössä)**.
10. Valitse analysaattorin kanavien määrä. Valitse **OK**.
11. Jos yhteenvetosivulla näkyvä määrittäminen on oikea, valitse **OK**.  
**EZ2700sc** -päävalikko näytetään.
12. Jatka osien testaamiseen. Katso [Osien testaaminen](#) sivulla 224.

## 6.2 Osien testaaminen

### VAROITUS



Puristumisvaara. Liikkuvat osat voivat aiheuttaa puristumisvaaran ja vammoja. Älä kosketa liikkuvia osia.

Testaa osat ennen analysaattorin käyttöä. Tutki osien toimintaa käynnistämällä analysaattorin eri toimintoja **Maintenance (Huolto)** -valikossa.

#### Edellytykset:

- Jos analysaattori on käyttötilassa, valitse **Maintenance (Huolto) > Start maintenance mode (Huolto-tilan käynnistys)**.
- Varmista, että näytteen, reagenssin ja liuoksen letkut ovat astiassa, jossa on ionivaihdettua vettä. Katso [Analysaattorin liittäminen osien testaamista varten](#) sivulla 219.

#### 6.2.1 Sekoittimen tarkastaminen

1. Irrota valosuojus fotometriyksiköstä. Katso [Kuva 13](#) sivulla 472.
2. Varmista, että sekoittaja on näyteastian pohjassa.  
**Huomautus:** Tarkkaile sekoittajaa täyttötoimenpiteen aikana ja varmista, että se pyörii oikein. Täyttötoimenpide aloitetaan kohdassa [Pumppujen ja puristusventtiilien tarkastaminen](#) sivulla 224.
3. Asenna valosuojus fotometriin.

#### 6.2.2 Pumppujen ja puristusventtiilien tarkastaminen

1. Tarkasta pumppujen ja puristusventtiilien toiminta ja varmista, ettei vuotoja ole.
2. Varmista, että analysointiaastia täytyy ionivaihdetulla vedellä. Katso [Kuva 14](#) sivulla 474.
3. Varmista, että ionivaihdettu vesi tulee ulos tyhjennysletkusta.
4. Valitse **Maintenance (Huolto) > Start priming (Täytön käynnistys)** ja täytä kaikki nesteet erikseen.

Jos vuotoja ilmenee, tarkista kaikki liitännät ja katso lisätietoja laajennetun käyttöoppaan verkkoversiosta.

- a. Valitse **Prime reference 1 (Täytön viite 1)** ja paina **OK**-painiketta.
- b. Valitse **Prime reference 2 (Täytön viite 2)** ja paina **OK**-painiketta.
- c. Valitse **Prime cleaning solution (Täytön puhdistusaine)** ja paina **OK**-painiketta.
- d. Valitse **Prime rinsing (Täytön huuhtelu)** ja paina **OK**-painiketta.
- e. Valitse **Prime dispenser (Täytön annostelija)** ja paina **OK**-painiketta.
- f. Valitse **Prime channel (Täytön kanava) > Prime all channels (Täytä kaikki kanavat)** ja paina **OK**-painiketta.  
Jokainen täytön toimenpide pysäytetään automaattisesti, kun toimenpide on valmis.

### 6.2.3 Mikropumppujen tarkastaminen

Tarkista, esiintyykö mikropumpuissa vuotoja ja ilmakuplia.

1. Poista valosuojus fotometristä.
2. Valitse **Maintenance (Huolto) > Start priming (Täytön käynnistys) > Prime all reagents (Täytä kaikki reagenssit)**.
3. Varmista, että ionivaihdettua vettä kulkee mikropumpuun jokaisen mikropumpun (reagenssin) letkun kautta. Tämän jälkeen sen on tultava analysointiasiaan jatkuvasti ilman ilmakuplia. Katso [Kuva 15](#) sivulla 475.
4. Jos mikropumput eivät toimi oikein (letkuissa on kuplia), poista kuplat työntämällä ionivaihdettua vettä kyseisiin letkuihin ruiskumenetelmällä. Katso [Kuva 16](#) sivulla 476.
5. Asenna valosuojus fotometriin.

### 6.2.4 Fotometritarkastuksen tekeminen

Varmista, että analyysiasian ulkopinta on puhdista ennen fotometritarkastuksen tekemistä, jotta tarkastus voidaan tehdä. Katso lisätietoja analysaattorin osien puhdistamisesta laajennetun käyttöoppaan verkkoversiosta.

1. Paina päävalikon kuvaketta ja valitse **Devices (Laitteet)**.
2. Valitse **EZ2700sc**.
3. Selaa näkymää näytön alaosaan ja valitse **Device menu (Laittevalikko)**.
4. Valitse **Maintenance (Huolto) > Photometer check (Fotometritarkastus)**.
5. Aloita mittaus painamalla **OK**-painiketta.  
Kun pimeän kalibrointi on valmis, tulos näkyy näytössä.
6. Jatka valitsemalla **OK**.
7. Varmista, että "REF1"-letku on liitetty ionivaihdetulla vedellä täytettyyn säiliöön. Varmista, että valosuojus on asennettuna. Katso [Kuva 18](#) sivulla 478.
8. Valitse **OK**.  
Odota, kunnes analysointiasia on täytetty.
9. Säädä anturilähdön jännitteeksi 9 V ruuvitalan avulla. Katso [Kuva 17](#) sivulla 476.
10. Odota, kunnes näytöllä näkyy arvo 9 V. Paina sen jälkeen **OK**-painiketta.
11. Jatka valitsemalla **OK**.

## 6.3 Tulosignaalin testaaminen

Testaa digitaaliset tulot ennen analysaattorin käyttöönottoa.

**Edellytykset:** Liitä digitaaliset tulot ulkoiseen jännitteettömään koskettimeen (24 VDC).

Testaa digitaalisen tulon signaali ja analogisen lähdön signaali seuraavasti:

1. Paina päävalikon kuvaketta ja valitse **Devices (Laitteet)**.
2. Valitse **EZ2700sc**.
3. Selaa näkymää näytön alaosaan ja valitse **Device menu (Laittevalikko)**.
4. Valitse **Diagnostics (Vianmääritys) > Signals (Signaalit)**.  
Digitaalisten tulojen signaalit näkyvät.
5. Vertaa näytössä näkyvää digitaalisten tulojen tilaa digitaalisiin tuloihin syötettäviin jännitteisiin (24 V = On (Käytössä); 0 V = Off (Ei käytössä)).

## 6.4 Lähtösignaalin testaaminen

Testaa analogiset lähdöt ennen analysaattorin käyttöönottoa.

**Edellytykset:** Määritä analogiset lähdöt (AO1–AO8, P101) niin, että kukin analoginen lähtö edustaa tietyn kanavan mittausta. Katso lisätietoja laajennetun käyttöoppaan verkkoversiosta.

Suorita analogisen lähdön signaalin testaus seuraavalla tavalla:

1. Paina päävalikon kuvaketta.
2. Valitse **Outputs (Lähdöt) > mA outputs AOC (mA-lähdöt AOC) > Test/Maintenance (Testaus/ylläpito)**.

Vaihtoehto	Kuvaus
<b>Function test (Toimintatesti)</b>	Suorittaa valitun moduulin lähdön testauksen.
<b>Output status (Lähdön tila)</b>	Näyttää valitun moduulin lähtöjen tilan.

3. Mittaa mA-arvo jokaisesta analogisesta lähdöstä yleismittarilla.
4. Vertaa analogisista lähdöistä mitattua mA-arvoa odotettuihin mA-arvoihin.

## 6.5 Kanavien järjestyksen asettaminen


Aseta, missä järjestyksessä kanavat mitataan, montako kertaa kukin kanava mitataan ja kuinka kauan odotetaan, ennen kuin kanava mitataan. Lisää enintään 16 riviä, joissa kussakin on enintään 16 jaksoa.

1. Paina päävalikon kuvaketta ja valitse **Devices (Laitteet)**.
2. Valitse **EZ2700sc**.
3. Selaa näkymää näytön alaosaan ja valitse **Device menu (Laittevalikko)**.
4. Jos analysaattori on käyttötilassa, valitse **Maintenance (Huolto) > Start maintenance mode (Huoltotilan käynnistys)**.  
Odota, kunnes analysaattori on huoltotilassa.
5. Valitse **Configuration (Määrittys) > Channel sequence setup (Kanavajärjestyksen asetukset)**.
6. Valitse kohta (järjestyksen numero) sivupalkin nuolipainikkeilla ja paina sitten **OK** määrittääksesi kyseisen kohdan.
7. Valitse vaihtoehto.

Vaihtoehto	Kuvaus
<b>Select (Valitse)</b>	Valitsee sopivan kanavan tai odotusajan.
<b>Number of measurements (Mittausten määrä)</b>	Asettaa kanavan mittausten määrän.
<b>Waiting time (Odotusaika)</b>	Asettaa odotusajan valitulle kanavalle.

8. Tallenna muutokset valitsemalla **OK**.

## 6.6 Liuosten ja näytteen liitännät

▲ VAROTOIMI	
	Kemikaalille altistumisen vaara. Noudata laboratorion turvallisuusohjeita ja käytä käsiteltäville kemikaaleille soveltuvia suojavarusteita. Lue turvallisuusprotokollat ajan tasalla olevista käyttöturviedotteista (MSDS/SDS).

▲ VAROTOIMI	
	Kemikaalille altistumisen vaara. Hävitä kemikaalit ja muut jätteet paikallisten ja kansallisten säästöjen mukaisesti.

## ▲ VAROTOIMI



Tulipalon vaara. Laitetta ei ole suunniteltu käytettäväksi herkästi syttyvien nesteiden kanssa.

Reagenssiastiat toimitetaan analysaattorin mukana. Katso kohtaa [Kuva 18](#) sivulla 478. Viitteen 1 liuokselle, viitteen 2 liuokselle ja ionivaihdetulle vedelle tarkoitettujen astioiden hankkiminen on käyttäjän vastuulla. Lisäästiota voi ostaa valmistajalta.

Asenna astiat

- mahdollisimman lähelle analysaattoria
- 1 metrin etäisyydelle analysaattorin pohjasta

Katso säiliön asentaminen kohdasta [Kuva 18](#) sivulla 478.

Käyttäjä hankkii reagenssit ja liuokset itse. Käytä vain sertifioidun yrityksen toimittamia reagensseja tai käytä valmistajan omia reagensseja. Vaihtoehtoisesti käyttäjä voi valmistaa reagenssit. Noudata valmistajan verkkosivustolla olevan mallikohtaisen Method & Reagent Sheet -tietolomakkeen ohjeita.

Letkut on asennettu tehtaalla. Tunnista oikea liitoskohta lukemalla letkussa olevat merkinnät. Katso oikeat reagenssit, liuokset ja standardit valmistajan verkkosivustolla olevasta mallikohtaisesta Method & Reagent Sheet -tietolomakkeesta.

1. Kun osat on testattu, asenna "CLEAN"-letku (puhdistusliuos), "REF1"-letku (viitteen 1 liuos) ja "REF2"-letku (viitteen 2 liuos) niille kuuluviin säiliöihin. Katso [Kuva 18](#) sivulla 478.
2. Asenna kukin värikoodattu reagenssiletku reagenssisäiliöön, jossa on vastaava värimerkintä.
3. Liitä näytelähde (tai Moduplex- tai suodatinpaneelin näytelähtö) analysaattorin näytteen tuloletkuun. Katso [Kuva 18](#) sivulla 478.
4. Paina päävalikon kuvaketta ja valitse **Devices (Laitteet)**.
5. Valitse **EZ2700sc**.
6. Selaa näkymää näytön alaosaan ja valitse **Device menu (Laittevalikko)**.
7. Valitse **Maintenance (Huolto) > Start priming (Täytön käynnistys) > Prime all (Täytä kaikki)**.

### 6.7 Vahvistuksen tekeminen ennen ensimmäistä käynnistystä

Tee vahvistus varmistaaksesi, että mittaukset ovat toleranssialueella. Katso lisätietoja laajennetun käyttöoppaan verkkoversiosta.

1. Paina päävalikon kuvaketta ja valitse **Devices (Laitteet)**.
2. Valitse **EZ2700sc**.
3. Selaa näkymää näytön alaosaan ja valitse **Device menu (Laittevalikko)**.
4. Aloitta vahvistus valitsemalla **Calibration (Kalibrointi) > Validation (Vahvistus) > Start validation (Vahvistuksen käynnistys)**.  
Vahvistuksessa mitataan vertailun 2 pullossa oleva ionivaihdettu vesi.
5. Valitse jokin seuraavista nähdäksesi tulokset:
  - **Calibration (Kalibrointi) > Validation (Vahvistus) > Validation history (Vahvistushistoria)**
  - **Diagnostics (Vianmääritys) > Historical data (Historiatiedot) > Validation (Vahvistus)**

### 6.8 Analysaattorin käynnistäminen

Analysaattorin käynnistäminen:

1. Paina päävalikon kuvaketta ja valitse **Devices (Laitteet)**.
2. Valitse **EZ2700sc**.

3. Selaa näkymää näytön alaosaan ja valitse **Device menu (Laitervalikko)**.
4. Valitse **Maintenance (Huolto) > Start operational mode (Käyttötilan käynnistys)**.

# Съдържание

- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| 1 Допълнителна информация на страница 229 | 4 Обща информация на страница 231 |
| 2 Общ преглед на продукта на страница 229 | 5 Инсталиране на страница 233     |
| 3 Спецификации на страница 230            | 6 Включване на страница 243       |

## Раздел 1 Допълнителна информация

Основното ръководство за потребителя съдържа информация, която е достатъчна за въвеждане в експлоатация. Онлайн е на разположение разширено ръководство за потребителя, което съдържа повече информация.

BG

### ▲ ОПАСНОСТ



Множество опасности! Повече информация има в отделните раздели на разширеното ръководство за потребителя, които са показани по-долу.

- Потребителски интерфейс и навигация
- Работа
- Поддръжка
- Отстраняване на неизправности
- Списъци с резервни части

Сканирайте следващите QR кодове, за да преминете към разширеното ръководство за потребителя.



Европейски езици



Американски и азиатски езици

## Раздел 2 Общ преглед на продукта

Анализаторът Nach EZ2700sc е онлайн анализатор, който измерва един параметър във водни проби от промишлени приложения и такива, свързани с околната среда. Направете справка с [Фигура 1](#) на страница 437, [Фигура 2](#) на страница 440 и [Фигура 3](#) на страница 445.

Анализаторът е онлайн колориметричен анализатор за общ анализ на водата (напр. нитрат, фосфат). Анализаторът има опции за дистанционно стартиране, автоматично валидиране, автоматично калибриране, автоматично почистване и Modbus.

Водната проба постъпва в анализатора през тръбата за проби. Помпите, клапаните и спринцовките в анализатора придвижват пробата и реактивите към измервателната клетка на аналитичния панел. Когато процесът на анализ в съда е завършен, анализаторът изхвърля пробата през тръбата за източване. Резултатите на анализатора се показват на дисплея на контролера SC4500. Контролерът SC4500 запазва данните на анализатора (регистър на данни, регистър на събития, регистър на настройки и сервизен регистър). Използвайте контролера SC4500, за да работите с анализатора и да го конфигурирате.

За увеличаване на броя на потоците от проби (каналы), които анализаторът може да измерва (2, 4 или 8), закупете панела с множество потоци Moduplex с анализатора.

За предварително обработване на пробата (филтрация, утаяване) закупете панела за филтрация EZ9010, EZ9020, EZ9150, EZ9200 или EZ9250 с анализатора.

## Раздел 3 Спецификации

Спецификациите подлежат на промяна без уведомление.

Спецификация	Данни
Размери (Ш x В x Д)	460 x 688 x 340 mm (18,1 x 27,1 x 13,4 инча)
Корпус	IP44; ABS, PMMA и стомана с покритие
Дисплей	IP66, 3,5-инчов TFT цветен дисплей с capacitивен тъчпад
Тегло	40 kg (88 lb)
Изисквания към захранването	От 100 до 240 VAC $\pm$ 10%, 50/60 Hz
Консумация на енергия	240 VA максимум
Надморска височина	Максимум 2000 m (6560 ft)
Категория на свръхнапрежение	II
Условия на околната среда	За използване само на закрито
Степен на замърсяване	2
Работна температура	От 10 до 30° C (от 50 до 86° F), от 5 до 95% относителна влажност, без кондензация, без корозия
Температура на съхранение	Максимум от -20 до 60° C (от -4 до 140°F), 95% относителна влажност, без кондензация
Входящи отвори за проби	Един
Налягане на пробата	От външен съд за преливник (отваря се при атмосферно налягане)
Дебит на пробата	От 100 до 300 mL/min
Температура на пробата	От 10 до 30°C (от 50 до 86°F)
Качество на пробата	< 100 $\mu$ m частици, < 0,1 g/L максимум Мътност < 50 NTU
Обезвъздушаване за корозионни среди	0,2 bar (20 kPa или 3 psi); сух и чист въздух
Дренаж	Атмосферно налягане, вентилирано, минимум $\varnothing$ 32 mm
Заземяване	Сух и чист заземителен прът с нисък импеданс (< 1 $\Omega$ ) със заземителен кабел > 2,5 mm <sup>1</sup> (13 AWG)
Аналогови изходи	Максимум осем аналогови извода от 0 – 20 mA (или 4 – 20 mA) <b>Забележка:</b> Аналоговите изходи подават циклично захранване. Захранването не може да бъде подавано от контактите на SCADA или PLC система.
Цифрови входове	Седем цифрови входа: два цифрови входа за дистанционно стартиране. Останалите цифрови входове са за бъдеща употреба.
Цифрови изходи	Четири енергизирани цифрови изхода за клапаните и помпите на панела EZ9150; осем енергизирани цифрови изхода за клапаните на панела Moduplex; 24 VDC, 500 mA.
Релета	Пет контакта без потенциал (FCT), максимално натоварване 24 VDC, 0,5 A (резистивен товар)
Ethernet връзки	Ethernet връзка на Claros и Modbus TCP/IP Ethernet конектор; LAN версия; 10/100 Mbps, или Profinet, или Ethernet IP

<sup>2</sup> За информация относно конфигурирането на Ethernet и конфигурирането на Modbus направете справка с документацията на контролера SC4500.

Спецификация	Данни
RS485 комуникации	Profibus DP или Modbus RTU
Сертификати	CE, ETL сертифицирани по стандартите за безопасност на UL и CSA, UKCA
Гаранция	1 година (ЕС: 2 години)

## Раздел 4 Обща информация

В никакъв случай производителят няма да бъде отговорен за щети, произлизащи от каквато и да било неправилна употреба на продукта или неспазване на инструкциите в ръководството. Производителят си запазва правото да прави промени в това ръководство и в описаните в него продукти във всеки момент и без предупреждение или поемане на задължения. Коририраните издания можете да намерите на уебсайта на производителя.

### 4.1 Информация за безопасността

Производителят не носи отговорност за никакви повреди, възникнали в резултат на погрешно приложение или използване на този продукт, включително, без ограничения, преки, случайни или възникнали впоследствие щети, и се отхвърля всяка отговорност към такива щети в пълната позволена степен от действащото законодателство. Потребителят носи пълна отговорност за установяване на критични за приложението рискове и монтаж на подходящите механизми за подсигуряване на процесите по време на възможна неизправност на оборудването.

Моля, внимателно прочетете ръководството преди разопаковане, инсталиране и експлоатация на оборудването. Обърнете внимание на всички предупреждения за повишено внимание и опасност. Пренебрегването им може да доведе до сериозни наранявания на оператора или повреда на оборудването.

Ако оборудването се използва по начин, който не е определен от производителя, защитата, осигурена от оборудването, може да бъде нарушена. Не използвайте и не инсталирайте това оборудване по начин, различен от определения в това ръководство.

#### 4.1.1 Използване на информация за опасностите

##### ▲ ОПАСНОСТ

Указва наличие на потенциална или непосредствена опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, ще предизвика смърт или сериозно нараняване.

##### ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указва потенциално или непосредствено опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, може да доведе до смърт или сериозно нараняване.

##### ▲ ВНИМАНИЕ







Указва наличие на потенциално опасна ситуация, която може да предизвика леко или средно нараняване.

##### Забележка


Показва ситуация, която ако не бъде избегната, може да предизвика повреда на инструмента. Информация, която изисква специално изтъкване.

#### 4.1.2 Предупредителни етикети

Прочетете всички надписи и етикети, поставени на инструмента. Неспазването им може да доведе до физическо нараняване или повреда на инструмента. Към символ върху инструмента е направена препратка в ръководството с предупредително известие.

	Това е символът за предупреждение за безопасност. Спазвайте всички съобщения за безопасност, които следват този символ, за да се избегне потенциално нараняване. Ако е върху инструмента, вижте ръководството за потребителя или информацията за безопасност.
	Този символ сочи риск от химически увреждания и указва, че само лица, квалифицирани и обучени химикалите или да извършват поддръжка на системите за подаване на химикали, свързани с оборудването.
	Този символ показва, че съществува риск от електрически удар и/или късо съединение.
	Този символ обозначава наличието на устройства, които са чувствителни към елестростатичен разряд (ESD) и посочва, че трябва да сте внимателни, за да предотвратите повреждането на оборудването.
	Този символ обозначава, че маркираният елемент изисква защитна заземена връзка. Ако инструментът не е снабден със заземен щепсел с кабел, изградете предпазна заземена връзка с предпазния терминал на проводника.
	Електрическо оборудване, което е обозначено с този символ, не може да бъде изхвърляно в европейските частни или публични системи за изхвърляне на отпадъци. Оборудването, което е остаряло или е в края на жизнения си цикъл, трябва да се връща на производителя, без да се начисляват такси върху потребителя.

#### 4.1.3 Химична и биологична безопасност

<b>▲ ОПАСНОСТ</b>	
	Химични или биологични опасности. Ако този инструмент се използва за мониториране на процес на обработка и/или система за химическо храняване, за която има регулаторни ограничения и изисквания за мониторинг, свързани с общественото здраве, обществената безопасност, производство на храна или напитки или преработка, отговорност на потребителя на този инструмент е да познава и спазва приложимата разпоредба и да разполага с достатъчно и подходящи механизми за съответствие с приложимите разпоредби в случай на неизправност на инструмента.

#### 4.2 Икони, използвани в илюстрациите

				
Предоставени от производителя части	Предоставени от потребителя части	Гледайте	Извършете стъпките в обратен ред	
				
Използвайте двама души	Слушам	Използвайте само пръсти	Не използвайте инструменти	Не докосвайте

#### 4.3 Предназначение

Анализаторите Nach от серията EZ са предназначени за използване от лица, които трябва непрекъснато да измерват параметри за качество на водата в проби от промишлени и

екологични приложения. Анализаторите Nach от серията EZ не обработват и не променят водата и не се използват за управление на процедурите.

## 4.4 Компоненти на продукта

Уверете се, че всички компоненти са получени. Направете справка с [Фигура 4](#) на страница 449. Ако някои от елементите липсват или са повредени, се свържете незабавно с производителя или с търговския представител.

## Раздел 5 Инсталиране

BG

### ▲ ОПАСНОСТ



Множество опасности. Задачите, описани в този раздел на документа, трябва да се извършват само от квалифициран персонал.

### 5.1 Указания за инсталиране

#### ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Опасност от пожар. Потребителят носи отговорност за гарантирането, че са предприети достатъчно предпазни мерки при използване на оборудването с методи, които употребяват запалими течности. Уверете се, че спазвате правилните потребителски предпазни мерки и протоколи за безопасност. Това включва, но не се ограничават до: контролиране на разливания и течове, подходяща вентилация, никаква употреба без надзор и гарантиране, че инструментът никога не се оставя без надзор, когато е включен към захранването.

#### ▲ ВНИМАНИЕ



Опасност от химическа експозиция. Спазвайте лабораторните процедури за безопасност и носете пълното необходимо лично предпазно оборудване при боравене със съответните химически вещества. За информация относно протоколите по безопасност направете справка с информационните листове за безопасност на материала (MSDS/SDS).

#### ▲ ВНИМАНИЕ



Опасност от химическа експозиция. Изхвърляйте химическите и отпадъчни вещества в съответствие с местните, регионални и национални разпоредби.

- Инсталирайте анализатора на закрито в безопасна среда.
- Поставете анализатора в среда, защитена от корозивни течности.
- Инсталирайте анализатора на чисто, сухо, добре вентилирано място с контролирана температура.
- Инсталирайте анализатора възможно най-близо до точката на пробовземане.
- Не инсталирайте анализатора на пряка слънчева светлина или близо до източник на топлина.
- Уверете се, че има достатъчно разстояние да се направят водопроводните и електрически свързвания.
- Уверете се, че оставяте достатъчно място пред анализатора за отваряне на неговата вратичка. Направете справка с [Размери на анализатора](#) на страница 234.
- Уверете се, че околните условия са в рамките на работните спецификации. Направете справка с [Спецификации](#) на страница 230.

Въпреки че анализаторът не е предназначен за използване със запалими проби, някои анализатори EZ използват запалими реактиви. Вижте листа за метод и реактив на приложимия модел на серия EZ за повече информация относно използваните в анализатора

реактиви. Ако анализаторът използва запалими реактиви, спазвайте следните предпазни мерки за безопасност:




- Дръжте анализатора далеч от топлина, искри и открит пламък.
- Не яжте, не пийте и не пушете в близост до анализатора.
- Използвайте локална система за вентилация на отработените газове.
- Използвайте искро- и взривозащитени уреди и осветителна система.
- Не допускайте електростатични разряди. Направете справка с [Съображения, свързани с електростатичния разряд \(ESD\)](#) на страница 235.
- Напълно почистете и изсушете уреда преди употреба.
- Мийте ръцете си преди почивките и в края на работния период.
- Отстранете замърсеното облекло. Изперете дрехите преди повторна употреба.
- С тези течности трябва да се борави в съответствие с изискванията на местния регламентиращ орган относно допустимите граници на експозиция.

## 5.2 Размери на анализатора

Направете справка с [Фигура 5](#) на страница 454 за размерите на анализатора.

## 5.3 Механично монтиране

### 5.3.1 Прикрепване на инструмента към стена

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	
	Опасност от нараняване. Уверете се, че приспособлението за стенно монтиране може да издържи товар, 4 пъти по-голям от тежестта на оборудването.
▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	
	Опасност от нараняване. Инструментите или компонентите са тежки. При монтаж или преместване потърсете помощ.
▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	
	Опасност от нараняване. Предметът е тежък. Проверете дали инструментът е здраво закачен на стена, маса или под, за да е в състояние да работи безопасно.

Използвайте предоставените монтажни скоби, за да прикрепите инструмента изправен и нивелиран на плоска вертикална стенна повърхност. Направете справка с [Фигура 6](#) на страница 455.

Инсталирайте инструмента на местоположение и в положение, при което потребителят може лесно да го разкачва от източника на захранване.

Уверете се, че има достатъчно разстояние под анализатора, за да инсталирате бутилките.

Материалите за монтиране се осигуряват от потребителя. Уверете се, че стенният фиксатор има достатъчно товароспособност (приблизително 160 kg или 353 lb). Крепежните елементи трябва да са одобрени за свойствата на стената.

### 5.3.2 Отворете вратата на анализатора

Използвайте предоставения ключ, за да отключите двете ключалки от страни на анализатора. Направете справка с [Фигура 7](#) на страница 456. Уверете се, че сте затворили вратата преди работа, за да запазите класификацията за околна среда за корпуса и класификацията за безопасност.

## 5.4 Електрическа инсталация

### ⚠ ОПАСНОСТ



Опасност от токов удар по потребителя. Винаги изключвайте захранването на инструмента преди изграждане на електрически връзки.

### 5.4.1 Съобщения, свързани с електростатичния разряд (ESD)

#### Забележка



Опасност от повреда на инструмента. Чувствителните вътрешни електронни компоненти могат да се повредят от статичното електричество, което да доведе до влошаването на характеристиките или до евентуална повреда.

С цел да предотвратите ESD повреда на инструмента, разгледайте стъпките, представени в тази процедура.

- Докоснете заземена метална повърхност, например корпуса на инструмент, метален проводник или тръба с цел освобождаване на статичното електричество от тялото.
- Избягвайте прекомерно движение. Транспортирайте компоненти, чувствителни към статично електричество в антистатични контейнери или пакети.
- Носете каишка за китката, свързана с кабел към заземена връзка.
- Носете на място без чувствителност към статично електричество с антистатични подови подложки и работни подложки.

### 5.4.2 Електрически достъп

Поставете кабелите на външните устройства през кабелните салници. Направете справка с [Фигура 8](#) на страница 457. Дръжте щепселите в кабелните салници, които не се използват.

[Фигура 9](#) на страница 460 показва компонентите вътре в анализатора. Превключвателят на захранването е прекъсвач, който автоматично прекъсва мрежовото електрозахранване от захранващата променливотокова линия, ако възникне състояние на свръхток (например късо съединение) или свръхнапрежение.

### 5.4.3 Свързване на външните устройства

Свържете външните устройства, които ще бъдат използвани с анализатора, към клемите за сигнал и управление в анализатора. Направете справка с [Фигура 10](#) на страница 462 и [Таблица 1](#) на страница 235.

**Таблица 1 Клеми за сигнал и управление — описания**

Пин	Описание
AO1 – AO8 (P101)	Осем аналогови изхода за управление на външните устройства. Направете справка с онлайн версията на разширеното ръководство за потребителя за повече информация.
FCT1 – FCT5 (P102)	Пет релета (контакти без потенциал). Максимумът на натоварването е 24 VDC, 0,5 A. <ul style="list-style-type: none"><li>• FCT1 — аларма за неизправност</li><li>• FCT2 — аларма за поддръжка</li><li>• FCT3 — анализаторът е готов</li><li>• FCT4 и FCT5 — за бъдеща употреба</li></ul>

Таблица 1 Клеми за сигнал и управление — описания (продължава)

Пин	Описание
DI1 – DI7 (P103)	<p>Седем цифрови входа за дистанционно управление на анализатора<sup>5</sup>Свържете цифровите входове към външен контакт без потенциали (24 VDC), за да задействате анализатора да стартира измерване за канал.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DI1 — дистанционен старт за канал 1</li> <li>• DI2 — дистанционен старт за канал 2</li> <li>• DI3 до DI7 — за бъдеща употреба</li> </ul>
FB1–FB4 (P104)	<p>Profibus DP или Modbus RTU (RS485) конектори</p> <p><b>Profibus DP:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FB1 — A1 (вход)</li> <li>• FB2 — A2 (изход)</li> <li>• FB3 — B1 (вход)</li> <li>• FB4 — B2 (изход)</li> <li>• SHL — екран</li> </ul> <p><b>Modbus RTU:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FB1 — D (+)</li> <li>• FB2 — D (-)</li> <li>• FB3 — не се използва</li> <li>• FB4 — не се използва</li> <li>• SHL — екран</li> </ul> <p>Направете справка с документацията на контролера SC4500 за инструкции по конфигурирането на Modbus и етикети за телеграмата.</p>
24VDC/1A (P105)	24 V DC захранване за модулите за филтрация EZ9010 и EZ9020
STR1 – STR8 (P106)	<p>Осем цифрови изхода за допълнителния панел Moduplex. Свържете оголените проводници на всеки клапан на канал по панела Moduplex към свързаните STR конектори.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• STR1 — канал 1</li> <li>• STR2 — канал 2</li> <li>• ...</li> <li>• STR8 — канал 8</li> </ul>
EXT9–EXT12 (P107)	<p>Четири цифрови изхода за опционалния панел за филтрация EZ9150. Свържете електрическите клапани и помпата по панела за филтрация EZ9150 към EXT конекторите.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EXT9 — клапан за изплакване</li> <li>• EXT10 — клапан за обратно промиване</li> <li>• EXT11 — преливен клапан за източване</li> <li>• EXT12 — помпа за филтриране</li> </ul>
D01–D06 (P108 и P109)	<p>Шест изхода за пневматични клапани за панела EZ9150.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• D01 — входен клапан за проба</li> <li>• D02 — дренажен клапан за препълване</li> <li>• D03 — клапан за канал 1</li> <li>• D04 — клапан за канал 2</li> <li>• D05 — клапан за канал 3</li> <li>• D06 — клапан за канал 4</li> </ul>

<sup>5</sup> Ако анализаторът е в режим на поддръжка, дистанционното управление е деактивирано.

## 5.4.4 Свързване към променливотоково захранване

### ▲ ОПАСНОСТ



Опасност от токов удар и пожар. Уверете се, че предоставеният кабел и незаклучващата се бухса отговарят на валидните за съответната държава изисквания.

- Уверете се, че в захранващата линия има инсталиран прекъсвач с достатъчен капацитет на електрически ток.
- Уверете се, че прекъсвачът или аварийният превключвател е монтиран близо до анализатора, така че анализаторът да може незабавно да бъде изключен от захранването, ако е необходимо.
- Свържете оборудването в съответствие с местните, щатските или националните електрически кодекси.
- Инсталирайте предоставения захранващ кабел през кабелната муфа, която е отстрани на анализатора.
- Затегнете кабелната муфа, за да държи здраво захранващия кабел и да се спазва класификацията за околна среда за корпуса.

Свържете анализатора към променливотоково захранване с предоставения променливотоков захранващ кабел. Направете справка за [Таблица 2](#) на страница 237 и [Фигура 11](#) на страница 467.

### Забележка

Не задавайте превключвателя на захранването на включено положение. Изпълнете всички електрически и водопроводни свързвания преди стартиране, иначе може да възникне повреда на анализатора.

**Таблица 2 Информация за опроводяване – променливотоково захранване**

Клема	Описание	Цвят на кабела - Северна Америка и Канада	Цвят на кабела - ЕС
L	Заредено/линия (L)	Черен (1)	Кафяв
N	Неутрално (N)	Бели (2)	Син
	Защитно заземяване (PE)	Зелено с жълта лента	Зелено с жълта лента

## 5.5 Водопроводни дейности

### 5.5.1 Указания за линия на пробата

### ▲ ВНИМАНИЕ



Опасност от пожар. Този продукт не е предназначен за употреба със запалими проби.

За оптимални характеристики на апарата избирайте добра, надеждна точка за вземане на проби. Пробата трябва да е представителна за цялата система.

- Уверете се, че потокът на пробата е по-висок от потока към анализатора.
- Уверете се, че линията на пробата е на атмосферно налягане, ако анализаторът използва перисталтична помпа за придвижване на пробата в съда за анализ.
- Уверете се, че линията на пробата събира проба от малък съд с преливане близо до анализатора.
- Използвайте предоставената линия за проби. Не променяйте дължината на линията за проби.

Пробата в съда с преливане трябва да се опреснява непрекъснато. Ако размерът на твърдите частици в пробата е твърде голям, се препоръчва и филтриране на пробата.

## 5.5.2 Указания за линиите за източване

### ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Опасност от пожар. Потребителят носи отговорност за гарантирането, че са предприети достатъчно предпазни мерки при използване на оборудването с методи, които употребяват запалими течности. Уверете се, че спазвате правилните потребителски предпазни мерки и протоколи за безопасност. Това включва, но не се ограничава до: контролиране на разливания и течове, подходяща вентилация, никаква употреба без надзор и гарантиране, че инструментът никога не се оставя без надзор, когато е включен към захранването.

### ▲ ВНИМАНИЕ



Опасност от химическа експозиция. Изхвърляйте химическите и отпадъчни вещества в съответствие с местните, регионални и национални разпоредби.

### Забележка

Не свързвайте линиите за източване към други тръби, защото това може да причини обратно налягане и повреда на анализатора. Уверете се, че линиите за източване имат достъп до въздух.

### Забележка

За да предотвратите вероятността от обратно налягане и повреда на анализатора, се уверете, че анализаторът се намира на по-високо от използваното(ите) съоръжение(я) за източване, както и че линиите за източване са с постоянен наклон надолу. Инсталирайте линиите за източване с 2,54 cm (1 in) или по-голям наклон за всеки 0,3 m (1 ft) дължина на тръбите.

Анализаторът използва линиите за източване, за да изпусна проба и реактиви след анализ. Правилното инсталиране на линиите за източване е важно за осигуряване на премахването на всички течности от апарата. Неправилното инсталиране може да причини връщане на течност в апарата, което да доведе до повреда. Подов дренаж или такъв в мивка е достатъчен за линията за източване. Предпочитаният външен диаметър за тръбата за източване е 32 mm. Направете справка с [Фигура 12](#) на страница 469.

- Направете линиите за източване възможно най-къси.
- Уверете се, че дренажният елемент е по-ниско от анализатора.
- Уверете се, че линиите за източване имат постоянен наклон надолу.
- Уверете се, че линиите за източване нямат извивания под много остър ъгъл и не са прищипани.
- Уверете се, че линиите за източване са отворени към въздуха и са с нулево налягане.
- Уверете се, че линиите за източване са затворени към околната среда на помещението за инсталиране.
- Не блокирайте и не потапяйте линиите за източване.

Препоръчва се и водно свързване близо до анализатора, така че мивката за източване и тръбите за източване се промиват редовно с чиста вода, за да се предотврати блокаж от кристализация.

Вижте листа за метод и реактив на приложимия модел на серия EZ за повече информация относно използваните в анализатора реактиви. Ако анализаторът използва запалими реактиви, спазвайте следните предпазни мерки за безопасност:

- Не свързвайте тръбата за източване към подовия дренаж.
- Изхвърляйте отпадъчни вещества в съответствие с местните, регионалните и националните разпоредби по отношение на околната среда.

### 5.5.3 Указания за линията за вентилация

#### ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Опасност от пожар. Потребителят носи отговорност за гарантирането, че са предприети достатъчно предпазни мерки при използване на оборудването с методи, които употребяват запалими течности. Уверете се, че спазвате правилните потребителски предпазни мерки и протоколи за безопасност. Това включва, но не се ограничава до: контролиране на разливания и течове, подходяща вентилация, никаква употреба без надзор и гарантиране, че инструментът никога не се оставя без надзор, когато е включен към захранването.

#### ▲ ВНИМАНИЕ



Опасност от химическа експозиция. Изхвърляйте химическите и отпадъчни вещества в съответствие с местните, регионални и национални разпоредби.

#### Забележка

Не свързвайте линията за вентилация (порт за отработени газове) към други линии, защото това може да причини обратно налягане или повреда на анализатора. Уверете се, че линията за вентилация е отворена към въздуха извън сградата.

#### Забележка

За да предотвратите обратно налягане и повреда на анализатора, се уверете, че анализаторът е по-високо от използвания(те) вентилационен(ни) отвор(и), както и че линията за вентилация е с постоянен наклон надолу. Инсталирайте линията за вентилация с 2,54 cm (1 инч) или по-голям вертикален наклон за всеки 0,3 m (1 ft) дължина на тръбите.

Анализаторът използва линията за вентилация, за да поддържа съда за анализ при атмосферно налягане. Правилното инсталиране на линията за вентилация е важно, за да се уверите, че по време на работата с помпата в съда за анализ не навлиза течност от линията за вентилация. Неправилното инсталиране може да причини връщане на газ в анализатора, което да доведе до повреда. Препоръчаният външен диаметър за водещата тръба на линията за вентилация е 32 mm. Направете справка с [Фигура 12](#) на страница 469.

- Направете линията за вентилация възможно най-къса.
- Уверете се, че линията за вентилация има постоянен наклон надолу.
- Уверете се, че линията за вентилация няма извиване под много остър ъгъл и не е прищипана.
- Уверете се, че линията за вентилация е затворена към околната среда на помещението за инсталиране и е с нулево налягане.
- Уверете се, че линията за вентилация винаги е по-висока от източването.
- Не блокирайте и не потапяйте линията за вентилация.

Ако анализаторът използва запалими реактиви, спазвайте следните предпазни мерки за безопасност:

- Не свързвайте линията за вентилация към подов дренаж.
- Изхвърляйте отпадъчни вещества в съответствие с местните, регионалните и националните разпоредби по отношение на околната среда.

### 5.5.4 Вертикално поставяне на анализатора за теста на компонента


#### ▲ ВНИМАНИЕ




Опасност от пожар. Това устройство не е предназначено за употреба със запалими течности.

Преди анализаторът с всички реактиви да бъде пуснат в експлоатация, трябва да се направи тест на компонент с дейонизирана вода. Направете справка с илюстрираните стъпки и до [Изпълняване на изпитванията на компонентите](#) на страница 244.

1. Инсталирайте четирите тръби на клапаните с притискане, както е показано на илюстрираната стъпка 1, която следва.
  - a. Натиснете черния бутон, след това натиснете тръбичката в клапана.
  - b. Отпуснете бутона, когато тръбичката е правилно инсталирана.
2. Уверете се, че дренажните тръби са правилно монтирани в съда на пробата. Направете справка с илюстрираната стъпка 2, която следва.
3. Уверете се, че тръбите на устройството за усвояване са правилно монтирани в съда на устройството за усвояване. Направете справка с илюстрираната стъпка 3, която следва.
4. Поставете вертикално всички тръбички за течност на анализатора към голяма бутилка с дейонизирана вода, за да направите тест на компонентите. Направете справка с илюстрираната стъпка 3, която следва. Тръбичката е инсталирана фабрично.

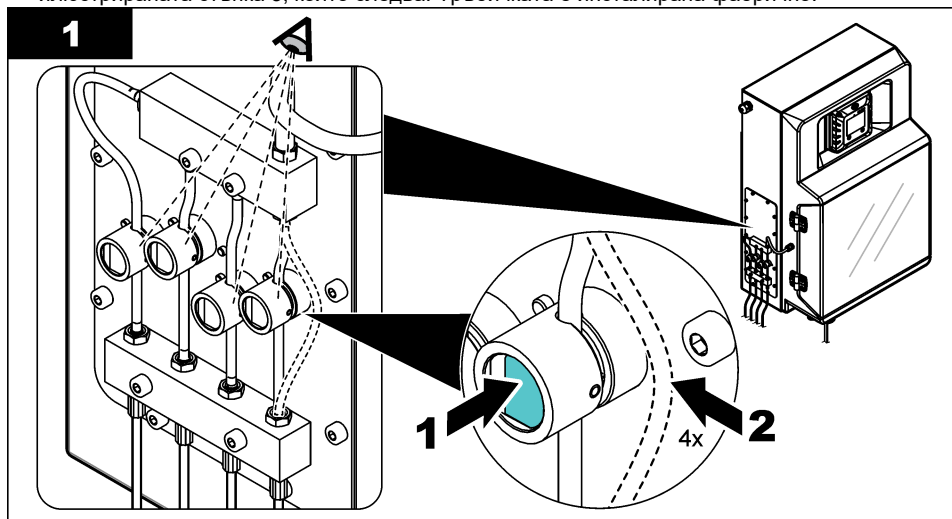

2



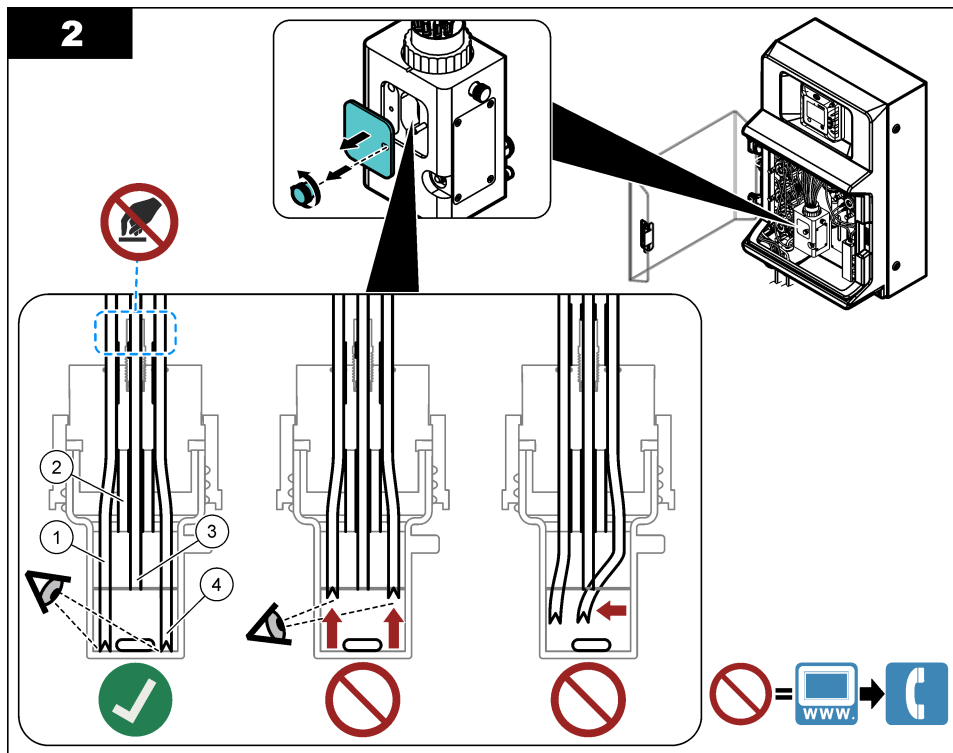


BG

1 Дренажни тръби	3 Тръби за проби
2 Тръби за реактиви и за отдушник (горни тръби)	4 Тръби за устройство за усвояване

3


BG

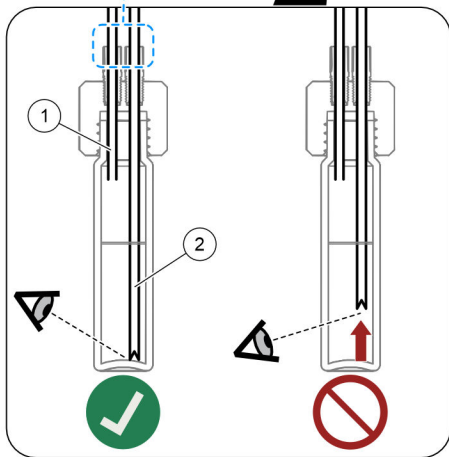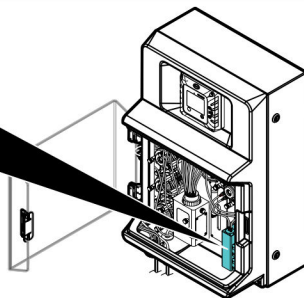

1 Тръби за отдушник

2 Тръби за устройство за усвояване

4

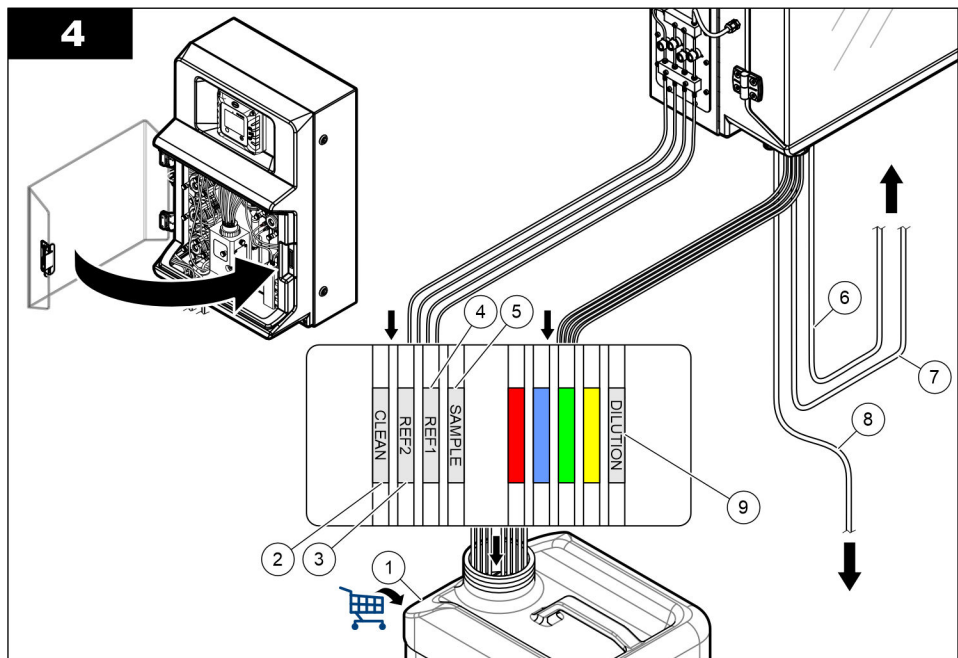

1 Дейонизирана вода	4 Тръба за референтен разтвор 1 (REF1)	7 Вентилационен отвор, устройство за усвояване
2 Тръба за почистващ разтвор	5 Входяща тръба за проби	8 Дренажни тръби
3 Тръба за референтен разтвор 2 (REF2)	6 Тръби за отдушник	9 Тръбички за разреждане и за микропомпи за реактиви

## Раздел 6 Включване

### 6.1 Първоначално стартиране

**Забележка:** Уверете се, че монтажните, тръбните и електрическите инсталации са изцяло завършени преди стартиране. Направете справка с [Инсталиране](#) на страница 233.

Когато анализаторът се включи за първи път, асистент за първоначално стартиране ще помогне с първите стъпки за извършване на настройката. Изпълнете всички стъпки, които следват, за да сте сигурни, че анализаторът работи правилно.

**Забележка:** Не забравяйте да използвате правилните реактиви за избрания диапазон на измерване. Направете справка с онлайн версията на разширеното ръководство за потребителя за повече информация.

- Отворете вратата на анализатора. Направете справка с [Отворете вратата на анализатора](#) на страница 234.
- Задайте превключвателя на захранването на ВКЛ. положение. Направете справка с [Фигура 9](#) на страница 460.
- Затворете вратата на анализатора с предоставения ключ.
- Изчакайте да завърши процедурата за инициализация.
- Отговорете на подканите на дисплея, за да изберете език, часова зона, дата и час.  
Направете справка с документацията на контролера SC4500, за да конфигурирате другите настройки на контролера.
- Докоснете дисплея за извеждане на менюто на **EZ2700sc**.

- Изберете **Меню на устройство**, за да стартирате асистента за първоначално стартиране. Извежда се началният екран.
- Завършете показаните на дисплея стъпки, за да изберете приложимия диапазон на измерване. Натиснете **ОК**.
- Ако има монтиран модул за филтрация, изберете **Вкл.**. Ако няма, изберете **Изкл.**.
- Изберете броя канали за анализатора. Натиснете **ОК**.
- Ако конфигурацията, показана на страницата на резюмето, е правилна, натиснете **ОК**. Извежда се главното меню на **EZ2700sc**.
- Продължете с теста на компонентите. Направете справка с [Изпълняване на изпитванията на компонентите](#) на страница 244.

## 6.2 Изпълняване на изпитванията на компонентите

### ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Опасност от прищипване. Движещите се части могат да причинят прищипване и нараняване. Не докосвайте движещите се части.

Изпълнете изпитванията на компонентите, преди да приведете анализатора в експлоатация. Използвайте менюто **Поддръжка**, за да стартирате различните функции на анализатора за проверка на работата на компонентите.

#### Предпоставки:

- Ако анализаторът е в работен режим, изберете **Поддръжка > Стартиране на режим на поддръжка**.
- Уверете се, че пробата, реактивът и тръбичката за разтвор са в контейнер с дейонизирана вода. Направете справка с [Вертикално поставяне на анализатора за теста на компонента](#) на страница 239.

#### 6.2.1 Проверка на бъркалката

- Отстранете светлинния щит от модула на фотометъра. Направете справка с [Фигура 13](#) на страница 472.
- Уверете се, че бъркалката е на дъното на съда за проба.  
**Забележка:** Проверете бъркалката по време на процедурата на запълване, за да се уверите, че бъркалката се върти правилно. Процедурата на запълване се стартира в [Проверка на помпите и клапаните с притискане](#) на страница 244.
- Инсталирайте светлинния щит на фотометъра.

#### 6.2.2 Проверка на помпите и клапаните с притискане

- Проверете работата на помпите и клапаните с притискане, за да се уверите, че няма течове.
- Уверете се, че съдът за анализ се пълни с дейонизирана вода. Направете справка с [Фигура 14](#) на страница 473.
- Уверете се, че дейонизираната вода излиза от тръбичката за източване.
- Изберете **Поддръжка > Стартиране на запълване** и запълнете всички течности поотделно.

В случай на теч проверете всички връзки и направете справка с онлайн версията на разширеното ръководство за потребителя за повече информация.

- Изберете **Запълване на референция 1** и натиснете **ОК**.
- Изберете **Запълване на референция 2** и натиснете **ОК**.
- Изберете **Запълване на почистващ разтвор** и натиснете **ОК**.
- Изберете **Запълване за изплакване** и натиснете **ОК**.

- e. Изберете **Запълване на дозатор** и натиснете **ОК**.
- f. Изберете **Запълване на канал > Запълване на всички канали** и натиснете **ОК**.  
Всяка процедура по запълване автоматично спира, когато завърши.

### 6.2.3 Проверка на микропомпите

Проверете микропомпите за течове и въздушни мехурчета.

1. Отстранете светлинния щит от фотометъра.
2. Изберете **Поддръжка > Стартиране на запълване > Запълване на всички реактиви**.
3. Уверете се, че дейонизираната вода навлиза в микропомпата през всяка от тръбите на микропомпата (реактив). След това в съда за анализ непрекъснато без въздушни мехурчета. Направете справка с **Фигура 15** на страница 475.
4. Ако микропомпите не работят правилно (мехурчета в тръбичката), използвайте процедурата със спринцовка, за да избутате дейонизирана вода в съответната тръбичка за премахване на мехурчетата. Направете справка с **Фигура 16** на страница 476.
5. Инсталирайте светлинния щит на фотометъра.

### 6.2.4 Направете проверка на фотометъра

Уверете се, че външната страна на съда на анализатора е чиста преди проверката на фотометъра, за да може тя да бъде извършена успешно. За почистване на компонентите на анализатора направете справка с онлайн версията на разширеното ръководство за потребителя за повече информация.

1. Натиснете иконата на главното меню, след което изберете **Устройства**.
2. Изберете **EZ2700sc**.
3. Превъртете надолу до долната част на екрана, след това изберете **Меню на устройство**.
4. Изберете **Поддръжка > Проверка на фотометъра**.
5. Натиснете **ОК**, за да стартирате измерването.  
Когато калибрирането на тъмно приключи, резултатът се показва на дисплея.
6. Натиснете **ОК**, за да продължите.
7. Уверете се, че тръбата „REF1“ е свързана към съд, пълен с дейонизирана вода. Уверете се, че светлинният щит е инсталиран. Направете справка с **Фигура 18** на страница 477.
8. Натиснете **ОК**.  
Изчакайте да се напълни съдът за анализ.
9. Използвайте отвертка, за да регулирате напрежението на изхода на сензора на 9 V.  
Направете справка с **Фигура 17** на страница 476.
10. Изчакайте, докато на екрана се покаже стойност 9 V. След това натиснете **ОК**.
11. Натиснете **ОК**, за да продължите.

### 6.3 Направете тест на входящ сигнал

Направете тест на цифровите входове, преди анализаторът да бъде приведен в експлоатация.

**Предварителни изисквания:** Свържете цифровите входове към външен контакт без потенциал (24 VDC).

Изпълнете тест за цифров входящ сигнал и аналогов изходящ сигнал, както следва:

1. Натиснете иконата на главното меню, след което изберете **Устройства**.
2. Изберете **EZ2700sc**.
3. Превъртете надолу до долната част на екрана, след това изберете **Меню на устройство**.
4. Изберете **Диагностика > Сигнали**.

Показват се сигналите при цифровите входове.

- Сравнете статуса на цифровите входове на дисплея с напреженията, подавани при цифровите входове (24 V = Вкл.; 0 V = Изкл.).

## 6.4 Изпълнете тест на изходящ сигнал

Изпълнете тест на аналоговите изходи, преди анализаторът да бъде приведен в експлоатация.

**Предварителни изисквания:** Конфигурирайте аналоговите изходи (AO1 – AO8, P101), за да изберете измерването на канала, представляван от всеки аналогов изход. Направете справка с онлайн версията на разширеното ръководство за потребителя за повече информация.

Направете тест на аналогов изходящ сигнал по следния начин:

- Натиснете иконата на главното меню.
- Изберете **Изходи > mA изход AOC > Тест/поддръжка**.

Опция	Описание
Функционален тест	Извършва тест на изходите на избрания модул.
Състояние на изхода	Показва състоянието на изходите на избрания модул.

- Използвайте мултиметър, за да измерите стойността в mA при всеки аналогов изход.
- Сравнете стойността в mA, измерена при аналоговите изходи, с очакваните стойности в mA.

## 6.5 Задаване на последователност на канали

Изберете последователността, в която се измерват каналите, броя на измерванията на всеки канал и времето на изчакване, преди даден канал да бъде измерен. Въведете максимум 16 позиции с максимум 16 цикъла всеки.

- Натиснете иконата на главното меню, след което изберете **Устройства**.
- Изберете **EZ2700sc**.
- Превъртете надолу до долната част на екрана, след това изберете **Меню на устройство**.
- Ако анализаторът е в работен режим, изберете **Поддръжка > Стартиране на режим на поддръжка**.  
Изчакайте, докато анализаторът не навлезе в режим на поддръжка.
- Изберете **Конфигурация > Настройване на последователност на каналите**.
- Използвайте стрелките на страничната лента, за да изберете позиция (номер в последователността), след това натиснете **OK**, за да конфигурирате тази позиция.
- Изберете опция.

Опция	Описание
Избиране	Избира приложимия канал или времето на изчакване.
Брой измервания	Задава броя на измерванията за даден канал.
Време на изчакване	Задава времето за изчакване за избрания канал.

- Натиснете **OK**, за да запазите промените.

## 6.6 Вертикално поставяне на разтворите и пробата

### ▲ ВНИМАНИЕ



Опасност от химическа експозиция. Спазвайте лабораторните процедури за безопасност и носете пълното необходимо лично предпазно оборудване при боравене със съответните химически вещества. За информация относно протоколите по безопасност направете справка с информационните листове за безопасност на материала (MSDS/SDS).

## ⚠ ВНИМАНИЕ



Опасност от химическа експозиция. Изхвърляйте химическите и отпадъчни вещества в съответствие с местните, регионални и национални разпоредби.

## ⚠ ВНИМАНИЕ



Опасност от пожар. Това устройство не е предназначено за употреба със запалими течности.

BG

Съдовете за реактиви се доставят с анализатора. Направете справка с [Фигура 18](#) на страница 477. Съдовете за референтен разтвор 1 и референтен разтвор 2, и за дейонизирана вода се осигуряват от потребителя. От производителя могат да бъдат закупени още контейнери.

Поставете контейнерите

- възможно най-близо до анализатора
- 1 метър под долната страна на анализатора

Направете справка с [Фигура 18](#) на страница 477 за монтаж на съда.

Реактивите и разтворите се предоставят от потребителя. Използвайте само реактиви, предоставени от сертифицирана компания, или използвайте специализирани реактиви на производителя. Като алтернатива реактивите могат да се приготвят от потребителя. Следвайте инструкциите в листа с методи и реактиви за приложимия модел, който можете да намерите на уебсайта на производителя.

Тръбичката е инсталирана фабрично. Прочетете етикета на всяка тръба, за да определите правилното свързване на тръбите. Направете справка с приложимия лист за метод и реактив за модела, който можете да намерите на уебсайта на производителя, за правилните реактиви, разтвори и стандарти.

1. След като се извършат изпитванията на компонентите, инсталирайте тръбичките за „CLEAN“ (почистващ разтвор), „REF1“ (референтен разтвор 1) и „REF2“ (референтен разтвор 2) в съответните контейнери. Направете справка с [Фигура 18](#) на страница 477.
2. Инсталирайте всяка цветно кодирана тръба за реактив в контейнера за реактив със същия цвят на етикета.
3. Поставете вертикално източника за проби (или изхода за проби на панела Moduplex или панела на филтъра) към входящата тръба за проби на анализатора. Направете справка с [Фигура 18](#) на страница 477.
4. Натиснете иконата на главното меню, след което изберете **Устройства**.
5. Изберете **EZ2700sc**.
6. Превъртете надолу до долната част на екрана, след това изберете **Меню на устройство**.
7. Изберете **Поддръжка > Стартиране на запълване > Запълване на всичко**.

## 6.7 Преди първоначално стартиране извършете валидиране

Извършете валидиране, за да се уверите, че измерванията са в рамките на диапазона от допуски. Направете справка с онлайн версията на разширеното ръководство за потребителя за повече информация.

1. Натиснете иконата на главното меню, след което изберете **Устройства**.
2. Изберете **EZ2700sc**.
3. Превъртете надолу до долната част на екрана, след това изберете **Меню на устройство**.
4. За да стартирате валидиране, изберете **Калибриране > Валидиране > Стартиране на валидирането**.

Валидирането измерва дейонизираната вода в бутилката с референция 2.

5. За показване на резултатите изберете опция:
  - Калибриране > Валидиране > Хронология на валидирането
  - Диагностика > Хронологични данни > Валидиране

## 6.8 Стартиране на анализатора

За стартиране на анализатора:

1. Натиснете иконата на главното меню, след което изберете **Устройства**.
2. Изберете **EZ2700sc**.
3. Превъртете надолу до долната част на екрана, след това изберете **Меню на устройство**.
4. Изберете **Поддръжка > Стартиране на работен режим**.

# Tartalomjegyzék

1	További információ	oldalon 249
2	A termék áttekintése	oldalon 249
3	Műszaki jellemzők	oldalon 250

4	Általános tudnivaló	oldalon 251
5	Beszerelés	oldalon 253
6	Beindítás	oldalon 262

## Szakasz 1 További információ

Az alap felhasználói kézikönyv elegendő információt tartalmaz az üzembe helyezéshez. A bővített felhasználói kézikönyv online elérhető, és további információkat tartalmaz.

### ▲ VESZÉLY



Többszörös veszély! További információkat a bővített felhasználói kézikönyv alább látható egyes részei tartalmaznak.

- Kezelőfelület és navigálás
- Működtetés
- Karbantartás
- Hibaelhárítás
- Cserealkatrész-listák

A következő QR-kódok beolvasásával juthat el a bővített felhasználói kézikönyvhöz.



Európai nyelvek



Amerikai és ázsiai nyelvek

## Szakasz 2 A termék áttekintése

A Hach EZ2700sc analízátor egy online berendezés, amely az ipari és környezetvédelmi alkalmazásokból származó vízminták egy paraméterének vizsgálatára szolgál. Lásd: [1. ábra](#) oldalon 438, [2. ábra](#) oldalon 442 és [3. ábra](#) oldalon 447.

Az analízátor egy általános vízvizsgálathoz készült (pl. nitrát, foszfát) online kolorimetriás analízátor. Az analízátor távoli indítási, automatikus hitelesítési, automatikus kalibrálási, automatikus tisztítási és Modbus opciókkal rendelkezik.

A mintavíz a mintacsövön keresztül lép be az analízátorba. Az analízátorban lévő szivattyúk, szelepek és fecskendők segítségével a minta és a reagensek az elemzőpanelen található mérőcellába jutnak. Ha az elemzőtartályban megtörtént az elemzés, az analízátor az ürítőcsövön keresztül kiüríti a mintát. Az elemzés eredményei megjelennek az SC4500 vezérlő kijelzőjén. Az SC4500 vezérlő elmenti az analízátor adatait (adatnapló, eseménynapló, beállítánapló és szerviznapló). Az SC4500 vezérlő az analízátor működtetésére és konfigurálására szolgál.

Az analízátor által mérni képes mintaáramok (csatornák) számának növeléséhez (2, 4 vagy 8) vásároljon Moduplex többáramú panelt az analízátorhoz.

A minta előkészítéséhez (szűrés, ülepítés) vásárolja meg az EZ9010, EZ9020, EZ9150, EZ9200 vagy EZ9250 szűrőpanelt az analízátorhoz.

## Szakasz 3 Műszaki jellemzők

A műszaki jellemzők előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

Specifikációk	Részletek
Méret (Sz x Ma x Mé)	460 x 688 x 340 mm (18,1 x 27,1 x 13,4 hüvelyk)
Ház	IP44; ABS, PMMA és bevonattal ellátott acél
Kijelző	IP66, 3,5 hüvelykes színes TFT-kijelző kapacitív érintőfelülettel
Tömeg	40 kg (88 lb)
Teljesítményigény	100–240 V AC $\pm$ 10%, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel	Legfeljebb 240 VA
Magasság	Legfeljebb 2000 m (6560 láb)
Tűlfeszültség-kategória	II
Környezeti feltételek	Csak zárt térben használható
Szennyezési fok	2
Üzemi hőmérséklet	10 és 30 °C (50 és 86 °F) között; 5 és 95% közötti relatív páratartalom, nem lecsapódó, korrozíóálló
Tárolási hőmérséklet	-20 és 60 °C (-4 és 140 °F) között; legfeljebb 95%-os relatív páratartalom, nem kondenzálódó
Mintabemenetek	Egy
Minta nyomása	Külső túlfolyótartály által (légköri nyomásra nyílik)
Minta áramlási sebessége	100 - 300 mL/perc
Minta hőmérséklete	10 és 30 °C (50 és 86 °F) között
Minta minősége	< 100 $\mu$ m-es részecskék, legfeljebb < 0,1 g/L Zavarosság, < 50 NTU
Tisztítólevegő korrozív környezetek esetén	0,2 bar (20 kPa vagy 3 psi); száraz és tiszta levegő
Úritő	Légköri nyomás, szellőztetett, minimális átmérő: 32 mm
Földelés	Alacsony impedanciájú (<1 $\Omega$ ), száraz és tiszta földelőszlop 2,5 mm-nél <sup>1</sup> (13 AWG) hosszabb földelőkábelrel
Analog kimenetek	Legfeljebb nyolc 0–20 mA (vagy 4–20 mA) analog kimenet <b>Megjegyzés:</b> Az analog kimenetek szolgáltatják a hurok tápellátását. A SCADA- vagy a PLC-rendszer érintkezőinek áramellátása nem biztosítható.
Digitális bemenetek	Hét digitális bemenet: Két digitális bemenet a távindítás számára. A fennmaradó digitális bemenetek jövőbeli használatra szolgálnak.
Digitális kimenetek	Négy feszültség alatt lévő digitális kimenet az EZ9150 panel szelepei és szivattyúi számára; nyolc feszültség alatt lévő digitális kimenet a Moduplex panel szelepei számára; 24 V DC, 500 mA.
Relék	Öt feszültségmentes érintkező (FCT), maximális terhelhetőség: 24 V DC, 0,5 A (rezisztív terhelés)
Ethernet-csatlakozók	Claros Ethernet-kapcsolat és Modbus TCP/IP Ethernet-csatlakozó; LAN-verzió: 10/100 Mbps, vagy Profinet vagy Ethernet IP
RS485-kommunikáció	Profibus DP vagy Modbus RTU

<sup>2</sup> Az Ethernet-konfigurációval és a Modbus-konfigurációval kapcsolatos információért tekintse meg az SC4500 vezérlő dokumentációját.

Specifikációk	Részletek
Tanúsítványok	CE, ETL tanúsítvány az UL és a CSA biztonsági szabványok szerint, UKCA
Jótállás	1 év (EU: 2 év)

## Szakasz 4 Általános tudnivaló

A gyártó semmilyen esetben sem vállal felelősséget a termék nem megfelelő használatából vagy a kézikönyv utasításainak be nem tartásából eredő károkért. A gyártó fenntartja a kézikönyv és az abban leírt termékek megváltoztatásának jogát minden értesítés vagy kötelezettség nélkül. Az átdolgozott kiadások a gyártó webhelyén találhatóak.

HU

### 4.1 Biztonsági tudnivalók

A gyártó nem vállal felelősséget a termék nem rendeltetésszerű alkalmazásából vagy használatából eredő semmilyen kárért, beleértve de nem kizárólag a közvetlen, véletlen vagy közvetett károkat, és az érvényes jogszabályok alapján teljes mértékben elhárítja az ilyen kárigényeket. Kizárólag a felhasználó felelőssége, hogy felismerje a komoly alkalmazási kockázatokat, és megfelelő mechanizmusokat szereljen fel a folyamatok védelme érdekében a berendezés lehetséges meghibásodása esetén.

Kérjük, olvassa végig ezt a kézikönyvet a készülék kicsomagolása, beállítása vagy működtetése előtt. Szenteljen figyelmet az összes veszélyjelző és óvatosságra intő mondatra. Ennek elmulasztása a kezelő súlyos sérüléséhez vagy a berendezés megrongálódásához vezethet.

Ha a berendezést nem a gyártó által előírt módon használják, a berendezés által nyújtott védelem csökkenhet. Ne használja, vagy állítsa üzembe ezt az eszközt az ebben a kézikönyvben leírtaktól eltérő módon.

#### 4.1.1 A veszélyekkel kapcsolatos tudnivalók alkalmazása

#### ▲ VESZÉLY

Lehetséges vagy közvetlenül veszélyes helyzetet jelez, amely halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezet.

#### ▲ FIGYELMEZTETÉS

Lehetséges vagy közvetlenül veszélyes helyzetet jelez, amely halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet.

#### ▲ VIGYÁZAT



Lehetséges veszélyes helyzetet jelez, amely enyhe vagy kevésbé súlyos sérüléshez vezethet.





#### MEGJEGYZÉS

A készülék esetleges károsodását okozó helyzet lehetőségét jelzi. Különleges figyelmet igénylő tudnivaló.


#### 4.1.2 Figyelmeztető címkék

Olvassa el a műszerhez csatolt valamennyi címkét és függő címkét. Ha nem tartja be, ami rajtuk olvasható, személyi sérülés vagy műszer rongálódás következhet be. A műszeren látható szimbólum jelentését a kézikönyv egy óvintézkedési mondattal adja meg.

	Ez a biztonsági figyelmeztetés szimbóluma. A személyi sérülések elkerülése érdekében tartson be minden biztonsági utasítást, amely ezt a szimbólumot követi. Ha ezt a jelzést a műszeren látja, az üzemeltetésre és biztonságra vonatkozó információkért olvassa el a használati utasítást.
	Ez a szimbólum vegyi ártalom veszélyét jelzi, valamint hogy csak vegyszerek használatára kiképzett személyek kezelhetik a vegyszereket, illetve végezhetnek karbantartást a berendezéshez tartozó vegyszertovábbító rendszereken.

	Ez a szimbólum áramütés, illetőleg halálos áramütés kockázatára figyelmeztet.
	Ez a szimbólum elektrosztatikus kisülésre (ESD) érzékeny eszközök jelenlétére figyelmeztet, és hogy intézkedni kell az ilyen eszközök megvédése érdekében.
	Az ilyen szimbólummal jelölt készülékhez védőföldelést kell csatlakoztatni. Ha a berendezés nem rendelkezik földelési csatlakozóval a vezetéken, hozza létre a védőföldelést a biztonsági vezetőterminálon.
	Az ezzel a szimbólummal jelölt elektromos készülékek Európában nem helyezhetők háztartási vagy lakossági hulladékfeldolgozó rendszerekbe. A gyártó köteles ingyenesen átvenni a felhasználóktól a régi vagy elhasználódott elektromos készülékeket.

### 4.1.3 Vegyi és biológiai biztonság

<b>▲ VESZÉLY</b>	
	Kémiai vagy biológiai veszélyek. Ha ez a műszer olyan kezelési folyamat és/vagy vegyszeradagoló rendszer megfigyelésére szolgál, amelyre a közegészségüggyel, közbiztonsággal, élelmiszer- és italgyártással vagy -feldolgozással kapcsolatos jogszabályi korlátozások vonatkoznak, a műszer felhasználójának a felelőssége, hogy ismerjen és betartson minden vonatkozó rendszabályt, és hogy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően elégséges és megfelelő mechanizmust biztosítson arra az esetre, ha a műszer meghibásodna.

## 4.2 Az illusztrációkon használt ikonok

				
Gyártó biztosította alkatrészek	Felhasználó biztosította alkatrészek	Néz	Fordított sorrendben végezze el a lépéseket	
				
Két ember végezze	Hallgat	Csak az ujjait használja	Ne használjon szerszámokat	Ne érintse meg

## 4.3 Tervezett felhasználás

A Hach EZ-sorozatú analizátorai olyan személyek számára készültek, akiknek folyamatosan mérniük kell a víz minőségi paramétereit az ipari és környezetvédelmi alkalmazásokból származó mintákban. A Hach EZ-sorozatú analizátorai nem kezelik a vizet, nem befolyásolják annak minőségét, és nem vezérik a folyamatokat.

## 4.4 A termék részegységei

Győződjön meg róla, hogy minden részegységet megkapott-e. **4. ábra** oldalon 451 Ha valamelyik tétel hiányzik vagy sérült, forduljon azonnal a gyártóhoz vagy a forgalmazóhoz.

## Szakasz 5 Beszerelés

### ▲ VESZÉLY



Többszörös veszély. A dokumentumnak ebben a fejezetében ismertetett feladatokat csak képzett szakemberek végezhetik el.

### 5.1 Összeszerelési irányelvek

#### ▲ FIGYELMEZTETÉS



Tűzveszély. A felhasználó felelős a megfelelő biztonsági előírások betartásáért, ha az eszközt olyan módszerekkel használják, amelyek gyúlékony folyadékokat alkalmaznak. Kövesse a megfelelő felhasználói előírásokat és biztonsági protokollokat. Ide tartoznak többek között, de nem kizárólagosan az alábbiak: kiömlött anyagok és szivárgások ellenőrzése, megfelelő szellőzés, felügyelet melletti használat, valamint felügyelet bekapcsolás műszer esetén.

#### ▲ VIGYÁZAT



Kémiai expozíció veszélye. Kövesse a laboratóriumi biztonsági eljárásokat, és viselje a kezelt vegyszereknek megfelelő összes személyes védőfelszerelést. A biztonsági protokollokkal kapcsolatban lásd az aktuális biztonsági adatlapokat (MSDS/SDS).

#### ▲ VIGYÁZAT



Kémiai expozíció veszélye. Semmisítse meg a vegyszereket és a hulladékokat a helyi, területi és nemzeti előírásoknak megfelelően.

- Az analizátort zárt helyiségben, veszélyektől mentes környezetben szerelje össze.
- Olyan környezetben telepítse az analizátort, mely védett a korrozív folyadékoktól.
- Az analizátort tiszta, száraz, jól szellőző és hőmérséklet-szabályozott helyen helyezze üzembe.
- Az analizátort a mintavételi ponthoz lehető legközelebb helyezze üzembe.
- Az analizátort ne helyezze közvetlen napsütésnek kitett helyre vagy hőforrások közelébe.
- Biztosítson elegendő helyet a csőhálózat és az elektromos csatlakozások számára.
- Az analizátor ajtajának kinyitásához hagyjon elegendő helyet az analizátor előtt. Lásd: [Az analizátor méretei](#) oldalon 254.
- Ellenőrizze, hogy a környezeti feltételek megfelelnek-e a működési előírásoknak. Lásd: [Műszaki jellemzők](#) oldalon 250.

Bár az analizátor nem gyúlékony mintákkal való használatra készült, egyes EZ-analizátorok gyúlékony reagenseket használnak. Az analizátorban használt reagensekkel kapcsolatos további információkért tekintse meg a megfelelő EZ sorozatú modell módszer- és reagenslapját. Ha az analizátor gyúlékony reagenseket használ, mindenképpen tartsa be az alábbi biztonsági óvintézkedéseket:

- Tartsa távol az analizátort hőtől, szikráktól és nyílt lángtól.
- Ne egyen, igyon vagy dohányozzon az analizátor közelében.
- Használjon egy helyi elvezető szellőztetőrendszert.
- Szikra- és robbanásbiztos berendezéseket és világítórendszert használjon.
- Kerülje az elektrosztatikus kisüléseket. Lásd: [Elektrosztatikus kisüléssel \(ESD\) kapcsolatos megfontolások](#) oldalon 254.
- Használat előtt teljesen tisztítsa és szárítsa meg a műszert.
- Szünetek előtt és a munkaidő végén mindig mosson kezet.
- Vegye le a szennyezett ruhadarabokat. Újbóli használat előtt mossa ki a ruhadarabokat.
- Az ilyen folyadékokat a helyi szabályozótestület követelményei szerint, a megengedett kitettségi határértékek betartása mellett kell kezelni.

## 5.2 Az analizátor méretei

Az analizátor méreteivel kapcsolatban lásd: [5. ábra](#) oldalon 454.

## 5.3 Mechanikai felszerelés

### 5.3.1 A műszer falra történő felszerelése

#### ▲ FIGYELMEZTETÉS



Személyi sérülés veszélye. Ügyeljen arra, hogy a fali tartó képes legyen a berendezés tömege 4-szeresének megtartására.

#### ▲ FIGYELMEZTETÉS



Személyi sérülés veszélye. A műszerek vagy az alkatrészek nehezek. Kérjen segítséget a szereléshez és a mozgatáshoz.

#### ▲ FIGYELMEZTETÉS



Személyi sérülés veszélye. A tárgy nehéz. Győződjön meg arról, hogy az eszköz biztonságosan hozzá van rögzítve a megfelelő falhoz, asztalhoz vagy padlóhoz a biztonságos üzemeltetés érdekében.

A mellékelt rögzítőkonzolok használatával a műszert állítva és vízszintesen sík, függőleges falfelületre rögzítheti. Lásd: [6. ábra](#) oldalon 456.

Olyan helyre és olyan helyzetben szerelje fel a műszert, hogy a felhasználó könnyedén leválaszthassa azt a tápforrásról.

Ügyeljen rá, hogy elegendő szabad hely legyen az analizátor alatt a palackok behelyezéséhez.

A rögzítőszerelvényekről a felhasználónak kell gondoskodnia. Ügyeljen rá, hogy a fali rögzítő kellő teherbírási kapacitással rendelkezzen (körülbelül 160 kg vagy 353 font). A rögzítőszerelvényeknek jóváhagyással kell rendelkezniük a fal tulajdonságaira vonatkozóan.

### 5.3.2 Az analizátor ajtajának kinyitása

Használja a mellékelt gombot a két zárolás feloldásához az analizátor oldalán. Lásd: [7. ábra](#) oldalon 456. Ügyeljen arra, hogy az ajtó becsukása a működés megkezdése előtt megőrizze a burkolatot és a biztonsági fokozatot.

## 5.4 Elektromos üzembe helyezés

#### ▲ VESZÉLY



Halálos áramütés veszélye. Mindig áramtalanítsa a műszert, mielőtt elektromosan csatlakoztatja.

### 5.4.1 Elektrosztatikus kisüléssel (ESD) kapcsolatos megfontolások

#### MEGJEGYZÉS



Lehetséges károsodás a készülékben. Az érzékeny belső elektronikus rendszerelemek megsérülhetnek a statikus elektromosság következtében, amely csökkenti a működőképességet, vagy esetleges leállást eredményezhet.

A villamos kisülés okozta károsodás elkerülése érdekében hajtsa végre az alábbi műveleteket:

- Földelt fémfelület (például egy műszer szerelvénylapja, fém vezető vagy cső) megérintésével süsse ki a testében lévő statikus elektromosságot.
- Kerülje a túlzott mozgást. A statikus elektromosságra érzékeny alkatrészeket antistatikus tárolóban vagy csomagolásban szállítsa.

- Viseljen földelt csuklópántot.
- Dolgozzon antisztatikus környezetben, antisztatikus padlószőnyegen és ilyen borítású munkaasztalon.

## 5.4.2 Hozzáférés az elektromos részekhez

Vezesse át a külső eszközök kábeleit a tömszelencéken. Lásd: [8. ábra](#) oldalon 458. A nem használt tömszelencéket hagyja ledugózva.

A [9. ábra](#) oldalon 461 bemutatja az analizátor belsejében lévő alkatrészeket. A hálózati kapcsoló egy olyan áramkörü megszakító, amely túláram (pl. rövidzárlat) vagy túlfeszültség esetén automatikusan megszakítja a váltóáramú hálózat tápfeszültségét.

## 5.4.3 A külső eszközök csatlakoztatása

Csatlakoztassa az analizátorral használni kívánt külső eszközöket az analizátor jel- és vezérlőcsatlakozóihoz. Lásd: [10. ábra](#) oldalon 464 és [1. táblázat](#) oldalon 255.

1. táblázat Jel- és vezérlőcsatlakozók – Leírások

Tüérintkező	Leírás
AO1–AO8 (P101)	Nyolc digitális kimenet a külső eszközök vezérléséhez. Lásd: .További információkért tekintse meg a bővített felhasználói kézikönyv online változatát.
FCT1–FCT5 (P102)	Öt relé (potenciálmentes érintkezők). A maximális terhelés 24 V DC, 0,5 A. <ul style="list-style-type: none"> <li>• FCT1 – Üzemzavar miatti riasztás</li> <li>• FCT2 – Karbantartási riasztás</li> <li>• FCT3 – Az analizátor készen áll</li> <li>• FCT4 és FCT5 – Jövőbeli használatra</li> </ul>
DI1–DI7 (P103)	Hét digitális bemenet az analizátor távvezérléséhez <sup>5</sup> Csatlakoztassa a digitális bemeneteket egy külső potenciálmentes érintkezőhöz (24 V DC) az analizátor mérési funkciójának elindításához egy csatornára vonatkozóan. <ul style="list-style-type: none"> <li>• DI1 – Távoli indítás az 1. csatornára vonatkozóan</li> <li>• DI2 – Távoli indítás a 2. csatornára vonatkozóan</li> <li>• DI3–DI7 – Jövőbeli használatra</li> </ul>
FB1–FB4 (P104)	Profibus DP vagy Modbus RTU (RS485) csatlakozók <b>Profibus DP:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FB1 – A1 (bemenet)</li> <li>• FB2 – A2 (kimenet)</li> <li>• FB3 – B1 (bemenet)</li> <li>• FB4 – B2 (kimenet)</li> <li>• SHL – Árnycékolás</li> </ul> <b>Modbus RTU:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FB1 – D (+)</li> <li>• FB2 – D (-)</li> <li>• FB3 – nincs használatban</li> <li>• FB4 – nincs használatban</li> <li>• SHL – Árnycékolás</li> </ul> <p>A Modbus-konfigurációs utasításokkal és a telegram-címekkel kapcsolatban tekintse meg az SC4500 vezérlő dokumentációját.</p>
24 V DC/1 A (P105)	24 V DC tápellátás az EZ9010 és EZ9020 szűrőegységek számára

<sup>5</sup> Ha az analizátor karbantartási módban van, a távvezérlést letiltja a rendszer.

## 1. táblázat Jel- és vezérlőcsatlakozók – Leírások (folytatás)

Tűérintkező	Leírás
STR1–STR8 (P106)	Nyolc digitális kimenet az opcionális Moduplex panel számára. Csatlakoztassa a Moduplex panel egyes csatornaszelepeinek csupasz vezetékét a megfelelő STR-csatlakozókhoz. <ul style="list-style-type: none"> <li>• STR1 – 1. csatorna</li> <li>• STR2 – 2. csatorna</li> <li>• ...</li> <li>• STR8 – 8. csatorna</li> </ul>
EXT9–EXT12 (P107)	Négy digitális kimenet az opcionális EZ9150 szűrőpanel számára. Csatlakoztassa az EZ9150 szűrőpanelen lévő elektromos szelepeket és szivattyút az EXT-csatlakozókhoz. <ul style="list-style-type: none"> <li>• EXT9 – Öblítőszelep</li> <li>• EXT10 – Visszaöblítő-szelep</li> <li>• EXT11 – Leeresztő túlfolyószelepe</li> <li>• EXT12 – Szűrőszivattyú</li> </ul>
D01–D06 (P108 and P109)	Az EZ9150 panel hat pneumatikusszelep-kimenete. <ul style="list-style-type: none"> <li>• D01—Minta bemenet szelepe</li> <li>• D02—Leeresztő túlfolyószelepe</li> <li>• D03—1. csatorna szelepe</li> <li>• D04—2. csatorna szelepe</li> <li>• D05—3. csatorna szelepe</li> <li>• D06—4. csatorna szelepe</li> </ul>

### 5.4.4 Csatlakoztatás váltóáramú hálózatra

#### ⚠ VESZÉLY



Elektromos áramütés- és tűzveszély. Győződjön meg arról, hogy a mellékelt kábel és a nem rögzítő dugó megfelel az alkalmazandó országkód követelményeinek.


- Győződjön meg arról, hogy az áramkörhöz elegendő áramerősségi kapacitással rendelkező megszakító tartozik.
- Az analizátor közelében mindenképpen legyen felszerelve áramkör-megszakító vagy vészhelyzeti kapcsoló arra az esetre, ha az analizátort azonnal áramtalanítani kellene.
- A felszerelést a helyi, állami vagy nemzeti villamos szabványnak megfelelően csatlakoztassa.
- Szerelje be a mellékelt tápvezetékét az analizátor oldalán lévő tömszelencén keresztül.
- Szorítsa meg a tömszelencét úgy, hogy biztonságosan rögzítse a tápvezetékét, és fennmaradjon a ház környezeti besorolása.

Csatlakoztassa az analizátort váltóáramú tápellátáshoz a mellékelt váltóáramú tápvezetékkel. Lásd: 2. táblázat oldalon 257 és 11. ábra oldalon 468.

## MEGJEGYZÉS

Ne kapcsolja be a tápkapcsolót. Csatlakoztassa az összes elektromos és csővezeték az indítás előtt, máskülönben az analizátor károsodhat.

### 2. táblázat Vezetékezéssel kapcsolatos információk – váltóáram

Csatlakozó	Leírás	Kábel szín-Észak-Amerika és Kanada	Kábel színe-EU
L	Fázis (L)	Fekete (1)	Barna
N	Nulla (N)	Fehér (2)	Kék
	Védőföldelés (PE)	Zöld, sárga csíkkal	Zöld, sárga csíkkal

HU

## 5.5 Vezetékszerelés

### 5.5.1 Mintavezetékre vonatkozó útmutató

#### ▲ VIGYÁZAT



Tűzveszély. A terméket nem olyan minták fejlesztették ki, amelyek gyúlékonyak.

A készülék optimális teljesítménye érdekében válasszon reprezentatív mintavételi pontot. A mintának az egész rendszerre jellemzőnek kell lennie.

- Biztosítsa, hogy a minta áramlási sebessége magasabb legyen az analizátorba áramló folyadék sebességénél.
- Ha az analizátor a minta elemzőtartályba történő juttatásához perisztaltikus szivattyút használ, ellenőrizze, hogy a mintavezetékben légköri nyomás uralkodik-e.
- Ellenőrizze, hogy a mintavezeték az analizátor közelében található túlfolyótartályból gyűjti-e a mintát.
- A mellékelt mintavezetékét használja. A mintavezeték hosszát ne módosítsa.

A túlfolyótartályban lévő mintát folyamatosan frissen kell tartani. Ha a minta túl magas szilárdanyag-tartalommal rendelkezik, a minta szűrése is ajánlott.

### 5.5.2 A leeresztővezetékre vonatkozó előírások

#### ▲ FIGYELMEZTETÉS



Tűzveszély. A felhasználó felelős a megfelelő biztonsági előírások betartásáért, ha az eszközt olyan módszerekkel használják, amelyek gyúlékony folyadékokat alkalmaznak. Kövesse a megfelelő felhasználói előírásokat és biztonsági protokollokat. Ide tartoznak többek között, de nem kizárólagosan az alábbiak: kiömlött anyagok és szivárgások ellenőrzése, megfelelő szellőzés, felügyelet melletti használat, valamint felügyelet bekapcsolt műszer esetén.

#### ▲ VIGYÁZAT



Kémiai expozíció veszélye. Semmisítse meg a vegyszereket és a hulladékokat a helyi, területi és nemzeti előírásoknak megfelelően.

## MEGJEGYZÉS

Az ellennyomás és az analizátor sérüléseinek elkerülése érdekében a leeresztővezetékét ne csatlakoztassa más vezetékhez. Biztosítsa, hogy a leeresztővezeték a levegő irányába nyitottak-e.

## MEGJEGYZÉS

Az ellennyomás és az analizátor sérülésének megakadályozása érdekében az analizátort helyezze a leeresztőkhöz képest magasabb helyre, és biztosítsa, hogy a leeresztővezetékek minden szakaszon lefelé haladjanak. A leeresztővezetéseket úgy telepítse, hogy 0,3 méterenként a szintcsökkenés legalább 2,54 cm legyen.

Az analizátor az elemzést követően a mintát és a reagenseket a leeresztővezetéken keresztül eresztile. A leeresztővezetékek megfelelő felszerelése nagyon fontos, hogy az összes folyadék biztosan távozzon a műszerből. A nem megfelelő felszerelés miatt a folyadék visszaáramolhat a műszerbe, és ez sérülést okozhat. A leeresztővezetéseket egy padlólefolyóba vagy egy mosogató lefolyójába kell vezetni. A leeresztővezeték ajánlott külső átmérője 32 mm. Lásd: [12. ábra](#) oldalon 470.

- A leeresztővezetékeknek a lehető legrövidebbnek kell lenniük.
- Biztosítsa, hogy a lefolyó az analizátor szintje alatt helyezkedjen el.
- A leeresztővezetékek mindig lejtsek.
- Biztosítsa, hogy a leeresztővezetékek nem hajoljanak meg élesen, illetve ne nyomódjanak össze.
- Ügyeljen rá, hogy a leeresztővezetékek a levegő felé nyitottak legyenek, nyomásuk pedig nulla legyen.
- Ügyeljen rá, hogy a leeresztővezetékek a berendezéshelyiség belseje felé zártak legyenek.
- Ne tömítse vagy merítse folyadékba a leeresztővezeteket.

Az analizátort ajánlott a vízvezeték mellett elhelyezni, hogy a lefolyó és annak csövei tiszta víz segítségével rendszeresen átöblíthetők legyenek, amivel megelőzhető a vízkőképződés miatt bekövetkező dugulás.

Az analizátorban használt reagensekkel kapcsolatos további információért tekintse meg a megfelelő EZ sorozatú modell módszer- és reagenslapját. Ha az analizátor gyúlékony reagenseket használ, mindenképpen tartsa be az alábbi biztonsági óvintézkedéseket:

- Ne csatlakoztassa a leeresztőcsövet egy padlólefolyóhoz.
- A hulladékok leselejtezésekor a helyi, állami és nemzeti környezetvédelmi előírásokkal összhangban járjon el.

### 5.5.3 A szellőztetővezetékre vonatkozó előírások

#### ▲ FIGYELMEZTETÉS



Tűzveszély. A felhasználó felelős a megfelelő biztonsági előírások betartásáért, ha az eszközt olyan módszerekkel használják, amelyek gyúlékony folyadékokat alkalmaznak. Kövesse a megfelelő felhasználói előírásokat és biztonsági protokollokat. Ide tartoznak többek között, de nem kizárólagosan az alábbiak: kiömlött anyagok és szivárgások ellenőrzése, megfelelő szellőzés, felügyelet melletti használat, valamint felügyelet bekapcsolt műszer esetén.

#### ▲ VIGYÁZAT



Kémiai expozíció veszélye. Semmisítse meg a vegyszereket és a hulladékokat a helyi, területi és nemzeti előírásoknak megfelelően.

## MEGJEGYZÉS

Az ellennyomás és az analizátor károsodásának elkerülése érdekében a szellőztetővezeteket (használtgáz-csatlakozót) ne csatlakoztassa más vezetékhez. Ügyeljen rá, hogy a szellőztetővezeték az épület külső része felé nyitott legyen.

## MEGJEGYZÉS

Az ellennyomás és az analizátor sérülésének megakadályozása érdekében az analizátort helyezze a szellőző(k)hoz képest magasabb helyre, és biztosítsa, hogy a szellőztetővezeték minden szakaszon lefelé haladjon. A szellőztetővezetéseket úgy telepítse, hogy 0,3 méterenként a szintcsökkenés legalább 2,54 cm legyen.

Az analizátor az elemzőtartály légköri nyomáson való tartásához használja a szellőzővezeteket. A szellőzővezeték helyes felszerelése fontos annak biztosításához, hogy a szivattyú működése közben ne jusson folyadék az elemzőtartályba a szellőzővezetékéből. A nem megfelelő felszerelés miatt a gáz

visszaáramolhat az analizátorba, ami károsodáshoz vezethet. A szellőztetővezeték gyűjtőcsövének javasolt külső átmérője 32 mm. Lásd: [12. ábra](#) oldalon 470.

- A szellőztetővezeték legyen a lehető legrövidebb.
- Ügyeljen rá, hogy a szellőztetővezeték minden szakaszon lejtsen.
- Ügyeljen rá, hogy a szellőztetővezetékben ne legyenek éles hajlítások, illetve ne legyen összenyomódva.
- Ügyeljen rá, hogy a szellőztetővezeték a berendezéshelyiség belseje felé zárt legyen, a nyomása pedig nulla legyen.
- Ügyeljen rá, hogy a szellőztetővezeték mindig magasabban legyen, mint a lefolyócső.
- Ne tömítse vagy merítse folyadékba a szellőztetővezetékét.

Ha az analizátor gyúlékony reagenseket használ, mindenképpen tartsa be az alábbi biztonsági óvintézkedéseket:

- Ne csatlakoztassa a szellőztetőcsövet egy padlólefolyóhoz.
- A hulladékok leselejtezésekor a helyi, állami és nemzeti környezetvédelmi előírásokkal összhangban járjon el.

### 5.5.4 Az analizátor vezetékének az alkatrészek teszteléséhez



#### ⚠ VIGYÁZAT



Tűzveszély. A terméket nem olyan folyadékokhoz fejlesztették ki, amelyek gyúlékonyak.

A reagensekkel feltöltött analizátor üzembe helyezése előtt ioncserélt vízzel el kell végezni egy alkatrészesztet. Lásd az illusztrált lépéseket és a következőt: [Alkatrészesztet végzése](#) oldalon 263.

1. Szereljen be négy zárószeleppel rendelkező csövet az alábbiakban látható 1. illusztrált lépésben látható módon.
  - a. Nyomja meg a fekete gombot, majd nyomja a csövet a szelepbe.
  - b. Engedje el a gombot, ha a cső megfelelő beszerelése megtörtént.
2. Győződjön meg arról, hogy a leeresztőcső megfelelően van rögzítve a mintatartályhoz. Lásd az alábbi ábrán bemutatott 2. lépést.
3. Győződjön meg arról, hogy a lebontó csöve megfelelően van rögzítve a lebontótartályhoz. Lásd az alábbi ábrán bemutatott 3. lépést.
4. Kösse be az analizátor összes folyadékcsövét egy nagy, ionmentes vizet tartalmazó palackba az alkatrészek tesztjének elvégzéséhez. Lásd az alábbi ábrán bemutatott 3. lépést. A csövek telepítése gyárilag történik.

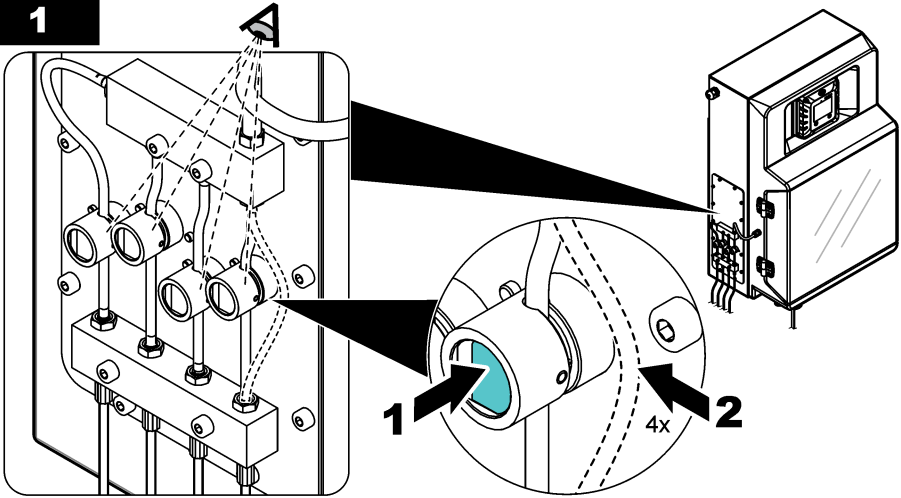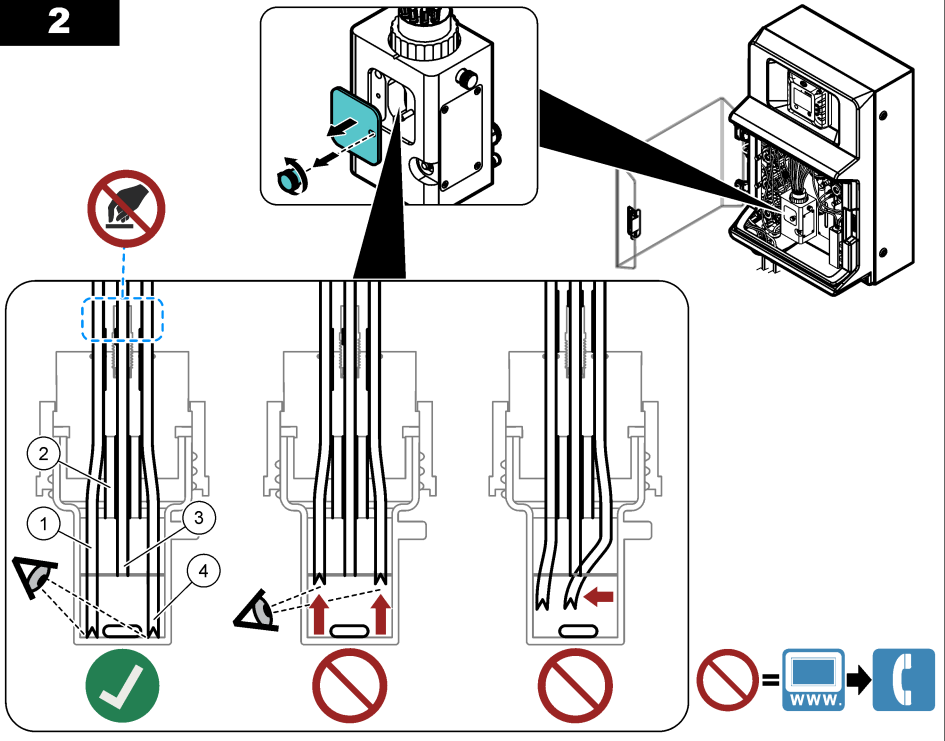**1****2**




1 Ürtőcső

3 Mintacső

2 Reagens- és szellőzőcső (felső cső)

4 Lebontócső

3

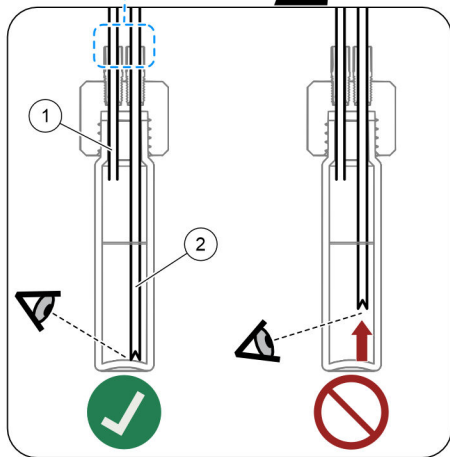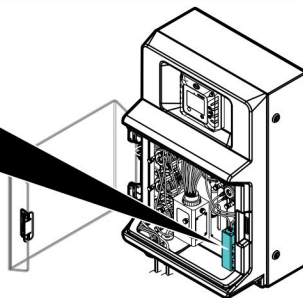


HU

1 Szellőzőcső

2 Lebontócső

4

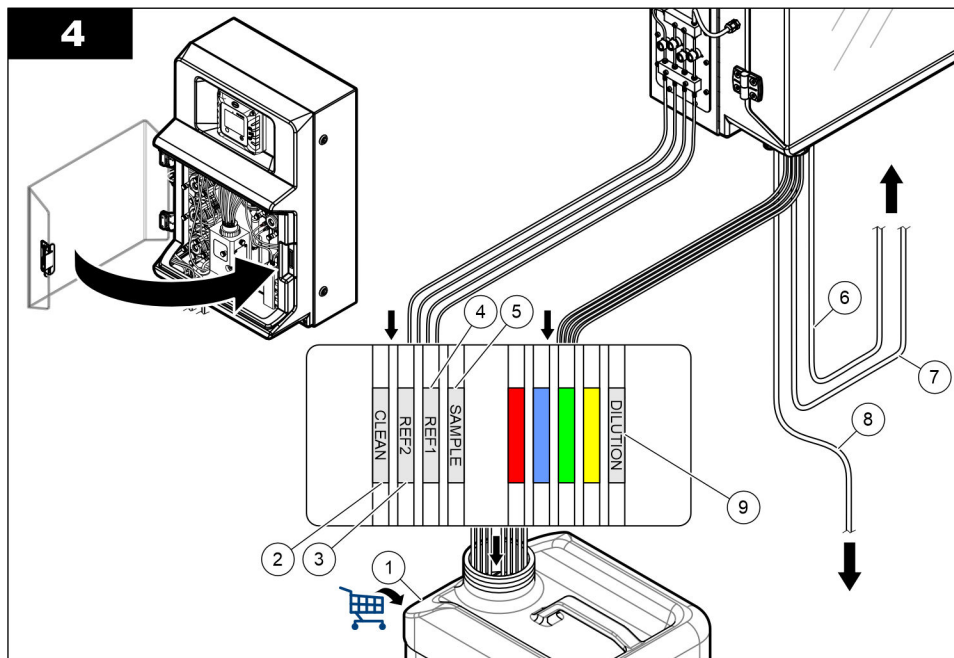

1 Ioncserélt víz	4 1. referenciaoldat (REF1) csőve	7 Lebontó szellőzője
2 Tisztítóoldat csőve	5 Mintabemeneti cső	8 Üritőcső
3 2. referenciaoldat (REF2) csőve	6 Szellőzőcső	9 Hígító- és reagens- mikroszivattyú csőve

## Szakasz 6 Beindítás

### 6.1 Kezdeti beindítás

**Megjegyzés:** A beindítás előtt győződjön meg arról, hogy a felszerelést, a csővezést és az elektromos telepítést hiánytalanul elvégezte. Lásd: [Beszerelés](#) oldalon 253.

Az analizátort első bekapcsolásakor egy indítási asszisztens segít a kezdeti beállítás elvégzéséhez szükséges első lépésekben. Az analizátor megfelelő működése érdekében végezze el az összes ezt követő lépést.

**Megjegyzés:** Ügyeljen arra, hogy a kiválasztott mérési tartománynak megfelelő reagenseket használjon. További információkért tekintse meg a bővített felhasználói kézikönyv online változatát.

1. Nyissa ki az analizátor ajtaját. Lásd: [Az analizátor ajtajának kinyitása](#) oldalon 254.
2. Kapcsolja ON (Be) állásba a főkapcsolót. Lásd: [9. ábra](#) oldalon 461.
3. A mellékelt kulccsal zárja be az analizátor ajtaját.
4. Várjon, amíg a berendezés befejezi az inicializálási folyamatot.
5. Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat a nyelv, az időzóna, a dátum és a pontos idő beállításához.

Az egyéb vezérlőbeállítások konfigurálásához tekintse meg az SC4500 vezérlő dokumentációját.

6. Az **EZ2700sc** menüjének megjelenítéséhez koppintson a kijelzőre.
7. Az indítási asszisztens elindításához válassza ki a **Device menu (Eszközmenü)** lehetőséget. Megjelenik az üdvözlőképernyő.

8. Hajtsa végre a képernyőn megjelenő lépéseket, és válassza ki a megfelelő mérési tartományt. Nyomja meg az **OK** gombot.
9. Ha van szűrőegység felszerelve, válassza az **On (Be)** lehetőséget. Ha nincs, válassza a **Off (Ki)** lehetőséget.
10. Adja meg az analizátorhoz tartozó csatornák számát. Nyomja meg az **OK** gombot.
11. Ha az összefoglaló oldalon megjelenő konfiguráció helyes, nyomja meg az **OK** gombot. Megjelenik az **EZ2700sc** főmenüje.
12. Folytassa az alkatrészek tesztelésével. Lásd: [Alkatrészeszt végzése](#) oldalon 263.

## 6.2 Alkatrészeszt végzése

### ▲ FIGYELMEZTETÉS



Beszorulás veszély. A mozgó alkatrészek beszorulhatnak és sérülést okozhatnak. Ne érintse meg a mozgó alkatrészeket.

Végezzen alkatrészesztet az analizátor üzembe helyezése előtt. A **Maintenance (Karbantartás)** menü használatával indítsa el az analizátor különböző funkcióit az adott alkatrész működésének vizsgálatához. Lásd: .

#### Előfeltételek:

- Ha az analizátor működési módban van, válassza ki a **Maintenance (Karbantartás) > Start maintenance mode (Karbantartási mód indítása)** lehetőséget.
- Győződjön meg róla, hogy a minta, a reagens és az oldat csöve egy ionmentes vizet tartalmazó tartályban van. Lásd: [Az analizátor vezetékezése az alkatrészek teszteléséhez](#) oldalon 259.

#### 6.2.1 A keverő vizsgálata

1. Távolítsa el a fényvédőt a fotométeregegről. Lásd: [13. ábra](#) oldalon 472.
2. Ellenőrizze, hogy a keverő leér-e a mintát tartalmazó tartály aljára.  
*Megjegyzés: Vizsgálja meg a keverőt a feltöltési eljárás közben, és ellenőrizze, hogy megfelelően forog-e. A feltöltési eljárás elindításáról lásd: [A szivattyúk és a zárószelvények vizsgálata](#) oldalon 263.*
3. Szerelje fel a fényvédőt a fotométerre.

#### 6.2.2 A szivattyúk és a zárószelvények vizsgálata

1. Vizsgálja a szivattyúk és a zárószelvények működését, és győződjön meg róla, hogy nincsenek szivárgások.
2. Győződjön meg róla, hogy az elemzőtartály megtelik ionmentes vízzel. Lásd: [14. ábra](#) oldalon 474.
3. Győződjön meg róla, hogy az ionmentes cső távozik az ürítőcsövön keresztül.
4. Válassza a **Maintenance (Karbantartás) > Start priming (Betöltés indítása)** lehetőséget, és töltsse be külön az összes folyadékot.  
Szivárgás esetén vizsgálja meg az összes csatlakozást, és további információkért tekintse meg a felhasználói kézikönyv online elérhető, kibővített változatát.
  - a. Válassza a **Prime reference 1 (1. referencia betöltése)** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
  - b. Válassza a **Prime reference 2 (2. referencia betöltése)** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
  - c. Válassza a **Prime cleaning solution (Tisztítóoldat betöltése)** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
  - d. Válassza a **Prime rinsing (Öblítő betöltése)** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
  - e. Válassza a **Prime dispenser (Adagoló betöltése)** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

- f. Válassza ki a **Prime channel (Csatorna betöltése) > Prime all channels (Összes csatorna betöltése)** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.  
Mindegyik betöltési eljárás automatikusan leáll, amikor az eljárás elkészül.

### 6.2.3 A mikroszivattyúk vizsgálata

Vizsgálja meg, hogy szivárognak vagy bugyborékolnak-e a mikroszivattyúk.

1. Távolítsa el a fényvédőt a fotométeregegről.
2. Válassza ki **Maintenance (Karbantartás) > Start priming (Betöltés indítása) > Prime all reagents (Összes reagens betöltése)** menüpontot.
3. Győződjön meg arról, hogy minden mikroszivattyú-csővön (reagenscsövön) keresztül megy ionmentes víz a mikroszivattyúba. Majd folyamatosan továbbhalad az elemzőtartályba, légbuborékok jelenléte nélkül. Lásd: [15. ábra](#) oldalon 475.
4. Ha a mikroszivattyúk nem működnek megfelelően (buborékok vannak a csőben), használja a fecskendő eljárását, hogy ionmentes vizet juttasson a megfelelő csőbe a buborékok eltávolításához. Lásd: [16. ábra](#) oldalon 476.
5. Szerelje fel a fényvédőt a fotométerre.

### 6.2.4 A fotométer ellenőrzése

A fotométer ellenőrzése előtt győződjön meg arról, hogy az analízator tartályának külső része tiszta, hogy az ellenőrzés sikeresen elvégezhető legyen. Az analízator alkatrészeinek tisztításával kapcsolatos további információkért tekintse meg a felhasználói útmutató online elérhető, kibővített változatát.

1. Nyomja meg a Főmenü ikont, majd válassza a **Devices (Eszközök)** lehetőséget.
2. Válassza az **EZ2700sc** lehetőséget.
3. Görgessen le a képernyő aljára, majd válassza a **Device menu (Eszközmenü)** lehetőséget.
4. Válassza a **Maintenance (Karbantartás) > Photometer check (Fotométer ellenőrzése)** lehetőséget.
5. A mérés indításához nyomja meg az **OK** gombot.  
A sötétkalibráció végeztével az eredmény megjelenik a kijelzőn.
6. A folytatáshoz nyomja meg az **OK** gombot.
7. Ellenőrizze, hogy a „REF1” csővezeték ioncserélt vízzel töltött tartályhoz csatlakozik-e. Győződjön meg arról, hogy a fényvédő fel legyen szerelve. Lásd: [18. ábra](#) oldalon 478.
8. Nyomja meg az **OK** gombot.  
Várjon, amíg az elemzőtartály megtelik.
9. Egy csavarhúzóval állítsa 9 V-ra az érzékelőkimenet feszültségét. Lásd: [17. ábra](#) oldalon 476.
10. Várjon, amíg a 9 V érték jelenik meg a képernyőn. Ezután nyomja meg az **OK** gombot.
11. A folytatáshoz nyomja meg az **OK** gombot.

## 6.3 A bemeneti jel tesztelése

Végezze el a digitális bemenetek tesztelését az analízator üzembe helyezése előtt.

**Előfeltételek:** Csatlakoztassa a digitális bemeneteket egy külső potenciálmentes érintkezőhöz (24 V DC).

Az alábbiak szerint tesztelje a digitális bemeneti jelet és az analóg kimeneti jelet:

1. Nyomja meg a Főmenü ikont, majd válassza a **Devices (Eszközök)** lehetőséget.
2. Válassza az **EZ2700sc** lehetőséget.
3. Görgessen le a képernyő aljára, majd válassza a **Device menu (Eszközmenü)** lehetőséget.
4. Válassza a **Diagnostics (Diagnosztika) > Signal (Jelek)** lehetőséget.

Megjelennek a digitális bemeneteknél lévő jelek.

5. Hasonlítsa össze a kijelzőn megjelenő digitális bemenetek állapotát a digitális bemeneteken lévő feszültségekkel (24 V = On (Be); 0 V = Off (Ki)).

## 6.4 A kimeneti jel tesztelése

Végezze el az analóg kimenetek tesztelését az analízátor üzembe helyezése előtt.

**Előfeltételek:** Konfigurálja az analóg kimeneteket (AO1–AO8, P101) annak kiválasztásához, hogy mely csatornák méréseit jelezzék az egyes analóg kimenetek. További információért tekintse meg a bővített felhasználói kézikönyv online változatát.

Az analóg kimeneti jel tesztelését az alábbiak szerint végezze el:

1. Nyomja meg a Főmenü ikont.
2. Válassza ki az **Outputs (Kimenetek) > mA outputs AOC (mA-kimenetek AOC) > Test/Maintenance (Teszt/karbantartás)** menüpontot.

Opció	Leírás
<b>Funkciószt</b>	Végezzen tesztet a kiválasztott modul kimenetein.
<b>Kimeneti állapot</b>	A kiválasztott modul kimenetek állapotainak megjelenítése.

3. Multiméter használatával mérje meg az összes analóg kimenet mA-értékét.
4. Hasonlítsa össze az analóg kimeneteknél mért mA-értéket az elvárt mA-értékekkel.

## 6.5 A csatornasorrend beállítása

Kiválaszthatja a csatornák mérésének sorrendjét, az egyes csatornák méréseinek számát és a csatorna mérése előtti várakozási időt. Legfeljebb 16 sor megadására van lehetőség, egyenként legfeljebb 16 ciklussal.

1. Nyomja meg a Főmenü ikont, majd válassza a **Devices (Eszközök)** lehetőséget.
2. Válassza az **EZ2700sc** lehetőséget.
3. Görgessen le a képernyő aljára, majd válassza a **Device menu (Eszközmenü)** lehetőséget.
4. Ha az analízátor működési módban van, válassza ki a **Maintenance (Karbantartás) > Start maintenance mode (Karbantartási mód indítása)** lehetőséget.  
Várja meg, amíg az analízátor karbantartási módba lép.
5. Válassza a **Configuration (Konfigurálás) > Channel sequence setup (Csatornasorrend beállítása)** lehetőséget.
6. Az oldalsávon lévő nyilak segítségével válasszon ki egy pozíciót (a sorrenden belüli szám), majd nyomja meg az **OK** gombot az adott pozíció konfigurálásához.
7. Válasszon egy opciót.

Opció	Leírás
<b>Select (Választás)</b>	Az adott csatorna vagy várakozási idő kiválasztása.
<b>Number of measurements (Mérések száma)</b>	Egy csatornával kapcsolatos mérések számának beállítása.
<b>Waiting time (Várakozási idő)</b>	A kiválasztott csatornával kapcsolatos várakozási idő beállítása.

8. A módosítások mentéséhez nyomja meg az **OK** gombot.

## 6.6 Az oldatok és a minta bekötése

### ▲ VIGYÁZAT



Kémiai expozíció veszélye. Kövesse a laboratóriumi biztonsági eljárásokat, és viselje a kezelt vegyszereknek megfelelő összes személyes védőfelszerelést. A biztonsági protokollokkal kapcsolatban lásd az aktuális biztonsági adatlapokat (MSDS/SDS).

### ▲ VIGYÁZAT



Kémiai expozíció veszélye. Semmisítse meg a vegyszereket és a hulladékokat a helyi, területi és nemzeti előírásoknak megfelelően.

### ▲ VIGYÁZAT



Tűzveszély. A terméket nem olyan folyadékokhoz fejlesztették ki, amelyek gyúlékonyak.

A reagenstartályok az analizátorhoz vannak mellékelve. Lásd: [18. ábra](#) oldalon 478. Az 1. referenciaoldat, a 2. referenciaoldat és az ionmentes víz tartályait a felhasználónak kell biztosítania. További tartályok a gyártótól vásárolhatók.

A tartályokat az alábbiak figyelembe vételével szerelje fel:

- az analizátorhoz a lehető legközelebb
- 1 méterrel az analizátor alja alá

A tartály felszereléséhez lásd: [18. ábra](#) oldalon 478.

A reagensek és oldatok biztosítása a felhasználó feladata. Csak tanúsított vállalattól származó reagenseket használjon, vagy használja a gyártó saját reagenseit. Alternatív megoldásként a reagenseket a felhasználó is elkészítheti. Kövesse az adott modellre vonatkozó, a gyártó honlapján megtalálható Módszer- és reagenslapon található utasításokat.

A csövek telepítése gyárilag történik. A megfelelő csőszerelési csatlakozások azonosítása érdekében ellenőrizze az egyes csöveken található címkéket. A megfelelő reagensek, oldatok és standardok megtalálhatók az adott modellre vonatkozó, a gyártó honlapján elérhető Módszer- és reagenslapon.

1. Az összes alkatrészeszt elvégzése után helyezze be a "CLEAN" (tisztítóoldat), a "REF1" (1. referenciaoldat) és a "REF2" (2. referenciaoldat) csövet a megfelelő tartályokba. Lásd: [18. ábra](#) oldalon 478.
2. Helyezze be az egyes színkódolt reagenscsöveket az egyező színű címkével ellátott reagenstartályokba.
3. Kösse be a mintaforrást (vagy a Moduplex panel vagy a szűrőpanel mintakimenetét) az analizátor mintabemeneti csövébe. Lásd: [18. ábra](#) oldalon 478.
4. Nyomja meg a Főmenü ikont, majd válassza a **Devices (Eszközök)** lehetőséget.
5. Válassza az **EZ2700sc** lehetőséget.
6. Görgessen le a képernyő aljára, majd válassza a **Device menu (Eszközmenü)** lehetőséget.
7. Válassza ki **Maintenance (Karbantartás) > Start priming (Betöltés indítása) > Prime all (Összes betöltése)** lehetőséget.

## 6.7 Végezzen hitelesítést a kezdeti beállítás előtt

Végezzen hitelesítést annak biztosítása érdekében, hogy a mérések a tűrészáron belül legyenek. További információkért tekintse meg a bővített felhasználói kézikönyv online változatát.

1. Nyomja meg a Főmenü ikont, majd válassza a **Devices (Eszközök)** lehetőséget.
2. Válassza az **EZ2700sc** lehetőséget.

3. Görgessen le a képernyő aljára, majd válassza a **Device menu (Eszközmenü)** lehetőséget.
4. Hitelesítés indításához válassza a **Calibration (Kalibráció) > Validation (Hitelesítés) > Start validation (Hitelesítés indítása)** lehetőséget.  
A hitelesítés a 2. referenciapalackban lévő ioncserélt vizet méri.
5. Az eredmények megjelenítéséhez válasszon egy opciót:
  - **Calibration (Kalibráció) > Validation (Hitelesítés) > Validation history (Hitelesítési előzmények)**
  - **Diagnostics (Diagnosztika) > Historical data (Előzményadatok) > Validation (Hitelesítés)**

## 6.8 Az analízátor elindítása

Az analízátor elindítása:

1. Nyomja meg a Főmenü ikont, majd válassza a **Devices (Eszközök)** lehetőséget.
2. Válassza az **EZ2700sc** lehetőséget.
3. Görgessen le a képernyő aljára, majd válassza a **Device menu (Eszközmenü)** lehetőséget.
4. Válassza a **Maintenance (Karbantartás) > Start operational mode (Üzemeltetési mód indítása)** lehetőséget.

# Cuprins

- |   |  |   |                                      |
|---|--|---|--------------------------------------|
| 1 | Informații suplimentare de la pagina 268           | 4 | Informații generale de la pagina 270 |
| 2 | Prezentarea generală a produsului de la pagina 268 | 5 | Instalarea de la pagina 272          |
| 3 | Specificații de la pagina 269                      | 6 | Pornirea sistemului de la pagina 281 |

## Secțiunea 1 Informații suplimentare

Manualul de utilizare de bază conține informații care sunt suficiente pentru punerea în funcțiune. Un manual de utilizare extins este disponibil online și conține mai multe informații.

### ▲ PERICOL



Pericole multiple! Mai multe informații sunt oferite în secțiunile individuale ale manualului de utilizare extins care sunt prezentate mai jos.

- Interfața cu utilizatorul și navigarea
- Funcționarea
- Întreținere
- Depanarea
- Liste de piese de schimb

Scanați codurile QR care urmează pentru a accesa manualul de utilizare extins.



Limbi europene



Limbi americane și asiatice

## Secțiunea 2 Prezentarea generală a produsului

Analizorul EZ2700sc de la Hach este un analizor online care măsoară un parametru din probele de apă prelevate din aplicații industriale și ecologice. Consultați [Figura 1](#) de la pagina 439, [Figura 2](#) de la pagina 443 și [Figura 3](#) de la pagina 447.

Analizorul este un analizor colorimetric online pentru analiza generală a apei (de ex., nitrați, fosfați). Analizorul are opțiuni pentru pornire de la distanță, validare automată, calibrare automată, curățare automată și Modbus.

Apa de probă intră în analizor prin tubul de probă. Pompele, supapele și seringile din analizor deplasează proba și reactivii în celula de măsurare de pe panoul de analiză. Când procesul din vasul de analiză este finalizat, analizorul elimină proba prin tubul de scurgere. Rezultatele analizei sunt afișate pe afișajul controlerului SC4500. Controlerul SC4500 salvează datele analizorului (jurnal de date, jurnal de evenimente, jurnal de setări și jurnal de service). Utilizați controlerul SC4500 pentru a opera și configura analizorul.

Pentru a crește numărul de fluxuri de probă (canale) pe care analizorul le poate măsura (2, 4 sau 8), achiziționați panoul cu fluxuri multiple Moduplex împreună cu analizorul.

Pentru a condiționa proba (filtrare, decantare), achiziționați panoul de filtrare EZ9010, EZ9020, EZ9150, EZ9200 sau EZ9250 împreună cu analizorul.

## Secțiunea 3 Specificații

Specificațiile pot face obiectul unor modificări fără notificare prealabilă.

Specificație	Detalii
Dimensiuni (L x l x h)	460 x 688 x 340 mm (18,1 x 27,1 x 13,4 inch)
Carcasă	IP44; ABS, PMMA și oțel tratat
Afișaj	Afișaj color TFT de 3,5 inch, IP66, cu touchpad capacitiv
Greutate	40 kg (88 lb)
Cerințe de alimentare	De la 100 până la 240 V c.a. ±10%, 50/60 Hz
Consum de energie	Maximum 240 VA
Altitudine	2000 m (6560 ft) maxim
Categorie de supratensiune	II
Condiții ambientale	Numai pentru utilizarea în interior
Gradul de poluare	2
Temperatură de funcționare	De la 10 la 30 °C (de la 50 la 86 °F); umiditate relativă de la 5 la 95%, fără condens, necoroziv
Temperatură de depozitare	De la -20 la 60 °C (de la -4 la 140 °F), umiditate relativă 95%, fără condensare maximă
Admisii probă	Una
Presiunea probei	Prin vas de preaplin extern (deschis la presiune atmosferică)
Debit probă	De la 100 până la 300 ml/min.
Temperatura probei	De la 10 până la 30 °C (de la 50 până la 86 °F)
Calitatea probei	< 100 μm particule, < 0,1 g/l maxim Turbiditate < 50 NTU
Purjarea aerului pentru mediile corozive	0,2 bari (20 kPa sau 3 psi); aer uscat și curat
Orificii de evacuare	Presiune atmosferică, ventilată, minim Ø 32 mm
Împământare	Stâlp de împământare uscat și curat cu impedanță redusă (<1 Ω) cu un cablu de împământare de > 2,5 mm <sup>2</sup> (13 AWG)
Ieșiri analogice	Maxim opt ieșiri analogice de 0-20 mA (sau 4-20 mA) <b>Notă:</b> Ieșirile analogice asigură alimentarea cu energie în buclă. Nu se poate asigura alimentarea cu energie a contactelor sistemului SCADA sau PLC.
Intrări digitale	Șapte intrări digitale: două intrări digitale pentru pornirea de la distanță. Intrările digitale rămase sunt pentru utilizări viitoare.
Ieșiri digitale	Patru ieșiri digitale sub tensiune pentru supapele și pompele panoului EZ9150; opt ieșiri digitale sub tensiune pentru supapele panoului Moduplex; 24 V c.c., 500 mA.
Relee	Cinci contacte fără potențial (FCT), încărcare maximă 24 V c.c., 0,5 A (sarcină rezistentă)
Conexiuni Ethernet	Conexiune Ethernet Claros și conector Ethernet Modbus TCP/IP; versiunea LAN; 10/100 Mbps sau IP Profinet sau Ethernet
Comunicații RS485	Profibus DP sau Modbus RTU

<sup>2</sup> Pentru informații despre configurația Ethernet și configurația Modbus, consultați documentația controlerului SC4500.

Specificație	Detalii
Certificări	Certificat cu CE, ETL la standardele de siguranță UL și CSA, UKCA
Garanție	1 an (UE: 2 ani)

## Secțiunea 4 Informații generale

În niciun caz producătorul nu este responsabil pentru daunele provocate de utilizarea incorectă a produsului sau de nerespectarea instrucțiunilor din manual. Producătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări în acest manual și produselor pe care le descrie, în orice moment, fără notificare sau obligații. Edițiile revizuite pot fi găsite pe site-ul web al producătorului.

### 4.1 Informații referitoare la siguranță

Producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de utilizarea incorectă a acestui produs, inclusiv și fără a se limita la daunele directe, accidentale sau pe cale de consecință și neagă responsabilitatea pentru astfel de daune în măsura maximă permisă de lege. Utilizatorul este unicul responsabil pentru identificarea riscurilor critice și pentru instalarea de mecanisme corespunzătoare pentru protejarea proceselor în cazul unei posibile defectări a echipamentului.

Vă rugăm să citiți integral manualul înainte de a despacheta, configura sau utiliza acest echipament. Acordați atenție tuturor declarațiilor de pericol și avertizare. Nerespectarea acestei recomandări poate duce la vătămări serioase ale operatorului sau la deteriorarea echipamentului.

Dacă echipamentul este utilizat într-un mod care nu este specificat de producător, protecția oferită de echipament poate fi afectată. Nu folosiți și nu instalați acest echipament altfel decât este specificat în acest manual.

#### 4.1.1 Informații despre utilizarea produselor periculoase

##### ▲ PERICOL

Indică o situație periculoasă în mod potențial sau iminent care, dacă nu este evitată, va avea ca rezultat decesul sau vătămarea corporală gravă.

##### ▲ AVERTISMENT

Indică o situație periculoasă în mod potențial sau iminent care, dacă nu este evitată, poate conduce la deces sau la o vătămare corporală gravă.

##### ▲ ATENȚIE

Indică o situație periculoasă în mod potențial care poate conduce la o vătămare corporală minoră sau moderată.

##### NOTĂ

Indică o situație care, dacă nu este evitată, poate provoca defectarea aparatului. Informații care necesită o accentuare deosebită.

#### 4.1.2 Etichete de avertizare





Citiți toate etichetele și avertismentele cu care este prevăzut instrumentul. În caz de nerespectare se pot produce vătămări personale sau avarieri ale instrumentului. Toate simbolurile de pe instrument sunt menționate în manual cu câte o afirmație de avertizare.




Acesta este simbolul de alertă privind siguranța. Respectați toate mesajele privind siguranța, care urmează după acest simbol, pentru a evita potențiale vătămări. În cazul prezenței pe instrument, consultați manualul de instrucțiuni pentru informații referitoare la operare sau siguranță.












Acest simbol indică riscul de accidente chimice și faptul că întreținerea sistemelor de distribuție a substanțelor chimice legate de aparatură trebuie efectuată numai de persoane calificate și instruite în vederea lucrului cu substanțe chimice.

	Acest simbol indică existența unui risc de electrocutare.
	Acest simbol indică prezența dispozitivelor sensibile la descărcări electrostatice (ESD) și faptul că trebuie să acționați cu grijă pentru a preveni deteriorarea echipamentului.
	Acest simbol indică faptul că obiectul marcat are nevoie de o conexiune la masă de protecție. Dacă instrumentul nu este alimentat de la o priză împământată pe un cablu, realizați conexiunea la masa de protecție cu terminalul conductorului de protecție.
	Echipamentele electrice inscripționate cu acest simbol nu pot fi eliminate în sistemele publice europene de deșeurii. Returnați producătorului echipamentele vechi sau la sfârșitul duratei de viață în vederea eliminării, fără niciun cost pentru utilizator.

### 4.1.3 Siguranța chimică și biologică

<b>⚠ PERICOL</b>	
	Pericole de natură chimică sau biologică. Dacă instrumentul este utilizat pentru a monitoriza un proces de tratare și/sau un sistem cu alimentare chimică pentru care există limite reglementate și condiții de monitorizare corelate sănătății publice, siguranței publice, fabricării sau procesării de alimente sau băuturi, este responsabilitatea utilizatorului acestui instrument de a cunoaște și respecta orice reglementare aplicabilă și de a avea mecanisme suficiente și adecvate pentru a se conforma cu reglementările aplicabile în cazul defectării instrumentului.

### 4.2 Icoane utilizate în ilustrații

				
Piese furnizate de producător	Piese furnizate de client	Priviți	Parcurgeți pașii în ordine inversă	
				
Utilizați două persoane	Ascultați	Folosiți doar degetele	Nu utilizați instrumente	Nu atingeți

### 4.3 Domeniu de utilizare

Analizoarele din seria EZ de la Hach sunt destinate utilizării de către persoane care trebuie să măsoare în permanență parametrii de calitate a apei în probele prelevate din aplicații industriale și ecologice. Analizoarele Hach seria EZ nu tratează sau modifică apa și nu sunt utilizate pentru a controla procedurile.

### 4.4 Componentele produsului

Asigurați-vă că ați primit toate componentele. Consultați [Figura 4](#) de la pagina 452. Dacă oricare dintre elemente lipsește sau este deteriorat, contactați imediat fie producătorul, fie un reprezentant de vânzări.

## Secțiunea 5 Instalarea

### ▲ PERICOL



Pericole multiple. Numai personalul calificat trebuie să efectueze activitățile descrise în această secțiune a documentului.

### 5.1 Îndrumări privind instalarea

#### ▲ AVERTISMENT



Pericol de incendiu. Utilizatorul are responsabilitatea de a se asigura că sunt luate suficiente măsuri de precauție atunci când echipamentul este utilizat prin metode care folosesc lichide inflamabile. Asigurați-vă că respectați metodele de precauție pentru utilizator și protocoalele de siguranță corecte. Acest lucru include, dar nu se limitează la verificarea existenței stropirilor sau vărsărilor de lichide, existența unei ventilații corespunzătoare, la neutilizarea nesupravegheată și la asigurarea ca instrumentul să nu fie lăsat nesupravegheat în timpul alimentării cu energie electrică.

#### ▲ ATENȚIE



Pericol de expunere chimică. Respectați procedurile de siguranță în laborator și purtați toate echipamentele de protecție personală adecvate pentru substanțele chimice care sunt manipulate. Consultați fișele tehnice de securitate (MSDS/SDS) pentru protocoalele de siguranță.

#### ▲ ATENȚIE



Pericol de expunere chimică. Substanțele chimice și deșeurile trebuie eliminate în conformitate cu reglementările locale, regionale și naționale.

- Instalați analizorul în interior, într-un mediu lipsit de pericole.
- Instalați analizorul într-un mediu care este protejat împotriva lichidelor corozive.
- Instalați analizorul într-o locație uscată, bine ventilată și cu temperatura controlată.
- Instalați analizorul cât se poate de aproape de punctul de prelevare a probei.
- Nu instalați analizorul în lumina directă a soarelui sau în apropierea unei surse de căldură.
- Asigurați-vă că există suficient spațiu liber pentru realizarea cuplajelor tubulaturii și a conectorilor electrici.
- Asigurați-vă că aveți suficient spațiu liber în fața analizorului pentru a putea deschide ușa analizorului. Consultați [Dimensiunile analizorului](#) de la pagina 273.
- Asigurați-vă că toate condițiile ambientale se încadrează în specificațiile de funcționare. Consultați [Specificații](#) de la pagina 269.

Deși analizorul nu este destinat utilizării cu probe inflamabile, unele analizoare EZ utilizează reactivi inflamabili. Consultați Method&Reagent Sheet (Fișa cu metode și reactivi) aferentă modelului relevant din seria EZ pentru mai multe informații despre reactivii folosiți în analizor. Dacă analizorul utilizează reactivi inflamabili, asigurați-vă că ați respectat următoarele măsuri de precauție privind siguranța:

- Țineți analizorul la distanță de căldură, scânteii și flăcări deschise.
- Nu consumați alimente, băuturi și nu fumați în apropierea analizorului.
- Utilizați un sistem de ventilație cu evacuare locală.
- Utilizați aparaturi și sisteme de iluminat cu protecție împotriva scânteilor și a exploziilor.
- Preveniți descărcările electrostatice. Consultați [Considerații privind descărcarea electrostatică](#) de la pagina 273.
- Curățați și uscați complet instrumentul înainte de utilizare.
- Spălați-vă pe mâini înainte de a lua o pauză și la sfârșitul turei de muncă.
- Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată. Spălați-vă îmbrăcămintea înainte de reutilizare.

- Aceste lichide trebuie manevrate în conformitate cu cerințele locale ale agenției responsabile de reglementare cu privire la limitele de expunere permise.

## 5.2 Dimensiunile analizorului

Pentru dimensiunile analizorului, consultați [Figura 5](#) de la pagina 454.

## 5.3 Instalare mecanică

### 5.3.1 Atașați instrumentul pe un perete

<b>▲ AVERTISMENT</b>	
	Pericol de vătămare corporală. Asigurați-vă că dispozitivul de montare pe perete este capabil să susțină de 4 ori greutatea echipamentului.
<b>▲ AVERTISMENT</b>	
	Pericol de vătămare corporală. Instrumentele sau componentele sunt grele. Pentru instalare sau mutare, apelați la alte persoane pentru asistență.
<b>▲ AVERTISMENT</b>	
	Pericol de vătămare corporală. Obiectul este greu. Asigurați-vă că instrumentul este bine fixat de perete, masă sau podea pentru a fi utilizat în siguranță.

Utilizați consolele de montare furnizate pentru a atașa instrumentul în poziție verticală și la nivel pe o suprafață plană, verticală de perete. Consultați [Figura 6](#) de la pagina 456.

Instalați instrumentul într-o locație și o poziție în care utilizatorul să poată deconecta instrumentul cu ușurință de la sursa de alimentare electrică.

Asigurați-vă că există suficient spațiu liber sub analizor pentru a instala flacoanele.

Componentele de montare sunt furnizate de către utilizator. Verificați dacă dispozitivul de fixare pe perete are o rezistență suficientă la sarcină (aproximativ 160 kg sau 353 lb). Componentele de montare trebuie să fie aprobate pentru proprietățile peretelui.


### 5.3.2 Deschideți ușa analizorului

Utilizați cheia furnizată pentru a debloca cele două încuietori de pe partea laterală a analizorului. Consultați [Figura 7](#) de la pagina 456. Asigurați-vă că închideți ușa înainte de operare pentru a păstra clasificarea ecologică a carcsei și gradul de siguranță.

## 5.4 Instalarea componentelor electrice

<b>▲ PERICOL</b>	
	Pericol de electrocutare. Întrerupeți întotdeauna alimentarea instrumentului înainte de a realiza conexiuni electrice.

### 5.4.1 Considerații privind descărcarea electrostatică

<b>NOTĂ</b>	
	Defecțiuni potențiale ale instrumentului. Componentele electronice interne sensibile pot fi deteriorate de electricitatea statică, provocând reducerea performanțelor aparatului sau chiar avarii.

Consultați pașii din această procedură pentru a preveni deteriorarea instrumentului prin descărcare electrostatică.

- Atingeți o suprafață metalică conectată la împământare, precum carcasa unui instrument, o conductă sau o țevă metalică pentru a descărca electricitatea statică din corp.
- Evitați mișcarea excesivă. Transportați componentele sensibile la electricitatea statică în recipiente sau ambalaje antistatice.
- Purtați o brățară conectată cu un cablu la împământare.
- Lucrați într-o zonă fără electricitate statică cu căptușeală de podea antistatică și cu căptușeală de bancă de lucru antistatică.

### 5.4.2 Accesul electric

Introduceți cablurile dispozitivelor externe prin protecțiile de cablu. Consultați [Figura 8](#) de la pagina 458. Păstrați dopurile din protecțiile de cablu care nu sunt utilizate.

[Figura 9](#) de la pagina 461 afișează componentele din interiorul analizorului. Comutatorul de pornire/oprire este un întrerupător care întrerupe automat alimentarea cu energie electrică de la conducta de alimentare cu curent alternativ dacă apare o condiție de supracurent (de exemplu, un scurtcircuit) sau de supratensiune.

### 5.4.3 Conectarea dispozitivelor externe

Conectați dispozitivele externe care vor fi utilizate cu analizorul la bornele de semnal și control din analizor. Consultați [Figura 10](#) de la pagina 466 și [Tabelul 1](#) de la pagina 274.

**Tabelul 1 Bornele de semnal și de control — Descrieri**


Pin	Descriere
AO1–AO8 (P101)	Opt ieșiri analogice pentru controlul dispozitivelor externe. Consultați versiunea extinsă a manualului de utilizare online, pentru mai multe informații.
FCT1–FCT5 (P102)	Cinci rele (contacte fără potențial). Valoarea maximă de încărcare este de 24 V c.c., 0,5 A. <ul style="list-style-type: none"> <li>• FCT1 — Alarmă funcționare defectuoasă</li> <li>• FCT2 — Alarmă întreținere</li> <li>• FCT3 — Analizor pregătit</li> <li>• FCT4 și FCT5 — Pentru utilizare viitoare</li> </ul>
DI1–DI7 (P103)	Șapte intrări digitale pentru a controla analizorul de la distanță <sup>5</sup> Conectați intrările digitale la un contact extern fără potențial (24 V c.c.) pentru a declanșa analizorul să pornească o măsurătoare pentru un canal. <ul style="list-style-type: none"> <li>• DI1 — Pornire de la distanță pentru canalul 1</li> <li>• DI2 — Pornire de la distanță pentru canalul 2</li> <li>• De la DI3 până la DI7 — Pentru utilizare viitoare</li> </ul>

<sup>5</sup> Dacă analizorul este în modul de întreținere, telecomanda este dezactivată.

**Tabelul 1 Bornele de semnal și de control — Descrieri (continuare)**

Pin	Descriere
FB1—FB4 (P104)	<p>Conectori Profibus DP sau Modbus RTU (RS485)</p> <p><b>Profibus DP:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FB1—A1 (intrare)</li> <li>• FB2—A2 (ieșire)</li> <li>• FB3—B1 (intrare)</li> <li>• FB4—B2 (ieșire)</li> <li>• SHL— Ecran</li> </ul> <p><b>Modbus RTU:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FB1—D (+)</li> <li>• FB2—D (-)</li> <li>• FB3—neutilizat</li> <li>• FB4—neutilizat</li> <li>• SHL— Ecran</li> </ul> <p>Consultați documentația controlerului SC4500 pentru instrucțiuni de configurare Modbus și etichete de telegamă.</p>
24 V c.c./1 A (P105)	Alimentare de 24 V c.c. pentru unitățile de filtrare EZ9010 și EZ9020
STR1—STR8 (P106)	<p>Opt ieșiri digitale pentru panoul opțional Moduplex. Conectați firele neizolate ale fiecărei supape de canal de pe panoul Moduplex la conectorii STR aferenți.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• STR1—Canalul 1</li> <li>• STR2—Canalul 2</li> <li>• ...</li> <li>• STR8—Canalul 8</li> </ul>
EXT9—EXT12 (P107)	<p>Patru ieșiri digitale pentru panoul de filtrare opțional EZ9150. Conectați supapele electrice și pompa de pe panoul de filtrare EZ9150 la conectorii EXT.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EXT9—Supapă de spălare</li> <li>• EXT10—Supapă de contracurent</li> <li>• EXT11—Supapă de preaplin pentru scurgere</li> <li>• EXT12—Pompă de filtrare</li> </ul>
D01—D06 (P108 și P109)	<p>Șase ieșiri de supape pneumatice pentru panoul EZ9150.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• D01 — Supapă de admisie a probei</li> <li>• D02 — Supapă de scurgere preaplin</li> <li>• D03 — Supapă canal 1</li> <li>• D04 — Supapă canal 2</li> <li>• D05 — Supapă canal 3</li> <li>• D06 — Supapă canal 4</li> </ul>

#### 5.4.4 Conectarea la o sursă de curent alternativ

<b>▲ PERICOL</b>	
	Pericole de șoc electric și de incendiu. Asigurați-vă că fișa fără blocare și cablul furnizat respectă cerințele în vigoare ale țării respective.

- Asigurați-vă că un disjunctoare cu o capacitate suficientă pentru curent electric este instalat pe linia de alimentare.


- Asigurați-vă că, în apropierea analizorului, este instalat întrerupătorul de circuit sau un buton de urgență pentru a putea deconecta imediat analizorul de la sursa de alimentare atunci când este cazul.
- Conectați echipamentele în conformitate cu toate codurile electrice locale, statale sau naționale.
- Instalați cablul de alimentare furnizat prin protecția de cablu care se află pe partea laterală a analizorului.
- Strângeți protecția de cablu pentru a ține în siguranță cablul de alimentare și pentru a păstra clasificarea ecologică a carcasei.

Conectați analizorul la sursa de curent alternativ cu cablul de alimentare de curent alternativ furnizat. Consultați [Tabelul 2](#) de la pagina 276 și [Figura 11](#) de la pagina 468.

### NOTĂ

Nu setați comutatorul de alimentare la poziția pornit. Finalizați toate conexiunile electrice și sanitare înainte de pornirea sau deteriorarea analizorului.

**Tabelul 2 Informații despre cablaj - Alimentare cu c.a.**

Bornă	Descriere	Culoare cablu - America de Nord și Canada	Culoarea cablului-EU
L	Cabluri de fază/active (L)	Negru (1)	Maro
N	Neutru (N)	Alb (2)	Albastru
	Împământare de protecție (PE)	Verde cu dungă galbenă	Verde cu dungă galbenă

## 5.5 Instalarea tubulaturii

### 5.5.1 Directive pentru tuburile pentru probe

#### ⚠ ATENȚIE



Pericol de incendiu. Acest produs nu este conceput pentru utilizarea cu probe inflamabile.

Selectați un punct de prelevare a probei bun și reprezentativ pentru a obține cele mai bune performanțe ale instrumentului. Proba trebuie să fie reprezentativă pentru întregul sistem.

- Asigurați-vă că debitul probei este mai mare decât debitul către analizor.
- Asigurați-vă că conducta pentru probă este la presiune atmosferică dacă analizorul utilizează o pompă peristaltică pentru a deplasa proba în vasul de analiză.
- Asigurați-vă că conducta pentru probă colectează proba dintr-un vas mic de preaplin aflat în apropierea analizorului.
- Folosiți linia de eșantionare furnizată. Nu schimbați lungimea liniei de eșantionare.

Proba din vasul de preaplin trebuie reîmprospătată în mod continuu. Dacă dimensiunile solidelor din probă sunt prea mari, se recomandă filtrarea probei.

### 5.5.2 Linii directe pentru conductele de scurgere

#### ⚠ AVERTISMENT



Pericol de incendiu. Utilizatorul are responsabilitatea de a se asigura că sunt luate suficiente măsuri de precauție atunci când echipamentul este utilizat prin metode care folosesc lichide inflamabile. Asigurați-vă că respectați metodele de precauție pentru utilizator și protocoalele de siguranță corecte. Acest lucru include, dar nu se limitează la verificarea existenței stropirilor sau vărsărilor de lichide, existența unei ventilații corespunzătoare, la neutilizarea nesupravegheată și la asigurarea ca instrumentul să nu fie lăsat nesupravegheat în timpul alimentării cu energie electrică.

## ⚠ ATENȚIE



Pericol de expunere chimică. Substanțele chimice și deșeurile trebuie eliminate în conformitate cu reglementările locale, regionale și naționale.

## NOTĂ

Nu conectați conductele de scurgere la alte conducte deoarece există riscul de generare a contrapresiunii sau de deteriorare a analizorului. Asigurați-vă că conductele de scurgere au un capăt liber.

## NOTĂ

Pentru a preveni generarea contrapresiunii și deteriorarea analizorului, asigurați-vă că analizorul se află mai sus decât orificiile de scurgere utilizate și că panta conductei de scurgere este descendentă și constantă. Instalați conductele de scurgere cu o scădere verticală de 2,54 cm (1 inch) sau mai mult pentru fiecare lungime de tuburi de 0,3 m (1 ft).

Analizorul utilizează conducta de scurgere pentru a elibera proba și reactivii după analiză. Instalarea corectă a conductelor de scurgere este importantă pentru a vă asigura că se elimină tot lichidul din instrument. Instalarea incorectă poate cauza returnarea lichidului în instrument și apariția avariilor. O scurgere în podea sau un canal de scurgere este suficient pentru conducta de scurgere. Diametrul exterior recomandat pentru tubul de scurgere este de 32 mm. Consultați [Figura 12](#) de la pagina 471.

- Faceți conductele de scurgere cât mai scurte posibil.
- Asigurați-vă că scurgerea este așezată la un nivel mai jos decât analizorul.
- Asigurați-vă că panta conductelor de scurgere este constant descendentă.
- Asigurați-vă că nu există curbe bruște ale conductelor de scurgere și că acestea nu sunt înțepate.
- Asigurați-vă că s-au deschis conductele de scurgere spre aer liber și că presiunea acestora este zero.
- Asigurați-vă că conductele de scurgere au un capăt închis în mediul ambiant al încăperii de instalare.
- Nu blocați sau nu scufundați în lichid conducta de scurgere.

De asemenea, se recomandă o conexiune la apă în apropierea analizorului, astfel încât canalul de scurgere și tubulatura de scurgere să fie spălate în mod regulat cu apă curată pentru a preveni blocarea prin cristalizare.

Consultați Method&Reagent Sheet (Fișa cu metode și reactivi) aferentă modelului relevant din seria EZ pentru mai multe informații despre reactivii folosiți în analizor. Dacă analizorul utilizează reactivi inflamabili, asigurați-vă că ați respectat următoarele măsuri de precauție privind siguranța:

- Nu racordați conducta de scurgere la o scurgere în pardoseală.
- Eliminați deșeurile în conformitate cu reglementările locale, de stat și naționale privind mediul.

### 5.5.3 Linii directe pentru conducta de ventilație

## ⚠ AVERTISMENT



Pericol de incendiu. Utilizatorul are responsabilitatea de a se asigura că sunt luate suficiente măsuri de precauție atunci când echipamentul este utilizat prin metode care folosesc lichide inflamabile. Asigurați-vă că respectați metodele de precauție pentru utilizator și protocoalele de siguranță corecte. Acest lucru include, dar nu se limitează la verificarea existenței stropirilor sau vărsărilor de lichide, existența unei ventilații corespunzătoare, la neutilizarea nesupravegheată și la asigurarea ca instrumentul să nu fie lăsat nesupravegheat în timpul alimentării cu energie electrică.

## ⚠ ATENȚIE



Pericol de expunere chimică. Substanțele chimice și deșeurile trebuie eliminate în conformitate cu reglementările locale, regionale și naționale.

## NOTĂ

Nu conectați conducta de ventilație (portul gazelor de evacuare) la alte conducte deoarece există riscul de generare a contrapresiunii sau de deteriorare a analizorului. Asigurați-vă astfel încât conducta de ventilație să aibă un capăt liber la exteriorul clădirii.

## NOTĂ

Pentru a preveni generarea contrapresiunii și deteriorarea analizorului, asigurați-vă că analizorul se află mai sus decât orificiile de ventilație utilizate și că panta conductei de ventilație este descendentă și constantă. Instalați conducta de ventilație cu o scădere verticală de 2,54 cm (1 inch) sau mai mult pentru fiecare lungime de tuburi de 0,3 m (1 ft).

RO

Analizorul utilizează conducta de ventilație pentru a menține vasul de analiză la presiunea atmosferică. Montarea corectă a conductei de ventilație este importantă pentru a vă asigura că, în timpul funcționării pompei, niciun lichid nu intră în vasul de analiză de la conducta de ventilație. Instalarea incorectă poate cauza returnarea gazului în analizor și apariția avariilor. Diametrul exterior recomandat pentru tubul colector al conductei de ventilație este de 32 mm. Consultați [Figura 12](#) de la pagina 471.

- Scurtați conducta de ventilație cât mai mult posibil.
- Asigurați-vă că panta conductei de ventilație este constant descendentă.
- Asigurați-vă că nu există curbe bruște ale conductei de ventilație și că aceasta nu este înțepată.
- Asigurați-vă astfel încât conducta de ventilație să aibă un capăt închis în mediul ambiant al încăperii de instalare și că presiunea acesteia este zero.
- Asigurați-vă că linia de aerisire este întotdeauna mai sus decât scurgerea.
- Nu blocați sau nu scufundați în lichid conducta de ventilație.

Dacă analizorul utilizează reactivi inflamabili, asigurați-vă că ați respectat următoarele măsuri de precauție privind siguranța:

- Nu racordați conducta de ventilație la o scurgere în pardoseală.
- Eliminați deșeurile în conformitate cu reglementările locale, de stat și naționale privind mediul.

### 5.5.4 Instalați tubulatura analizorului pentru testarea componentelor



#### ⚠ ATENȚIE



Pericol de incendiu. Acest produs nu este conceput pentru utilizare cu lichide inflamabile.

Înainte ca analizorul cu toți reactivii să fie pus în funcțiune, trebuie să se efectueze un test al componentelor cu apă deionizată. Consultați pașii ilustrați și [Efectuarea testelor de componente](#) de la pagina 282.




1. Montați cele patru tuburi ale supapei cu manșon reglabil așa cum se indică în pasul ilustrat 1 de mai jos.
  - a. Apăsăți butonul negru, apoi împingeți tubulatura în supapă.
  - b. Eliberați butonul atunci când tubulatura este montată corect.
2. Asigurați-vă că tubul de scurgere este montat corect în vasul cu proba. Consultați pasul 2 ilustrat din continuare.
3. Asigurați-vă că tubul blocului de digestie este montat corect în vasul blocului de digestie. Consultați pasul 3 ilustrat din continuare.
4. Conectați toată tubulatura cu lichid a analizorului într-un recipient mare de apă deionizată pentru a face un test al componentelor. Consultați pasul 3 ilustrat din continuare. Tubulatura este instalată din fabrică.

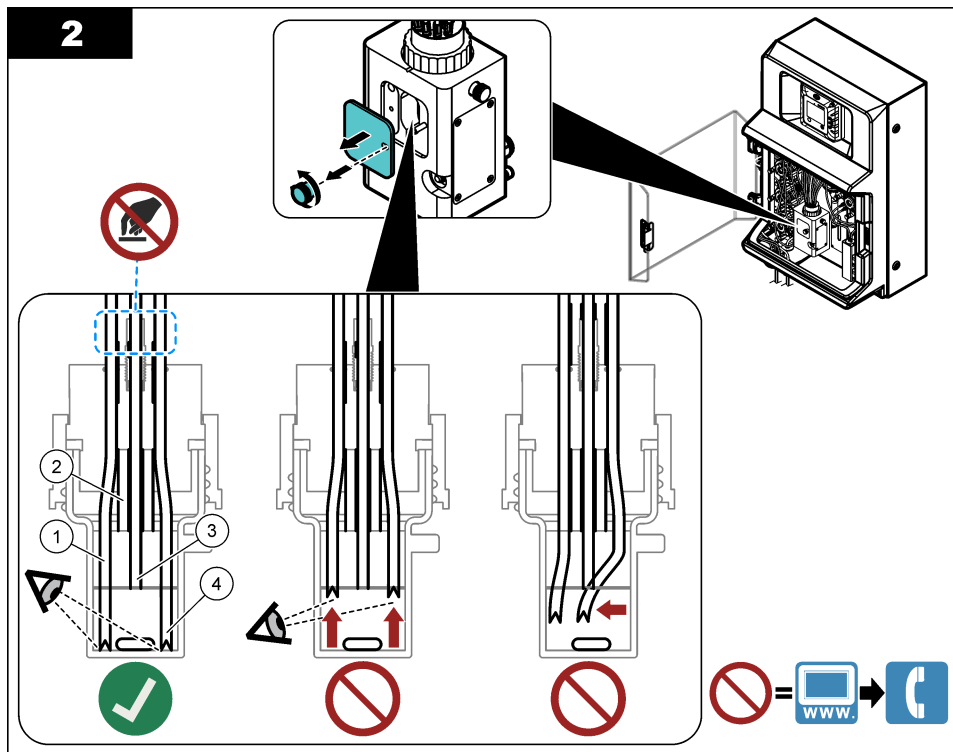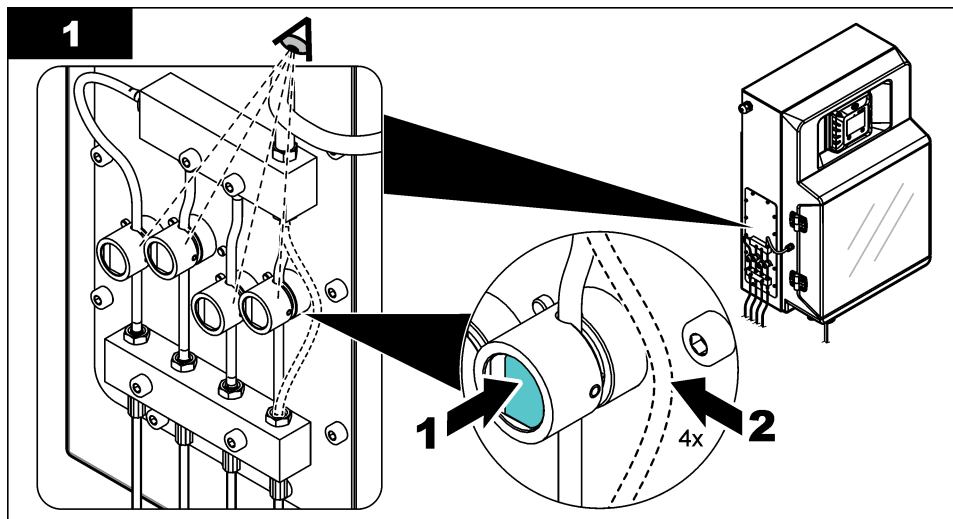

1 Tub de scurgere	3 Tub de eșantionare
2 Tubulatură de reactivi și aerisire (tubulatură superioară)	4 Tub pentru blocul de digestie

3


RO

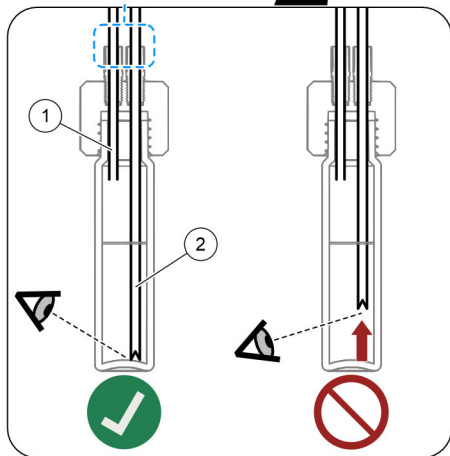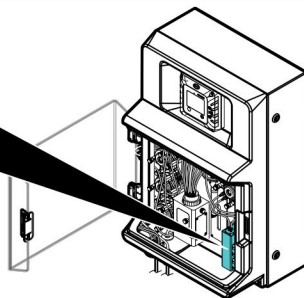

1 Tub de aerisire

2 Tub pentru blocul de digestie

4

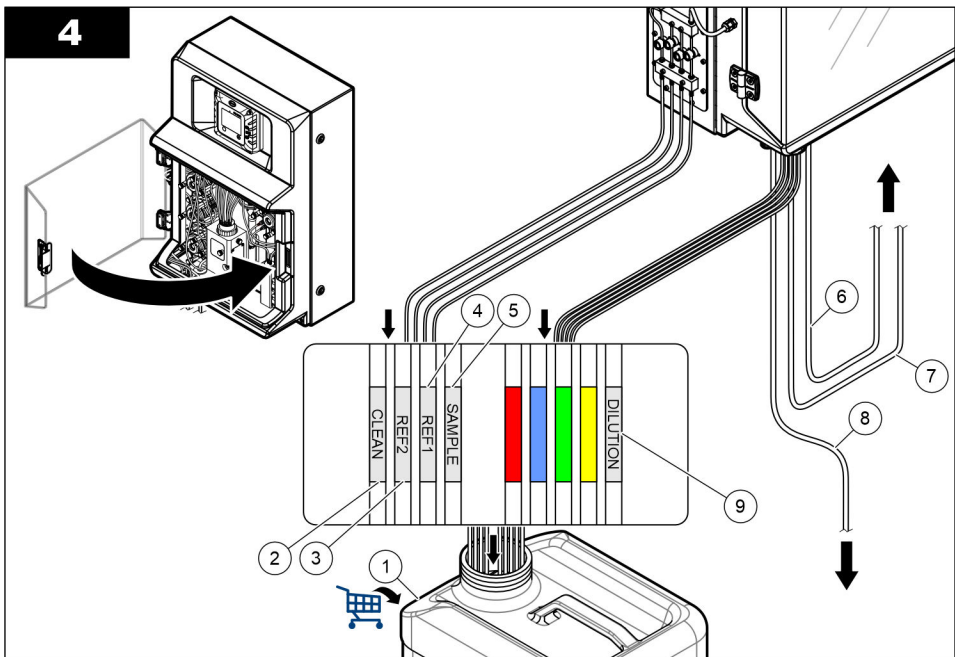

1 Apă deionizată	4 Tubul de soluție de referință 1 (REF1)	7 Bloc de digestie cu aerisire
2 Curățarea tubului de soluție	5 Tubul de admisie a probei	8 Tubulatură scurgere
3 Tubul de soluție de referință 2 (REF2)	6 Tubulatură de aerisire	9 Tubulatură pentru diluție și micropompe cu reactiv

## Secțiunea 6 Pornirea sistemului

### 6.1 Pornirea inițială

**Notă:** Asigurați-vă că montajul, tubulatura și instalațiile electrice sunt complet finalizate înainte de pornire. Consultați [Instalarea](#) de la pagina 272.

Când analizorul este pornit pentru prima dată, un asistent de inițializare vă va ajuta cu primii pași pentru finalizarea configurării. Parcurgeți toți pașii care urmează pentru a vă asigura că analizorul funcționează corect.

**Notă:** Asigurați-vă că folosiți reactivii potriviți pentru intervalul de măsurare selectat. Consultați versiunea online a manualului extins de utilizare, pentru mai multe informații.

1. Deschideți ușa analizorului. Consultați [Deschideți ușa analizorului](#) de la pagina 273.
2. Setati comutatorul de alimentare pe poziția de PORNIRE. Consultați [Figura 9](#) de la pagina 461.
3. Închideți ușa analizorului cu cheia prevăzută.
4. Așteptați finalizarea procedurii de inițializare.
5. Răspundeți la mesajele care apar pe ecran pentru a alege limba, fusul orar, data și ora.  
Pentru a configura celelalte setări ale controlerului, consultați documentația controlerului SC4500.
6. Atingeți ecranul pentru a afișa meniul **EZ2700sc**.
7. Selectați **Meniul dispozitivului** pentru a lansa asistentul de inițializare.  
Este afișată fereastra de pornire.
8. Parcurgeți pașii afișați pe ecran pentru a alege intervalul de măsurare relevant. Apăsati pe **OK**.

9. Dacă este instalată o unitate de filtrare, selectați **Pornit**. Dacă nu, selectați **Oprit**.
10. Alegeți numărul de canale pentru analizor. Apăsați pe **OK**.
11. În cazul în care configurația afișată pe pagina cu rezumatul este corectă, apăsați **OK**. Apare meniul principal **EZ2700sc**.
12. Continuați cu testarea componentelor. Consultați [Efectuarea testelor de componente](#) de la pagina 282.

## 6.2 Efectuarea testelor de componente

### ⚠ AVERTISMENT



Risc de ciupituri. Piesele în mișcare pot ciupi și cauza vătămări. Nu atingeți piesele aflate în mișcare.

Efectuați testele de componente înainte ca analizorul să fie pus în funcțiune. Utilizați meniul **Întreținere** pentru a porni diferitele funcții de analizor pentru a examina funcționarea componentelor.

#### Condiții preliminare:

- Dacă analizorul este în modul operațional, selectați **Întreținere > Pornire mod întreținere**.
- Asigurați-vă că proba, reactivul și tubulatura cu soluție se află într-un recipient cu apă deionizată. Consultați [Instalați tubulatura analizorului pentru testarea componentelor](#) de la pagina 278.

#### 6.2.1 Examinăți agitatorul

1. Scoateți ecranul de protecție de pe unitatea fotometrului. Consultați [Figura 13](#) de la pagina 472.
2. Asigurați-vă că agitatorul este pe fundul vasului de probe.  
*Notă: Examinăți agitatorul în timpul procedurii de amorsare pentru a vă asigura că acesta se rotește corect. Procedura de amorsare începe în [Examinarea pompelor și a supapelor cu manșon reglabili](#) de la pagina 282.*
3. Montați ecranul de protecție pe fotometru.

#### 6.2.2 Examinarea pompelor și a supapelor cu manșon reglabil

1. Examinați funcționarea pompelor și a supapelor cu manșon reglabil pentru a vă asigura că nu există scurgeri.
2. Asigurați-vă că vasul de analiză se umple cu apă deionizată. Consultați [Figura 14](#) de la pagina 474.
3. Asigurați-vă că apa deionizată iese prin tubulatura de scurgere.
4. Selectați **Întreținere > Începere amorsare** și amorsați toate lichidele separat.  
Dacă apare o scăpare, examinați toate racordurile și consultați versiunea online a manualului extins de utilizare pentru mai multe informații.
  - a. Selectați **Referință amorsare 1** și apăsați **OK**.
  - b. Selectați **Referință amorsare 2** și apăsați **OK**.
  - c. Selectați **Amorsare soluție de curățare** și apăsați **OK**.
  - d. Selectați **Amorsare clătire** și apăsați **OK**.
  - e. Selectați **Amorsare dozator** și apăsați **OK**.
  - f. Selectați **Amorsare canal > Amorsare toate canalele** și apăsați **OK**.  
Fiecare procedură de amorsare este oprită automat atunci când aceasta s-a încheiat.

### 6.2.3 Examinarea micropompelor

Examinați dacă există scăpări și bule de aer la micropompe.

1. Scoateți ecranul de protecție de pe fotometru.
2. Selectați **Întreținere > Începere amorsare > \$Prime all reagents (Amorsare integrală reactivi)**.
3. Asigurați-vă că apa deionizată intră în micropompă prin fiecare dintre tuburile (reactiv) micropompei. Apoi, în vasul de analiză în mod continuu, fără bule de aer. Consultați [Figura 15](#) de la pagina 475.
4. Dacă micropompele nu funcționează corect (bule în tubulatură), utilizați procedura cu seringă pentru a împinge apa deionizată în tubulatura aplicabilă pentru a elimina bulele. Consultați [Figura 16](#) de la pagina 476.
5. Montați ecranul de protecție pe fotometru.

### 6.2.4 Efectuați o verificare a fotometrului

Înainte de verificarea fotometrului, asigurați-vă că elementul extern al vasului de analiză este curat pentru ca verificarea să se poată finaliza cu succes. Pentru a curăța componentele analizorului, consultați versiunea online a manualului de utilizare extins pentru mai multe informații.

1. Apăsăți pe pictograma meniului principal, apoi selectați **Dispozitive**.
2. Selectați **EZ2700sc**.
3. Derulați în partea de jos a ecranului, apoi selectați **Meniul dispozitivului**.
4. Selectați **Întreținere > Verificare fotometru**.
5. Apăsăți pe **OK** pentru a porni măsurarea.  
Când calibrarea fără lumină s-a încheiat, apare rezultatul pe ecran.
6. **OK**
7. Asigurați-vă că tubulatura „REF1” este conectată la un rezervor umplut cu apă deionizată. Asigurați-vă că ecranul protector este montat. Consultați [Figura 18](#) de la pagina 479.
8. Apăsăți pe **OK**.  
Așteptați până când se umple vasul de analiză.
9. Utilizați o șurubelniță pentru a regla tensiunea de ieșire a senzorului la 9 V. Consultați [Figura 17](#) de la pagina 476.
10. Așteptați până când apare valoarea de 9 V pe ecran. Apoi, apăsați **OK**.
11. Apăsăți pe **OK** pentru a continua.

### 6.3 Efectuați o testare a semnalului de intrare

Efectuați un test al intrărilor digitale înainte ca analizorul să fie pus în funcțiune.

**Cerințe preliminare:** conectați intrările digitale la un contact extern fără potențial (24 V c.c.).

Efectuați un test de semnal de intrare digitală și semnal de ieșire analogică după cum urmează:

1. Apăsăți pe pictograma meniului principal, apoi selectați **Dispozitive**.
2. Selectați **EZ2700sc**.
3. Derulați în partea de jos a ecranului, apoi selectați **Meniul dispozitivului**.
4. Selectați **Diagnosticare > Semnale**.  
Se afișează semnalele al intrările digitale.
5. Comparați starea intrărilor digitale de pe afișaj cu tensiunile furnizate intrărilor digitale (24 V = Pornit; 0 V = Oprit).

### 6.4 Efectuați un test al semnalului de ieșire

Efectuați un test al ieșirilor analogice înainte ca analizorul să fie pus în funcțiune.

**Cerințe preliminare:** configurați ieșirile analogice (AO1–AO8, P101) pentru a selecta măsurătoarea canalului reprezentată de fiecare ieșire analogică. Consultați versiunea extinsă a manualului de utilizare online, pentru mai multe informații.

Efectuați un test al semnalului de ieșire în felul următor:

1. Apăsați pictograma meniului principal.
2. Selectați **Ieșiri > Ieșiri mA AOC > Test/Întreținere**.

Opțiune	Descriere
Testare funcție	Efectuează un test asupra ieșirilor la modulul selectat.
Stare ieșire	Arată starea ieșirilor la modulul selectat.

3. Utilizați un multimetru pentru a măsura valoarea mA la fiecare ieșire analogică.
4. Comparați valoarea mA măsurată la ieșirile analogice cu valorile mA așteptate.

## 6.5 Setarea secvenței canalului

Selectați secvența în care sunt măsurate canalele, de câte ori este măsurat fiecare canal și timpul de așteptare înainte ca un canal să fie măsurat. Introduceți maximum 16 poziții cu maximum 16 cicluri fiecare.

1. Apăsați pe pictograma meniului principal, apoi selectați **Dispozitive**.
2. Selectați **EZ2700sc**.
3. Derulați în partea de jos a ecranului, apoi selectați **Meniu dispozitivului**.
4. Dacă analizorul este în modul operațional, selectați **Întreținere > Pornire mod întreținere**. Așteptați până când analizorul este în modul de întreținere.
5. Selectați **Configurație > Configurare secvență canale**.
6. Utilizați săgețile de pe bara laterală pentru a selecta o poziție (număr din secvență), apoi apăsați pe **OK** pentru a configura acea poziție.
7. Selectați o opțiune.

Opțiune	Descriere
Selectare	Selectează canalul aplicabil sau timpul de așteptare.
Număr de măsurători	Setează numărul de măsurători pentru un canal.
Timp de așteptare	Setează timpul de așteptare pentru canalul selectat.

8. Apăsați pe **OK** pentru a salva modificările.

## 6.6 Conectarea soluțiilor și a probei

### ⚠ ATENȚIE



Pericol de expunere chimică. Respectați procedurile de siguranță în laborator și purtați toate echipamentele de protecție personală adecvate pentru substanțele chimice care sunt manipulate. Consultați fișele tehnice de securitate (MSDS/SDS) pentru protocoalele de siguranță.

### ⚠ ATENȚIE



Pericol de expunere chimică. Substanțele chimice și deșeurile trebuie eliminate în conformitate cu reglementările locale, regionale și naționale.

## ATENȚIE



Pericol de incendiu. Acest produs nu este conceput pentru utilizare cu lichide inflamabile.

Recipientele de reactivi sunt furnizate împreună cu analizorul. Consultați [Figura 18](#) de la pagina 479. Recipientele pentru soluția de referință 1 și soluția de referință 2 și apa deionizată sunt furnizate de către utilizator. Se pot cumpăra mai multe recipiente de la producător.

Montați recipientele

- cât mai aproape posibil de analizor
- la un metru sub baza analizorului

Consultați [Figura 18](#) de la pagina 479 pentru instalarea recipientului.

Reactivii și soluțiile sunt furnizate de utilizator. Utilizați numai reactivi furnizați de o companie certificată sau utilizați reactivi dedicați producătorului. Ca o alternativă, reactivii pot fi preparați de către utilizator. Respectați instrucțiunile din Method&Reagent Sheet (Fișa cu metode și reactivi) pentru modelul specific, care se găsește pe site-ul web al producătorului.

Tubulatura este instalată din fabrică. Citiți eticheta de pe fiecare tub pentru a identifica conexiunea corectă a instalației. Consultați instrucțiunile din Method&Reagent Sheet (Fișa cu metode și reactivi) pentru model, care se găsește pe site-ul web al producătorului pentru reactivii, soluțiile și soluțiile etalon corecte.

1. După ce au fost efectuate testele componentelor, montați tubulatura „CLEAN” (soluție de curățare), „REF1” (soluție de referință 1) și „REF2” (soluție de referință 2) în recipientele aferente. Consultați [Figura 18](#) de la pagina 479.
2. Montați fiecare tub de reactiv cu cod de culoare în recipientul de reactiv cu aceeași culoare pe etichetă.
3. Racordați sursa probei (sau ieșirea probei de pe panoul Moduplex sau panoul de filtrare) la tubul de intrare a probei al analizorului. Consultați [Figura 18](#) de la pagina 479.
4. Apăsăți pe pictograma meniului principal, apoi selectați **Dispozitive**.
5. Selectați **EZ2700sc**.
6. Derulați în partea de jos a ecranului, apoi selectați **Meniul dispozitivului**.
7. Selectați **Întreținere > Începere amorsare > Amorsare toate**.

## 6.7 Efectuați o validare înainte de pornirea inițială

Efectuați o validare pentru a vă asigura că măsurătorile sunt în intervalul de toleranță. Consultați versiunea online a manualului extins de utilizare pentru mai multe informații.

1. Apăsăți pe pictograma meniului principal, apoi selectați **Dispozitive**.
2. Selectați **EZ2700sc**.
3. Derulați în partea de jos a ecranului, apoi selectați **Meniul dispozitivului**.
4. Pentru a porni o validare, selectați **Calibrare > Validare > Începere validare**.  
Validarea măsoară apa deionizată din flaconul de referință 2.
5. Pentru a afișa rezultatele, selectați o opțiune:
  - **Calibrare > Validare > Istoric validare**
  - **Diagnosticare > Date istorice > Validare**

## 6.8 Pornirea analizorului

Pentru a porni analizorul:

1. Apăsați pe pictograma meniului principal, apoi selectați **Dispozitive**.
2. Selectați **EZ2700sc**.
3. Derulați în partea de jos a ecranului, apoi selectați **Meniul dispozitivului**.
4. Selectați **Întreținere > Pornire mod operațional**.

RO

## Turinys

- 1 Papildoma informacija Puslapyje 287
- 2 Gaminio apžvalga Puslapyje 287
- 3 Techniniai duomenys Puslapyje 288

- 4 Bendojo pobūdžio informacija Puslapyje 289
- 5 Montavimas Puslapyje 290
- 6 Paleidimas Puslapyje 300

## Skyrius 1 Papildoma informacija

Pagrindiniame naudotojo vadove pateikiama informacija, kurios pakanka norint pradėti eksploatuoti. Internetu galima rasti išplėstinį naudotojo vadovą, kuriame pateikiama daugiau informacijos.

### ⚠ PAVOJUS



Įvairūs pavojai. Daugiau informacijos pateikiama atskiruose išplėstinio naudotojo vadovo skyriuose, kurie pateikiami toliau.

- Naudotojo sąsaja ir naršymas
- Naudojimas
- „Maintenance“ (Techninė priežiūra)
- Trikių šalinimas
- Keičiamų dalių sąrašai

Nuskaitykite toliau nurodytus QR kodus, kad pereitumėte į išplėstinį naudotojo vadovą.



Europos kalbos



Amerikos ir Azijos kalbos

## Skyrius 2 Gaminio apžvalga

„Hach EZ2700sc“ analizatorius yra nuolatinis analizatorius, kuris matuoja vieną parametą iš vandens mėginių iš pramoninių ar buitinių šaltinių. Žr. [Paveikslėlis 1](#) Puslapyje 438, [Paveikslėlis 2](#) Puslapyje 443 ir [Paveikslėlis 3](#) Puslapyje 447.

Analizatorius yra nuolatinis kolorimetrinis analizatorius, skirtas bendrajai vandens analizei (pvz., nitratų, fosfatų). Analizatorius turi šias parinktis: nuotolinio paleidimo, automatinio patvirtinimo, automatinio kalibravimo, automatinio valymo ir „Modbus“.

Mėginio vanduo patenka į analizatorių per mėginio vamzdelį. Analizatoriaus siurbiai, vožtuvai ir švirkštai perneša mėginį ir reagentus į matavimo kiuvetę analizės pulte. Kai analizės procesas inde užbaigiamas, analizatorius pašalina mėginį per ištuštinimo vamzdelį. Analizės rezultatai parodomi SC4500 valdiklio ekrane. SC4500 valdiklis išsaugo analizatoriaus duomenis (duomenų žurnale, įvykių žurnale, nustatymų žurnale ir priežiūros žurnale). SC4500 valdiklis naudojamas analizatoriui valdyti ir konfigūruoti.

Jeigu norite padidinti mėginių srautų (kanalų) skaičių, kuriuos gali matuoti analizatorius (2, 4 ar 8), su analizatoriumi įsigykite „Moduplex“ kelių srautų pultą.

Jei norite paruošti mėginį (filtravimas, nusėdinimas), su analizatoriumi įsigykite EZ9010, EZ9020, EZ9150, EZ9200 ar EZ9250 filtravimo pultą.

## Skyrius 3 Techniniai duomenys

Techniniai duomenys gali būti keičiami neperspėjus.

Specifikacija	Išsami informacija
Matmenys (P x A x G)	460 x 688 x 340 mm (18,1 x 27,1 x 13,4 col.)
Gaubtas	IP44; ABS, PMMA ir dengtas plienas
Ekranas	IP66, 3,5 col. TFT spalvinis ekranas su talpiniu jutikliniu valdikliu
Svoris	40 kg (88 lb)
Maitinimo reikalavimai	100–240 VAC ±10 %, 50/60 Hz
Energijos sąnaudos	240 VA maks.
Aukštis virš jūros lygio	Maks. 2000 m (6560 pėd.)
Viršįtampio kategorija	II
Aplinkos sąlygos	Tik patalpose
Taršos laipsnis	2
Darbinė temperatūra	Nuo 10 iki 30 °C (nuo 50 iki 86 °F), nuo 5 iki 95 % santykinis oro drėgnis be kondensacijos, be korozijos
Laikymo temperatūra	Nuo –20 iki 60 °C (nuo –4 iki 140 °F), maks. 95 % santykinis oro drėgnis be kondensacijos
Mėginių įleidimo angos	Viena
Mėginio slėgis	Per išorinį perpildos indą (atviras atmosferiniam slėgiui)
Mėginio srauto vertė	100–300 ml/min.
Mėginio temperatūra	Nuo 10 iki 30 °C (nuo 50 iki 86 °F)
Mėginio kokybė	< 100 µm dalelės, maks. < 0,1 g/l Drumstumas < 50 NTU
Oro prapūtimas korozinėje aplinkoje	0,2 bar (20 kPa arba 3 psi); sausas ir švarus oras
Išleidimo anga	Atmosferos slėgis, ventiliuojama, min. Ø 32 mm
Įžeminimo jungtis	Mažos pilnutinės varžos (< 1 Ω), sausas ir švarus įžeminimo poliūs su > 2,5 mm <sup>1</sup> (13 AWG) įžeminimo kabeliu
Analoginiai išėjimai	Maks. aštuoni 0–20 mA (arba 4–20 mA) analoginiai išėjimai <b>Pastaba:</b> Analoginės išvestys tiekia kontūro maitinimą. Maitinimo negalima tiekti SCADA ar PLC sistemos kontaktams.
Skaitmeniniai įėjimai	Septyni skaitmeniniai įėjimai: du skaitmeniniai įėjimai nuotoliniam paleidimui. Likę skaitmeniniai įėjimai skirti naudojimui ateityje.
Skaitmeniniai išėjimai	Keturi skaitmeniniai išėjimai su įtampa EZ9150 pulto vožtuvams ir siurbliams; aštuoni skaitmeniniai išėjimai su įtampa „Moduplex“ pulto vožtuvams; 24 VDC, 500 mA.
Relės	Penki kontaktai be potencialo (FCT), maksimali apkrova 24 VDC, 0,5 A (varžinė apkrova)
Eterneto jungtys	„Claros“ eterneto jungtis ir „Modbus TCP/IP“ eterneto jungtis; LAN versija; 10/100 Mbps arba „Profinet“ ar „Ethernet IP“
RS485 ryšys	„Profibus DP“ arba „Modbus RTU“

<sup>2</sup> Informaciją apie eterneto konfigūraciją ir „Modbus“ konfigūraciją žr. SC4500 valdiklio dokumentacijoje.

<b>Specifikacija</b>	<b>Išsami informacija</b>
Sertifikatai	CE, ETL – sertifikuota pagal UL ir CSA saugos standartus, UKCA
Garantija	1 metai (ES: 2 metai)

## Skyrius 4 Bendrojo pobūdžio informacija

Gamintojas jokiū būdu nebus atsakingas už žalą, atsiradusią dėl netinkamo gaminio naudojimo arba vadove pateiktų instrukcijų nesilaikymo. Gamintojas pasilieka teisę bet kada iš dalies pakeisti šį vadovą ir jame aprašytus produktus nepranešdamas apie keitimą ir neprisiimdamas įsipareigojimų. Pataisytuosius leidimus rasite gamintojo žiniatinklio svetainėje.

LT

### 4.1 Saugos duomenys

Gamintojas nėra atsakingas už jokiū nuostolius dėl netinkamo šio gaminio taikymo ar naudojimo, įskaitant tiesioginius, atsitiktinius ir šalutinius nuostolius, bet tuo neapsiribojant, ir nepripažįsta jokiū atsakomybės už tokiū nuostolius, kiek tai leidžia galiojantys įstatymai. Tik naudotojas yra atsakingas už taikymo lemiamo pavojaus nustatymą ir tinkamų mechanizmų procesams apsaugoti per galimą įrangos triktį įrengimą.

Perskaitykite visą šį dokumentą prieš išpakuodami, surinkdami ir pradėdami naudoti šį įrenginį. Atkreipkite dėmesį į visus įspėjimus apie pavojų ir atsargom priemonės. Priešingu atveju įrenginio naudojimas gali smarkiai susižeisti arba sugadinti įrenginį.




Jeį įranga naudojama ne taip, kaip nurodė gamintojas, įrangos teikiama apsauga gali būti pažeista. Nenaudokite ir nemontuokite šios įrangos kitaip, nei nurodyta šiame vadove.




#### 4.1.1 Informacijos apie pavojų naudojimas

<b>▲ PAVOJUS</b>
Žymi galimą arba neišvengiamą pavojingą situaciją, į kurią pakliuvus galima mirtinai ar stipriai susižeisti.
<b>▲ ĮSPĖJIMAS</b>
Žymi galimą arba neišvengiamą pavojingą situaciją, kurios nevengiant gali grėsti mirtis ar stiprus sužeidimas.
<b>▲ ATSARGIAI</b>
Žymi galimą pavojingą situaciją, dėl kurios galima lengvai ar vidutiniškai susižeisti.
<b>PASTABA</b>
Žymi situaciją, kurios neišvengus gali būti sugadintas prietaisas. Informacija, kuriai reikia skirti ypatingą dėmesį.


#### 4.1.2 Apie pavojų įspėjančios etiketės

Perskaitykite visas prie prietaiso pritvirtintas etiketes ir žymas. Nesilaikant nurodytų įspėjimų galima susižaloti arba sugadinti prietaisą. Simbolis, kuriuo pažymėtas prietaisas, vadove yra nurodytas su įspėjamuoju pareiškimu.





	Tai įspėjamasis saugos signalas. Siekdami išvengti galimo sužalojimo, laikykitės visų su šiuo simboliu pateikiamų saugos reikalavimų. Jei jis pritvirtintas prie prietaiso, informacijos apie eksploataciją arba saugą ieškokite instrukcijoje.
	Šis simbolis reiškia, kad yra cheminio pakenkimo rizika, taip pat rodo, kad tik tinkamą kvalifikaciją turintiems ir specialiai išmokytiems asmenims leidžiama dirbti su cheminėmis medžiagomis ir atlikti su įranga susijusių cheminių medžiagų pristatymo sistemų techninę priežiūrą.
	Šis simbolis reiškia elektros smūgio arba mirties nuo elektros smūgio pavojų.

	Šis simbolis reiškia, kad prietaisas yra jautrus elektrostatinei iškrovai (ESD), todėl būtina imtis atsargumo priemonių siekiant išvengti įrangos apgadavimo.
	Šis simbolis rodo, kad juo pažymėtam gaminiui reikalingas apsauginis įžeminimas. Jei prietaisas pristatomas be įžeminimo kištuko, kuris turėtų būti ant laido, turi būti užtikrintas apsauginio laidininko gnybtų apsauginis įžeminimas.
	Šiuo simboliu pažymėto elektros įrenginio negalima išmesti namų arba viešosiose atliekų išmetimo vietose Europoje. Nemokamai grąžinkite nebenaudojamą įrangą gamintojui, kad ji būtų再利用uota.

### 4.1.3 Cheminė ir biologinė sauga

<b>⚠ PAVOJUS</b>	
	Cheminis arba biologinis pavojus. Jei šis prietaisas naudojamas apdorojimo procesui ir (arba) chemikalų tiekimo sistemai stebėti, ir šiam procesui ar sistemai taikomos reguliuojamosios ribos ir stebėjimo reikalavimai, susiję su visuomenės sveikata, viešuoju saugumu, maisto arba gėrimų gamyba ar apdorojimu, šio prietaiso naudotojo atsakomybė – žinoti ir laikytis visų taikomų taisyklių ir užtikrinti, kad vietoje būtų pakankamai ir tinkamų mechanizmų, kad būtų laikomasi taikomų taisyklių prietaiso trikties atveju.

## 4.2 Iliustracijose naudojamos piktogramos

			
Gamintojo tiekiamos dalys	Vartotojo tiekiamos dalys	Žiūrėkite	Atlikite veiksmus atvirkščia tvarka

				
Darykite dviese	Klausykitės	Naudokitės tik pirštais	Nesinaudokite įrankiais	Nelieskite

### 4.3 Numatytasis naudojimas

„Hach“ EZ-serijos analizatoriai yra skirti naudoti, kai reikia nuolat matuoti pramoninių ir aplinkos vandens mėginių kokybės parametrus. Hach EZ-serijos analizatoriai neapdoroja vandens ir nekeičia jo savybių, taip pat nenaudojami kontrolės procedūroms.


### 4.4 Gaminio sudedamosios dalys


Įsitinkite, kad gavote visas sudedamąsias dalis. Žr. [Paveikslėlis 4](#) Puslapyje 451. Jei dalių trūksta ar jos yra apgadintos, nedelsdami susisieki su gamintoju ar prekybos atstovu.


## Skyrius 5 Montavimas

<b>⚠ PAVOJUS</b>	
	Ivairūs pavojai. Šiame dokumento skyriuje aprašytas užduotis turi vykdyti tik kvalifikuoti darbuotojai.

## 5.1 Įrengimo instrukcijos

▲ ĮSPĖJIMAS	
	Gaisro pavojus. Naudotojas privalo įsitikinti, kad imtasi pakankamų atsargumo priemonių, kai įranga naudojama metodams, kuriems naudojami degūs skysčiai. Būtinai laikykitės tinkamų saugaus naudojimo priemonių ir saugos protokolų. Įskaitant, bet ne tik, išsiliejimų ir nuotėkių kontrolę, tinkamą vėdinimą, nenaudojimą be priežiūros ir kad niekada be priežiūros nebūtų paliktas prietaisas, kurio maitinimas įjungtas.

▲ ATSARGIAI	
	Sąlyčio su cheminėmis medžiagomis pavojus. Vykdykite laboratorijos saugos procedūras ir dėvėkite visas asmeninės saugos priemones, tinkančias naudojamiems chemikalams. Saugos protokolai nurodyti galiojančiuose saugos duomenų lapuose (MSDS / SDS).

▲ ATSARGIAI	
	Sąlyčio su cheminėmis medžiagomis pavojus. Chemikalus ir atliekas išmeskite pagal vietos, regiono ir nacionalines taisykles.

- Analizatorių įrenkite patalpose, nepavojingoje aplinkoje.
- Analizatorių įrenkite aplinkoje, apsaugotoje nuo korozinių skysčių.
- Analizatorių montuokite švarioje, sausoje, gerai vėdinamoje ir kontroliuojamos temperatūros vietoje.
- Analizatorių montuokite kuo arčiau mėginių ėmimo taško.
- Nemontuokite analizatoriaus tiesioginėje saulėkaitoje arba šalia šilumos šaltinio.
- Įsitikinkite, kad yra pakankamai vietos, kad būtų galima prijungti vamzdžius ir elektros jungtis.
- Įsitikinkite, kad yra pakankamai vietos analizatoriaus priekyje, kad būtų galima atidaryti analizatoriaus duris. Žr. [Analizatoriaus matmenys](#) Puslapyje 291.
- Įsitikinkite, kad aplinkos sąlygos atitinka eksploataavimo specifikacijas. Žr. [Techniniai duomenys](#) Puslapyje 288.

Nors analizatorius neskirtas naudojimui su degiais mėginiais, kai kurie EZ analizatoriai naudoja degius reagentus. Informaciją apie analizatoriuje naudojamus reagentus žr. atitinkamos EZZ serijos metodų ir reagentų dokumente. Jei analizatoriuje naudojami degūs reagentai, laikykitės šių saugos reikalavimų:


- Apsaugokite analizatorių nuo karščio, kibirkščių ir atviros liepsnos šaltinių.
- Šalia analizatoriaus nevalgykite, negerkite ir nerūkykite.
- Naudokite vietinę ištraukimo ventiliaciją.
- Naudokite kibirkščiaivimui ir sprogimui atsparią įrangą bei apšvietimo sistemą.
- Apsaugokite nuo elektrostatinių išlydžių. Žr. [Informacija apie elektrostatinį krūvį \(ESK\)](#) Puslapyje 292.
- Prieš naudojimą, visiškai išvalykite ir išdžiovinkite instrumentą.
- Plaukite rankas prieš darbo laikotarpio pertraukas ir jo pabaigoje.
- Nusivilkite užterštą aprangą. Skalbkite aprangą prieš jos pakartotinį naudojimą.
- Šie skysčiai turi būti tvarkomi pagal vietinių kontroliuojančių įstaigų reikalavimus leistino poveikio reikšmėms.

## 5.2 Analizatoriaus matmenys


Analizatoriaus matmenis žr. [Paveikslėlis 5](#) Puslapyje 454.

## 5.3 Mechaninis montavimas

### 5.3.1 Prietaiso tvirtinimas prie sienos

▲ ĮSPĖJIMAS	
	Pavojus susižeisti. Įsitikinkite, kad sieninis laikiklis galėtų išlaikyti 4 kartus didesnį svorį, nei sveria įranga.

▲ ĮSPĖJIMAS	
	Pavojus susižeisti. Prietaisai arba komponentai yra sunkūs. Juos montuodami ar perkeldami pasikvieskite pagalbos.

▲ ĮSPĖJIMAS	
	Pavojus susižeisti. Objektas yra sunkus. Norėdami užtikrinti saugų veikimą, įsitikinkite, kad prietaisas patikimai pritvirtintas prie sienos, stalo ar grindų.

Naudodami pateiktas tvirtinimo gembes, pritaisykite prietaisą pagal statmeną ir gulsčią liniją prie plokščio, vertikalaus sienos paviršiaus. Žr. [Paveikslėlis 6](#) Puslapyje 456.

Sumontuokite prietaisą tokioje vietoje ir padėtyje, kur naudotojas galėtų lengvai jį atjungti nuo maitinimo šaltinio.


Įsitikinkite, kad po analizatoriumi yra pakankamai vietos buteliukams įdėti.

Montavimo ant sienos įranga pasirūpina naudotojas. Įsitikinkite, ar sieninio laikiklio laikomoji geba yra pakankama (apytikriai 160 kg arba 353 sv.). Tvirtinimo detalės turi būti patvirtintos atsižvelgiant į sienos savybes.


### 5.3.2 Atidarykite analizatoriaus dureles

Naudokite pridėtą raktą, kad atrakintumėte du užraktus analizatoriaus šone. Žr. [Paveikslėlis 7](#) Puslapyje 456. Prieš darbą būtinai uždarykite dureles, kad būtų išlaikytos gaubto aplinkos vardinės charakteristikos ir saugos vardinės charakteristikos.

## 5.4 Elektros instaliacija

▲ PAVOJUS	
	Mirtino elektros smūgio pavojus. Prieš jungdami elektrines jungtis visada atjunkite prietaiso maitinimą.

### 5.4.1 Informacija apie elektrostatinį krūvį (ESK)

PASTABA	
	Galima žala prietaisui. Jautrius vidinius elektroninius komponentus gali pažeisti statinis elektros krūvis, dėl to prietaisas gali veikti ne taip efektyviai ir galiausiai sugesti.

Norėdami išvengti ESK sukeltos žalos prietaisui, žr. šios procedūros veiksmus.

- Palieskite įžemintą metalinį paviršių, pvz., prietaiso korpusą, metalinį izoliacinį ar įprastą vamzdį – taip iškrausite statinę elektrą iš kūno.
- Venkite intensyvaus judėjimo. Statiniam krūviui jautrius komponentus gabenkite antistatinuose konteneriuose ar pakuotėse.
- Dėvėkite riešo juostelę, laidu sujungtą su įžeminimu.
- Dirbkite nuo statinio krūvio apsaugotame plote su antistatiniais grindų ir darbstačių kilimėliais.

## 5.4.2 Elektros įrangos prieiga

Perveskite išorinių prietaisų kabelius per kabelių riebokšlius. Žr. [Paveikslėlis 8](#) Puslapyje 458. Nenaudojamus kabelių riebokšlius palikite užkištus.

[Paveikslėlis 9](#) Puslapyje 461 pavaizduoti analizatoriaus viduje esantys komponentai. Maitinimo jungiklis – tai grandinės pertraukiklis, kuris automatiškai atjungia elektros tinklo maitinimą nuo KS maitinimo linijos, jei įvyksta virššrovis (pvz., trumpasis jungimas) arba viršįtampis.

## 5.4.3 Išorinių prietaisų prijungimas

Prie analizatoriaus signalų ir valdymo gnybtų prijunkite išorinius prietaisus, kurie bus naudojami su analizatoriumi. Žr. [Paveikslėlis 10](#) Puslapyje 465 ir [Lentelė 1](#) Puslapyje 293.

**Lentelė 1 Signalų ir valdymo gnybtai — aprašai**

Kištukas	Aprašas
AO1–AO8 (P101)	Aštuoni analoginiai išėjimai išoriniams prietaisams valdyti. Daugiau informacijos rasite išplėstinėje naudotojo vadovo versijoje, pasiekiamoje internetu.
FCT1–FCT5 (P102)	Penkios relės (kontaktai be potencialo) Apkrovos maksimumas yra 24 VDC, 0,5 A. <ul style="list-style-type: none"><li>• FCT1 — trikties pavojaus signalas</li><li>• FCT2 — techninės priežiūros pavojaus signalas</li><li>• FCT3 — analizatorius parengtas</li><li>• FCT4 ir FCT5 — naudojimui ateityje</li></ul>
DI1–DI7 (P103)	Septyni skaitmeniniai išėjimai analizatoriui valdyti nuotoliniu būdu <sup>5</sup> . Prijunkite skaitmeninius išėjimus prie išorinio kontakto be potencialo (24 VDC), kad aktyvuotų analizatorių matavimui kanalo atžvilgiu pradėti. <ul style="list-style-type: none"><li>• DI1 — nuotolinis paleidimas kanalo 1 atžvilgiu</li><li>• DI2 — nuotolinis paleidimui kanalo 2 atžvilgiu</li><li>• DI3–DI7 — naudojimui ateityje</li></ul>
FB1–FB4 (P104)	„Profibus DP“ arba „Modbus RTU“ (RS485) jungtys <b>„Profibus DP“:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• FB1 — A1 (įėjimas)</li><li>• FB2 — A2 (išėjimas)</li><li>• FB3 — B1 (įėjimas)</li><li>• FB4 — B2 (išėjimas)</li><li>• SHL — ekranas</li></ul> <b>„Modbus RTU“:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• FB1 — D (+)</li><li>• FB2 — D (-)</li><li>• FB3 — nenaudojamas</li><li>• FB4 — nenaudojamas</li><li>• SHL — ekranas</li></ul> „Modbus“ konfigūracijos nurodymus ir telegramų žymes žr. SC4500 valdiklio dokumentacijoje.
24VDC/1A (P105)	24 V DC maitinimo šaltinis EZ9010 ir EZ9020 filtravimo blokams

<sup>5</sup> Jei analizatorius veikia techninės priežiūros režimu, nuotolinis valdymas išjungtas.

## Lentelė 1 Signalų ir valdymo gnybtai — aprašai (tęsinys)

Kištukas	Aprašas
STR1–STR8 (P106)	<p>Aštuoni skaitmeniniai išėjimai, skirti pasirinktiniam „Moduplex“ pultui. Kiekvieno kanalo vožtuvo plikus laidus prijunkite „Moduplex“ pulte prie susijusių STR jungčių.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• STR1 — kanalas 1</li> <li>• STR2 — kanalas 2</li> <li>• ...</li> <li>• STR8 — kanalas 8</li> </ul>
EXT9–EXT12 (P107)	<p>Keturi skaitmeniniai išėjimai pasirinktiniam EZ9150 filtravimo pultui. Elektrinius vožtuvus ir siurbį EZ9150 filtravimo pulte prijunkite prie EXT jungčių.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EXT9 — skalavimo vožtuvas</li> <li>• EXT10 — atgalinio praplovimo vožtuvas</li> <li>• EXT11 — išleidžiamasis perpildos vožtuvas</li> <li>• EXT12 — filtravimo vožtuvas</li> </ul>
D01–D06 (P108 ir P109)	<p>Šeši EZ9150 pulto pneumatinių vožtuvų išėjimai.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• D01 – mėginio įleidimo vožtuvas</li> <li>• D02 – išleidžiamasis perpildos vožtuvas</li> <li>• D03 – 1 kanalo vožtuvas</li> <li>• D04 – 2 kanalo vožtuvas</li> <li>• D05 – 3 kanalo vožtuvas</li> <li>• D06 – 4 kanalo vožtuvas</li> </ul>

### 5.4.4 Junkite prie kintamosios srovės (KS) maitinimo šaltinio

#### ▲ PAVOJUS



Elektros smūgio ir gaisro pavojus. Įsitikinkite, kad įsigytas laidas ir neužfiksuojamasis kištukas atitinka taikomus šalies kodo reikalavimus.


- Įsitikinkite, kad maitinimo linijoje įrengtas pakankamo galingumo elektros srovės išjungiklis.
- Užtikrinkite, kad netoli analizatoriaus būtų įrengtas srovės išjungiklis arba avarinis išjungiklis, kad prireikus būtų galima nedelsiant atjungti analizatorių nuo maitinimo šaltinio.
- Prijunkite įrangą pagal vietos, regiono ar nacionalines elektros įrenginių taisykles.
- Perveskite pateikiamą maitinimo laidą per kabelio riebokšlį, esantį analizatoriaus šone.
- Priveržkite kabelio riebokšlį, kad jis patikimai laikytų maitinimo kabelį ir būtų išlaikytos gaubto aplinkos vardinės charakteristikos.

Pateikiamu AC maitinimo laidu sujunkite analizatorių su AC maitinimo šaltiniu. Žr. [Lentelė 2](#) Puslapyje 295 ir [Paveikslėlis 11](#) Puslapyje 468.

## PASTABA

Nenustatykite maitinimo jungiklio į įjungimo padėtį. Prieš paleisdami sumontuokite visas elektros ir vamzdžių jungtis, nes kitaip analizatorius gali būti pažeistas.

**Lentelė 2 Laidų informacija – KS maitinimas**

Gnybtas	Aprašas	Kabelio spalva - Šiaurės Amerika ir Kanada	Kabelio spalva - ES
L	Fazė / linija (L)	Juoda (1)	Ruda
N	Nulis (N)	Balta (2)	Mėlyna
	Apsauginis įžeminimas (PE)	Žalia su geltona juostele	Žalia su geltona juostele

## 5.5 Skysčių tiekimo sistema

### 5.5.1 Mėginio linijos parengimo gairės

#### ▲ **ATSARGIAI**



Gaisro pavojus. Šis gaminytis nėra skirtas naudoti su degiais mėginiais.

Kad prietaisas veiktų geriausiai, pasirinkite tinkamą, tipišką mėginio ėmimo tašką. Mėginys turi atspindėti visą sistemą.

- Įsitikinkite, kad mėginio srautas yra aukščiau už srautą į analizatorių.
- Įsitikinkite, kad mėginio linija yra atmosferos slėgio, jei analizatoriuje naudojamas peristaltinis siurblys mėginiui į tyrimo indą perkelti.
- Įsitikinkite, kad mėginio linija mėginį paima iš mažo perpildos indo šalia analizatoriaus.
- Naudokite tiekiamą mėginio liniją. Nekeiskite mėginio linijos ilgio.

Mėginys perpildos inde turi būti nuolat atnaujinamas. Jei mėginyje kietųjų dalelių dydis yra per aukštas, rekomenduojama mėginį ir filtruoti.

### 5.5.2 Rekomendacijos dėl išleidimo linijų

#### ▲ **ĮSPĖJIMAS**



Gaisro pavojus. Naudotojas privalo įsitikinti, kad imtasi pakankamų atsargumo priemonių, kai įranga naudojama metodams, kuriems naudojami degūs skysčiai. Būtinai laikykitės tinkamų saugaus naudojimo priemonių ir saugos protokolų. Įskaitant, bet ne tik, išsiliejimų ir nuotėkių kontrolę, tinkamą vėdinimą, nenaudojimą be priežiūros ir kad niekada be priežiūros nebūtų paliktas prietaisas, kurio maitinimas įjungtas.

#### ▲ **ATSARGIAI**



Sąlyčio su cheminėmis medžiagomis pavojus. Chemikalus ir atliekas išmeskite pagal vietos, regiono ir nacionalines taisykles.

## PASTABA

Nejunkite išleidimo linijų prie kitų linijų, nes gali atsirasti atgalinis slėgis arba galite sugadinti analizatorių. Įsitikinkite, kad išleidimo linijos yra atviros į orą.

## PASTABA

Kad išvengtumėte atgalinio slėgio susidarymo ir nesugadintumėte analizatoriaus, įsitinkite, kad analizatorius yra aukščiau, nei naudojama įstaigos nuotekų sistema, ir išleidimo linija turi nuolatinį nuolydį žemyn. Prijunkite išleidimo liniją 2,54 cm ar didesniu vertikaliu nuolydžiu kiekvienai 0,3 m vamzdžio atkarpai.

Analizatoriaus išleidimo liniją naudoja mėginiui ir reagentams po analizės išleisti. Svarbu tinkamai įrengti išleidimo linijas, kad iš prietaiso būtų pašalintas visas skystis. Netinkamai jas įrengus, skystis gali sugrįžti į prietaisą ir jį sugadinti. Išleidimo linijai pakanka nuotako grindyse arba kriauklės. Rekomenduojamas išleidimo vamzdžio išorinis skersmuo yra 32 mm. Žr. [Paveikslėlis 12](#) Puslapyje 471.

- Pasistenkite, kad išleidimo linijos būtų kuo trumpesnės.
- Pasirūpinkite, kad nuotakas būtų žemiau už analizatorių.
- Pasirūpinkite, kad išleidimo linijos nuolat žemėtų.
- Pasirūpinkite, kad išleidimo linijos neturėtų aštrių posūkių ir nebūtų suspaustos.
- Pasirūpinkite, kad išleidimo linijos būtų atviros į orą ir jose būtų nulinis slėgis.
- Pasirūpinkite, kad išleidimo linijos būtų uždaros nuo montavimo patalpos aplinkos.
- Neužblokuokite ir neparandinkite išleidimo linijos.

Taip pat rekomenduojama vandens jungtis netoli analizatoriaus, kad nuotako kriauklė ir ištuštinimo vamzdeliai būtų reguliariai plaunami švariu vandeniu ir neužsiblokuotų dėl susiformavusių kristalų.

Informaciją apie analizatoriuje naudojamus reagentus žr. atitinkamos EZZ serijos metodų ir reagentų dokumente. Jei analizatoriuje naudojami degūs reagentai, laikykitės šių saugos reikalavimų:

- Nejunkite išleidimo linijos į nuotekų vamzdį grindyse.
- Atliekas išmeskite vadovaudamiesi vietos, regiono ir nacionalinėmis taisyklėmis.

### 5.5.3 Rekomendacijos dėl ventiliacinės linijos

#### ⚠ ĮSPĖJIMAS



Gaisro pavojus. Naudotojas privalo įsitikinti, kad imtasi pakankamų atsargumo priemonių, kai įranga naudojama metodams, kuriems naudojami degūs skysčiai. Būtinai laikykitės tinkamų saugaus naudojimo priemonių ir saugos protokolų. Įskaitant, bet ne tik, išsiliejimų ir nuotėkių kontrolę, tinkamą vėdinimą, nenaudojimą be priežiūros ir kad niekada be priežiūros nebūtų paliktas prietaisas, kurio maitinimas įjungtas.

#### ⚠ ATSARGIAI



Sąlyčio su cheminėmis medžiagomis pavojus. Chemikalus ir atliekas išmeskite pagal vietos, regiono ir nacionalines taisykles.

## PASTABA

Nejunkite ventiliacinės linijos (išmetamųjų dujų vamzdžio) prie kitų linijų, nes gali atsirasti atgalinis slėgis arba galite sugadinti analizatorių. Pasirūpinkite, kad ventiliacinė linija išeitų į lauką pastato išorėje.

## PASTABA

Kad išvengtumėte atgalinio slėgio susidarymo ir nesugadintumėte analizatoriaus, įsitinkite, kad analizatorius yra aukščiau nei naudojama įstaigos nuotekų sistema, ventiliacinė linija išlaiko pastovų nuolydį žemyn. Prijunkite ventiliacinę liniją 2,54 cm ar didesniu vertikaliu nuolydžiu kiekvienai 0,3 m vamzdžio atkarpai.

Analizatoriaus ventiliacinė linija naudojama tam, kad analizės inde išliktų atmosferos slėgis. Svarbu taisyklingai sumontuoti ventiliacinę liniją, kad siurbliui veikiant joks skystis tikrai negalėtų per ventiliacinę liniją patekti į analizės indą. Netinkamai jas įrengus, dujos gali sugrįžti į analizatorių ir jį sugadinti. Rekomenduojamas ventiliacinės linijos pagrindinio vamzdžio išorinis skersmuo yra 32 mm. Žr. [Paveikslėlis 12](#) Puslapyje 471.

- Pasistenkite, kad ventiliacinė linija būtų kuo trumpesnė.
- Pasirūpinkite, kad ventiliacinė linija išlaikytų pastovų nuolydį žemyn.
- Pasirūpinkite, kad ventiliacinėje linijoje nebūtų staigių užlenkimų ir ji nebūtų suspausta.

- Pasirūpinkite, kad ventiliacinė linija būtų uždara nuo montavimo patalpos aplinkos ir joje būtų nulinis slėgis.
- Užtikrinkite, kad ventiliacinė linija visada būtų aukščiau nei išleidimo anga.
- Neužblokuokite ir nepanardinkite ventiliacinės linijos.

Jei analizatoriuje naudojami degūs reagentai, laikykitės šių saugos reikalavimų:

- Nejunkite ventiliacinės linijos į nuotekų vamzdį grindyse.
- Atliekas išmeskite vadovaudamiesi vietos, regiono ir nacionalinėmis taisyklėmis.

## 5.5.4 Analizatoriaus skysčių jungčių sujungimas komponentų testui


### ⚠ ATSARGIAI





Gaisro pavojus. Šis gaminytis nėra skirtas naudoti su degiais skysčiais.

Prieš pradėdami naudoti analizatorių su visais reagentais, reikia atlikti komponentų testą su dejonizuotu vandeniu. Žr. iliustruotus veiksmus ir [Komponentų testų atlikimas](#) Puslapyje 301.

1. Sumontuokite keturis suspaudimo vožtuvų vamzdelius, kaip pavaizduota toliau pateiktoje veiksmo 1 iliustracijoje.
  - a. Spausdami juodą mygtuką, įspauskite vamzdelį į vožtuvą.
  - b. Atleiskite mygtuką, kai vamzdelis bus taisyklingai sumontuotas.
2. Įsitinkinkite, kad tinkamai prijungtas išleidimo vamzdelis prie mėginio talpyklos. Žr. toliau pateiktą 2 veiksmo iliustraciją.
3. Įsitinkinkite, kad skaidymo įrenginio vamzdeliai tinkamai prijungti prie talpyklos. Žr. toliau pateiktą 3 veiksmo iliustraciją.
4. Visus analizatoriaus skysčių vamzdelius prijunkite prie dejonizuoto vandens didbutelio komponentų testams atlikti. Žr. toliau pateiktą 3 veiksmo iliustraciją. Vamzdeliai įrengiami gamykloje.

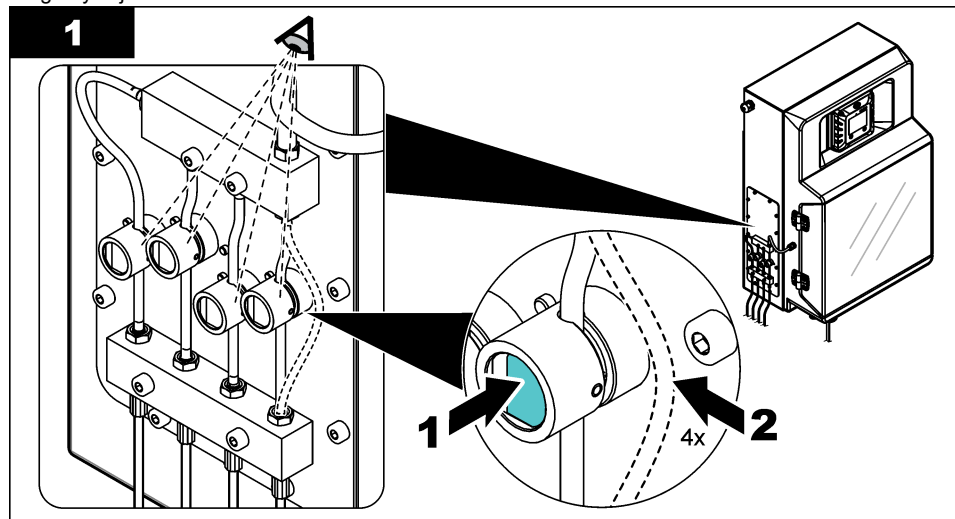

2

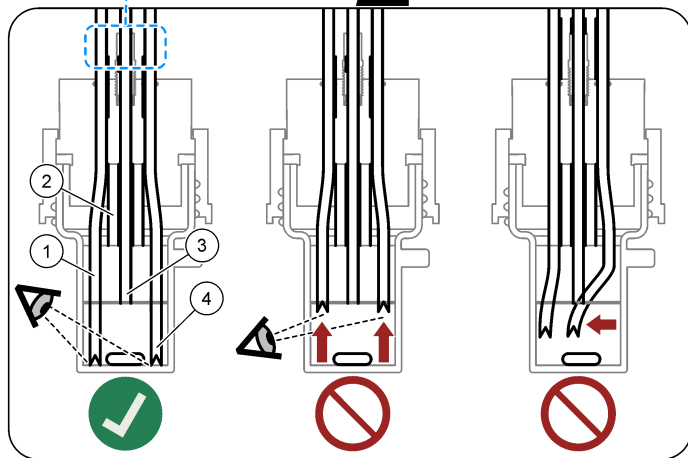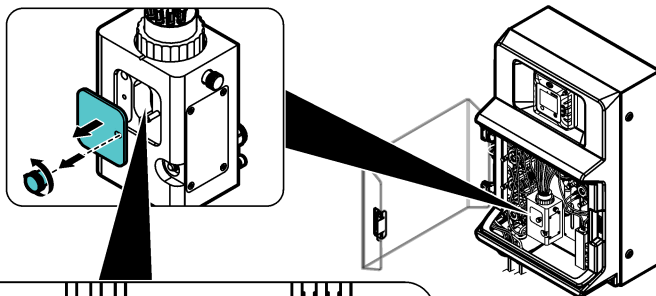


1 Ištuštinimo vamzdelis

3 Mėginio vamzdeliai

2 Reagentų ir ventiliacinis vamzdeliai (viršutiniai vamzdeliai)

4 Skaidymo įrenginio vamzdeliai

3

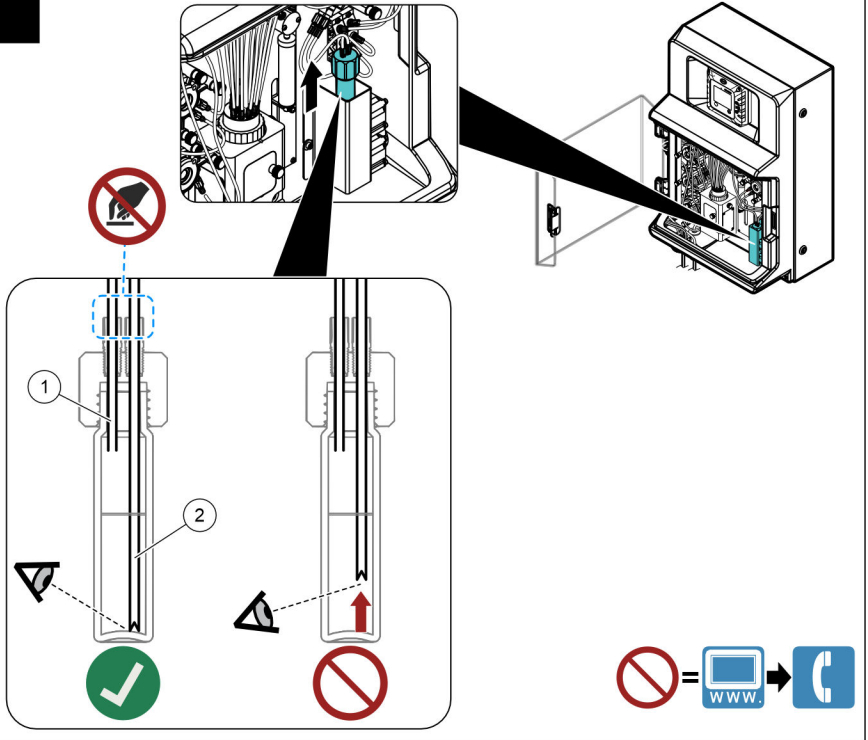


LT

1 Ventiliacinis vamzdelis

2 Skaidymo įrenginio vamzdeliai

4

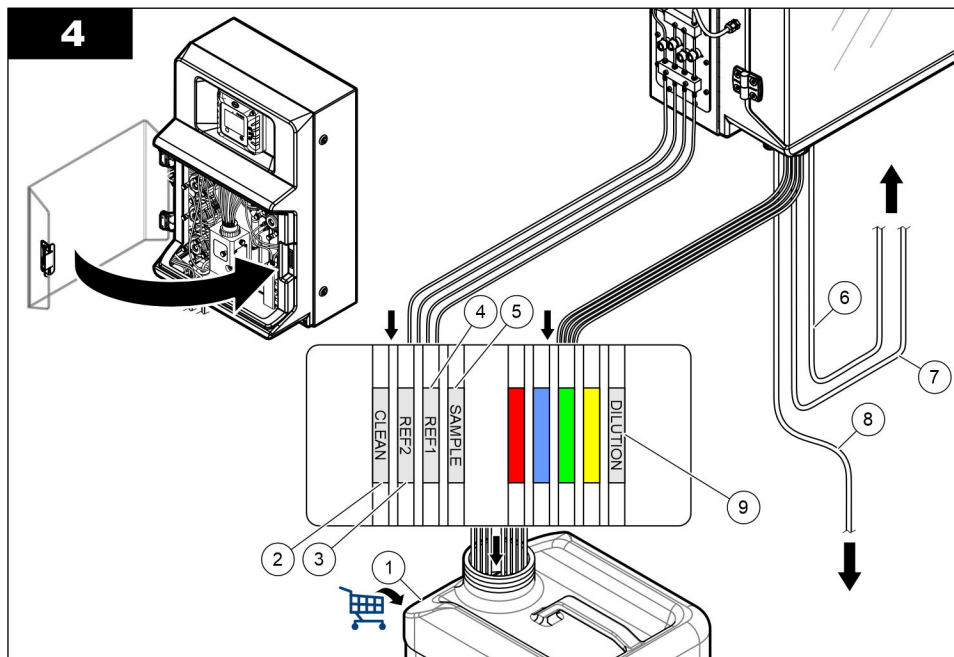

1 Dejonizuotas vanduo	4 Etaloninio 1 tirpalo (REF1) vamzdelis	7 Skaidymo ringinio ventiliavimas
2 Valymo tirpalo vamzdelis	5 Mėginio įleidimo vamzdelis	8 Ištuštinimo vamzdelis
3 Etaloninio 2 tirpalo (REF2) vamzdelis	6 Ventiliacinis vamzdelis	9 Skiedimo ir reagento mikrosiurblių vamzdeliai

## Skyrius 6 Paleidimas

### 6.1 Pradinė paleistis

**Pastaba:** Prieš paleisdami užtikrinkite, kad būtų visiškai baigti tvirtinimo, vamzdelių montavimo ir elektros instaliacijos darbai. Žr. [Montavimas](#) Puslapyje 290.

Pirmą kartą įjungus analizatorių, paleidimo asistentas padeda atlikti pirmuosius veiksmus, kad baigtumėte sąranką. Atlikite visus tolesnius veiksmus, kad užtikrintumėte, jog analizatorius veiktų tinkamai.

**Pastaba:** Būtinai naudokite pasirinktam matavimų diapazonui tinkamus reagentus. Daugiau informacijos rasite išplėstinėje naudotojo vadovo versijoje, pasiekiamoje internetu.

- Atidarykite analizatoriaus dureles. Žr. [Atidarykite analizatoriaus dureles](#) Puslapyje 292.
- Nustatykite maitinimo jungiklį į įjungimo padėtį. Žr. [Paveikslėlis 9](#) Puslapyje 461.
- Uždarykite analizatoriaus dureles naudodami tiekiamą raktą.
- Palaukite, kol bus baigta inicijavimo procedūra.
- Ekrane gavę paraginimą, pasirinkite kalbą, laiko juostą, datą ir laiką.  
Norėdami sukonfigūruoti kitus valdiklio nustatymus, žr. SC4500 valdiklio dokumentaciją.
- Bakstelėkite ekraną, kad būtų rodomas meniu **EZ2700sc**.
- Pasirinkite „**Device menu**“ (**Prietaiso meniu**), kad įjungtumėte paleidimo asistentą. Pateikiamas titulinis puslapis.

8. Atlikite ekrane pateikiamus veiksmus, kad pasirinktumėte taikomą matavimų diapazoną. Paspauskite **OK (Gerai)**.
9. Jei sumontuotas filtravimo blokas, pasirinkite „**On**“ (**Ijungta**). Jei ne, pasirinkite „**Off**“ (**Išjungta**).
10. Pasirinkite analizatoriaus kanalų skaičių. Paspauskite **OK (Gerai)**.
11. Jei suvestinės puslapyje rodoma tinkama konfigūracija, spustelėkite **OK (Gerai)**. Rodomas pagrindinis meniu **EZ2700sc**.
12. Atlikite komponentų testą. Žr. [Komponentų testų atlikimas](#) Puslapyje 301.

## 6.2 Komponentų testų atlikimas

### ⚠ ĮSPĖJIMAS



Suspaudimo pavojus. Judančios dalys gali suspausti ir sužeisti. Nelieskite judančių dalių.

Prieš pradėdami naudoti analizatorių, atlikite komponentų testus. Naudodami meniu „**Maintenance**“ (**Techninė priežiūra**), paleiskite skirtingas analizatoriaus funkcijas, kad patikrintumėte komponentų veikimą.

#### Išankstinės sąlygos:

- Jei analizatorius veikia darbinio režimu, pasirinkite „**Maintenance**“ (**Techninė priežiūra**) > „**Start maintenance mode**“ (**Paleisti techninės priežiūros režimą**).
- Įsitikinkite, ar mėginio, reagento ir tirpalo vamzdeliai yra dejonizuoto vandens talpykloje. Žr. [Analizatoriaus skysčių jungčių sujungimas komponentų testui](#) Puslapyje 297.

#### 6.2.1 Maišiklio patikrinimas

1. Nuimkite šviesos ekraną nuo fotometro bloko. Žr. [Paveikslėlis 13](#) Puslapyje 472.
2. Įsitikinkite, kad maišiklis yra mėginio indo dugne.  
*Pastaba: Per užpildymo procedūrą patikrinkite, ar maišiklis tinkamai sukasi. Užpildymo procedūra pradama Siurblių ir suspaudimo vožtuvų patikrinimas* Puslapyje 301.
3. Sumontuokite šviesos ekraną ant fotometro.

#### 6.2.2 Siurblių ir suspaudimo vožtuvų patikrinimas

1. Patikrinkite siurblių ir suspaudimo vožtuvų veikimą, kad įsitikintumėte, ar nėra nuotėkio.
2. Įsitikinkite, ar analizės indas prisipildo dejonizuoto vandens. Žr. [Paveikslėlis 14](#) Puslapyje 474.
3. Įsitikinkite, ar dejonizuotas vanduo išteka iš ištuštinimo vamzdelio.
4. Pasirinkite „**Maintenance**“ (**Techninė priežiūra**) > „**Start priming**“ (**Pradėti užpildymą**) ir atskirai užpildykite visais skysčiais.

Jei yra nuotėkis, patikrinkite visas jungtis ir skaitykite išsamią naudotojo vadovo versiją internete.

- a. Pasirinkite „**Prime reference 1**“ (**1 užpildymo etalonas**), tada paspauskite **OK (Gerai)**.
- b. Pasirinkite „**Prime reference 2**“ (**2 užpildymo etalonas**), tada paspauskite **OK (Gerai)**.
- c. Pasirinkite „**Prime cleaning solution**“ (**Užpildyti valymo tirpalą**), tada paspauskite **OK (Gerai)**.
- d. Pasirinkite „**Prime rinsing**“ (**Užpildymo skalavimas**), tada paspauskite **OK (Gerai)**.
- e. Pasirinkite „**Prime dispenser**“ (**Užpildymo dalytuvas**), tada paspauskite **OK (Gerai)**.
- f. Pasirinkite „**Prime channel**“ (**Užpildymo kanalas**) > „**Prime all channels**“ (**Užpildyti visus kanalus**), tada paspauskite **OK (Gerai)**.  
Baigus procedūrą automatiškai sustabdoma kiekviena užpildymo procedūra.

### 6.2.3 Mikrosiurblių patikrinimas

Patikrinkite, ar mikrosiurbliai neprateka ir ar nėra oro burbuliukų.

1. Nuimkite šviesos skydelį nuo fotometro.
2. Pasirinkite „Maintenance“ (Techninė priežiūra) > „Start priming“ (Pradėti užpildymą) > „Prime all reagents“ (Užpildyti visais reagentais).
3. Įsitinkinkite, ar dejonizuotas vanduo į mikrosiurblių teka per kiekvieną mikrosiurblių (reagento) vamzdelį. Tada patikrinkite, ar tolydžiai, be oro burbuliukų teka į analizės indą. Žr. [Paveikslėlis 15](#) Puslapyje 475.
4. Jei mikrosiurbliai veikia netinkamai (vamzdeliuose yra burbuliukų), atlikite procedūrą su švirkštu, išstumdami dejonizuotą vandenį į atitinkamą vamzdelį, kad pašalintumėte burbuliukus. Žr. [Paveikslėlis 16](#) Puslapyje 476.
5. Sumontuokite šviesos ekraną ant fotometro.

### 6.2.4 Atlikite fotometrinę patikrą

Prieš atlikdami fotometrinę patikrą įsitinkinkite, kad analizuojamos talpyklos išorė yra švari, kad patikrinimas būtų sėkmingas. Informaciją apie analizatoriaus komponentų valymą rasite išplėstinėje naudotojo vadovo versijoje internete.

1. Paspauskite pagrindinio meniu piktogramą ir pasirinkite „Devices“ (Prietaisai).
2. Pasirinkite **EZ2700sc**.
3. Slinkite žemyn iki ekrano apačios, tada pasirinkite „Device menu“ (Prietaiso meniu).
4. Pasirinkite „Maintenance“ (Techninė priežiūra) > „Photometer check“ (Patikrinti fotometrą).
5. Paspauskite **OK (Gerai)** matavimui pradėti. Pasibaigus tamsos kalibravimui, ekrane pateikiamas rezultatas.
6. Paspauskite **OK (Gerai)**, norėdami tęsti.
7. Įsitinkinkite, kad vamzdelis „REF1“ prijungtas prie talpyklės, kuri pripildyta dejonizuoto vandens. Įsitinkinkite, ar sumontuotas šviesos ekranas. Žr. [Paveikslėlis 18](#) Puslapyje 478.
8. Paspauskite **OK (Gerai)**. Palaukite, kol prisipildys analizės indas.
9. Atsuktuvu nustatykite 9 V jutiklio išėjimo įtampą. Žr. [Paveikslėlis 17](#) Puslapyje 476.
10. Palaukite, kol ekrane bus rodoma reikšmė 9 V. Tada paspauskite **OK (Gerai)**.
11. Paspauskite **OK (Gerai)**, norėdami tęsti.

### 6.3 Atlikite įvesties signalo patikrą

Prieš naudodami analizatorių atlikite skaitmeninių įvesčių patikrą.

**Būtiniosios sąlygos:** prijunkite skaitmenines įvestis prie išorinio kontakto be potencialo (24 VDC).

Skaitmeninio įėjimo signalo ir analoginio išėjimo signalo bandymą atlikite taip:

1. Paspauskite pagrindinio meniu piktogramą, tada pasirinkite **Devices** (Irenginiai).
2. Pasirinkite **EZ2700sc**.
3. Slinkite žemyn iki ekrano apačios, tada pasirinkite „Device menu“ (Prietaiso meniu).
4. Pasirinkite „Diagnostics“ (Diagnostika) > „Signals“ (Signalai). Rodomi skaitmeninių įėjimų signalai.
5. Palyginkite skaitmeninių įėjimų būseną ekrane su įtampa, tiekiami į skaitmeninius įėjimus (24 V = „On“ (Ijungta); 0 V = „Off“ (Išjungta)).

### 6.4 Atlikite išvesties signalo patikrą

Prieš naudodami analizatorių, atlikite analoginių išvesčių patikrą.

**Būtiniosios sąlygos:** konfigūruokite analogines išvestis (AO1–AO8, P101), kad pasirinktumėte kanalo matmenį, kurį nurodo kiekviena analoginė išvestis. Daugiau informacijos rasite išplėstinėje naudotojo vadovo versijoje, pasiekiamoje internetu.

Analoginės išvesties signalo patikrą atlikite tokiu būdu:

1. Paspauskite pagrindinio meniu piktogramą.
2. Pasirinkite „**Outputs**“ (Išvestys) > „**mA outputs AOC**“ (mA išvestys AOC) > „**Test/Maintenance**“ (Patikrinimas / priežiūra).

Parinktis	Aprašas
„ <b>Function test</b> “ (funkcinė patikra)	Atliekamas pasirinkto modulio išvesčių patikrinimas.
„ <b>Output status</b> “ (išvesties būseną)	Rodoma pasirinkto modulio išvesčių būseną.

3. Multimetru išmatuokite mA vertę ties kiekvienu analoginiu išėjimu.
4. Palyginkite ties analoginiais išėjimais išmatuotą mA vertę su tikėtinomis mA vertėmis.

## 6.5 Kanalų sekos nustatymas

Pasirinkite seką, kuria bus matuojami kanalai, kiek kartų bus matuojamas kiekvienas kanalas ir laukimo trukmę prieš matuojant kanalą. Įveskite ne daugiau kaip 16 linijų po ne daugiau kaip 16 ciklų.

1. Paspauskite pagrindinio meniu piktogramą ir pasirinkite „**Devices**“ (Prietaisai).
2. Pasirinkite **EZ2700sc**.
3. Slinkite žemyn iki ekrano apačios, tada pasirinkite „**Device menu**“ (Prietaiso meniu).
4. Jei analizatorius veikia darbinio režimu, pasirinkite „**Maintenance**“ (Techninė priežiūra) > „**Start maintenance mode**“ (Paleisti techninės priežiūros režimą).  
Palaukite, kol analizatorius pradės veikti techninės priežiūros režimu.
5. Pasirinkite „**Configuration**“ (Konfigūracija) > „**Channel sequence setup**“ (Kanalų sekos sąranka).
6. Rodyklėmis šoninėje juostoje pasirinkite poziciją (numerį sekoje), tada paspauskite **OK (Gerai)** tai pozicijai sukonfigūruoti.
7. Pasirinkite parinktį.

Parinktis	Aprašas
„ <b>Select</b> “ (Pasirinkti)	Parenkamas atitinkamas kanalas arba laukimo trukmė.
„ <b>Number of measurements</b> “ (Matavimų skaičius)	Nustatomas kanalo matavimų skaičius.
„ <b>Waiting time</b> “ (Laukimo trukmė)	Nustatoma laukimo trukmė pasirinkto kanalo atžvilgiu.

8. Paspauskite **OK (Gerai)** pakeitimams išsaugoti.

## 6.6 Tirpalų ir mėginio vamzdelių prijungimas

### ⚠ ATSAUGIAI



Sąlyčio su cheminėmis medžiagomis pavojus. Vykdykite laboratorijos saugos procedūras ir dėvėkite visas asmeninės saugos priemones, tinkančias naudojamiems chemikalams. Saugos protokolai nurodyti galiojančiuose saugos duomenų lapuose (MSDS / SDS).

### ⚠ ATSAUGIAI



Sąlyčio su cheminėmis medžiagomis pavojus. Chemikalus ir atliekas išmeskite pagal vietos, regiono ir nacionalines taisykles.



Gaisro pavojus. Šis gaminys nėra skirtas naudoti su degiais skysčiais.

Reagentų talpyklose naudojami analizatoriai. Žr. [Paveikslėlis 18](#) Puslapyje 478. 1 etaloninio tirpalo ir 2 etaloninio tirpalo talpyklas bei dejonizuotą vandenį teikia naudotojas. Daugiau talpyklų galima įsigyti iš gamintojo.

Sumontuokite talpyklas

- kaip galima arčiau analizatoriaus
- 1 m žemiau analizatoriaus apačios.

Kaip montuoti talpyklas žr. [Paveikslėlis 18](#) Puslapyje 478.

Reagentus ir tirpalus įsigyja naudotojas. Naudokite tik sertifikuotos bendrovės tiekiamus reagentus arba naudokite gamintojo paskirtus reagentus. Reagentus taip pat gali paruošti naudotojas. Žr. atitinkamo modelio metodų ir reagentų dokumentą, kuriuos rasite gamintojo svetainėje.

Vamzdeliai įrengiami gamykloje. Skaitykite ant vamzdelių esančias etiketes, kad rastumėte tinkamą jungtį. Žr. atitinkamo modelio tinkamų reagentų, tirpalų ir standartų metodų ir reagentų dokumentą, kurį rasite gamintojo svetainėje.

1. Po to, kai atliekami komponentų testai, sumontuokite „CLEAN“ (valymo tirpalo), „REF1“ (etaloninio 1 tirpalo) ir „REF2“ (etaloninio 2 tirpalo) vamzdelius atitinkamose talpyklose. Žr. [Paveikslėlis 18](#) Puslapyje 478.
2. Kiekvieną spalva užkoduotą reagento vamzdelį sumontuokite toje reagento talpykloje, kurios etiketėje yra ta pati spalva.
3. Mėginio šaltinį (arba „Moduplex“ pulto ar filtro pulto mėginio išvadą) sujunkite su analizatoriaus mėginio įvado vamzdeliu. Žr. [Paveikslėlis 18](#) Puslapyje 478.
4. Paspauskite pagrindinio meniu piktogramą ir pasirinkite „**Devices**“ (**Prietaisai**).
5. Pasirinkite **EZ2700sc**.
6. Slinkite žemyn iki ekrano apačios, tada pasirinkite „**Device menu**“ (**Prietaiso meniu**).
7. Pasirinkite „**Maintenance**“ (**Techninė priežiūra**) > „**Start priming**“ (**Pradėti užpildymą**) > „**Prime all**“ (**Užpildyti viską**).

## 6.7 Tikrinimas prieš pradinę paleistį

Atlikite tikrinimą, kad įsitikintumėte, ar matavimai patenka į leidžiamųjų nuokrypių diapazoną. Daugiau informacijos rasite išplėstinėje naudotojo vadovo versijoje, pasiekiamoje internetu.

1. Paspauskite pagrindinio meniu piktogramą ir pasirinkite „**Devices**“ (**Prietaisai**).
2. Pasirinkite **EZ2700sc**.
3. Slinkite žemyn iki ekrano apačios, tada pasirinkite „**Device menu**“ (**Prietaiso meniu**).
4. Norėdami pradėti tikrinimą, pasirinkite „**Calibration**“ (**Kalibravimas**) > „**Validation**“ (**Tikrinimas**) > „**Start validation**“ (**Pradėti tikrinimą**).  
Tikrinant matuojamas dejonizuotas vanduo etaloniniame 2 buteliuke.
5. Kad būtų parodyti rezultatai, pasirinkite parinktį:
  - „**Calibration**“ (**Kalibravimas**) > „**Validation**“ (**Tikrinimas**) > „**Validation history**“ (**Tikrinimo istorija**)
  - „**Diagnostics**“ (**Diagnostika**) > „**Historical data**“ (**Istoriniai duomenys**) > „**Validation**“ (**Tikrinimas**)

## 6.8 Analizatoriaus paleidimas

Norėdami paleisti analizatorių:

1. Paspauskite pagrindinio meniu piktogramą ir pasirinkite „**Devices**“ (**Prietaisai**).
2. Pasirinkite **EZ2700sc**.
3. Slinkite žemyn iki ekrano apačios, tada pasirinkite „**Device menu**“ (**Prietaiso meniu**).
4. Pasirinkite „**Maintenance**“ (**Techninė priežiūra**) > „**Start operational mode**“ (**Paleisti darbinį režimą**).

# Оглавление

- |   |                               |             |   |                  |             |
|---|-------------------------------|-------------|---|------------------|-------------|
| 1 | Дополнительная информация     | на стр. 306 | 4 | Общая информация | на стр. 308 |
| 2 | Основная информация о приборе | на стр. 306 | 5 | Установка        | на стр. 310 |
| 3 | Характеристики                | на стр. 307 | 6 | Начало работы    | на стр. 320 |

## Раздел 1 Дополнительная информация

Базовое руководство пользователя содержит информацию, достаточную для ввода в эксплуатацию. Расширенное руководство пользователя доступно в Интернете и содержит дополнительную информацию.

### ▲ ОПАСНОСТЬ



Многочисленные угрозы! Более подробная информация приведена в отдельных разделах расширенного руководства по эксплуатации, приведенного ниже.

- Пользовательский интерфейс и навигация
- Эксплуатация
- Обслуживание
- Поиск и устранение неисправностей
- Списки запасных частей

Отсканируйте следующие QR-коды, чтобы перейти к расширенному руководству пользователя.



Европейские языки



Американские и азиатские языки

## Раздел 2 Основная информация о приборе

Анализатор Nach EZ2700sc представляет собой онлайн-анализатор, который измеряет один параметр в пробах воды промышленного и природоохранного назначения. См. [Рисунок 1](#) на стр. 439, [Рисунок 2](#) на стр. 444 и [Рисунок 3](#) на стр. 448.

Анализатор представляет собой колориметрический онлайн-анализатор для общего анализа воды (например, анализ нитратов, фосфатов). Анализатор оснащен опциями удаленного запуска, автоматических процедур подтверждения, калибровки и очистки, а также Modbus.

Проба воды поступает в анализатор через робоотборную трубку. Анализатор применяет насосы, клапаны и шприцы для перемещения пробы и реагентов в измерительную ячейку на аналитической панели. Когда анализ в сосуде для анализа завершен, анализатор удаляет пробу через дренажную линию. Результаты анализа отображаются на дисплее контроллера SC4500. Контроллер SC4500 сохраняет данные анализатора (журнал данных, событий, настроек и обслуживания). Используйте контроллер SC4500 для эксплуатации и настройки анализатора.

Чтобы увеличить количество потоков проб (каналов) для измерения анализатором (2, 4 или 8), приобретите многопоточную панель Moduplex вместе с анализатором.

Для подготовки пробы (фильтрация, отстаивание) приобретите панель фильтрации EZ9010, EZ9020, EZ9150, EZ9200 или EZ9250 вместе с анализатором.

## Раздел 3 Характеристики

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Характеристика	Подробная информация
Размеры (Ш x В x Г)	460 x 688 x 340 мм
Корпус	IP44; ABS, PMMA и сталь с покрытием
Дисплей	IP66, цветной TFT-дисплей 3,5 дюйма с емкостной сенсорной панелью
Масса	40 кг
Требования к электропитанию	100 - 240 В перем. тока $\pm 10\%$ , 50/60 Гц
Потребляемая мощность	Максимум 240 ВА
Высота	Максимум 2000 м
Категория устойчивости к перенапряжениям	II
Условия окружающей среды	Только для использования в помещении
Класс загрязнения	2
Рабочая температура	10 - 30 °C (50 - 86 °F), относительная влажность 5 - 95%, без конденсации, без коррозии
Температура хранения	От -20 до 60 °C, относительная влажность 95%, без конденсации
Входы проб	Один
Давление пробы	Посредством внешней переливной камеры (открыто до атмосферного давления)
Расход пробы	От 100 до 300 мл/мин
Температура пробы	От 10 до 30 °C
Качество пробы	< 100 мкм частиц, < 0,1 г/л максимум Мутность < 50 NTU
Продувка воздухом для агрессивных сред	0,2 бар (20 кПа); сухой и чистый воздух
Слив	Атмосферное давление, вентиляция, мин. $\varnothing$ 32 мм
Заземление	Сухой и чистый штырь заземления с низким сопротивлением (< 1 Ом), кабель заземления > 2,5 мм <sup>2</sup> (13 AWG)
Аналоговые выходы	Максимум восемь аналоговых выходов 0 - 20 мА (или 4 - 20 мА) <i>Примечание: Аналоговые выходы обеспечивают электропитание контура. Электропитание не подается на контакты системы SCADA или ПЛК.</i>
Цифровые входы	Семь цифровых входов: два цифровых входа для дистанционного запуска. Остальные цифровые входы предназначены для использования в будущем.
Цифровые выходы	Четыре цифровых выхода под напряжением для клапанов и насосов панели EZ9150; восемь цифровых выходов под напряжением для клапанов панели ModuPlex; 24 В пост. тока, 500 мА.
Реле	Пять беспотенциальных контактов (FCT), максимальная нагрузка 24 В пост. тока, 0,5 А (резистивная нагрузка)

RU

Характеристика	Подробная информация
Соединения Ethernet	Ethernet-соединение Claros и разъем Modbus TCP/IP Ethernet; версия LAN; 10/100 Мбит/с, Profinet или Ethernet IP
Связь RS485	Profibus DP или Modbus RTU
Сертификации	Сертификация CE, ETL в соответствии со стандартами безопасности UL и CSA, UKCA
Гарантия	1 год (ЕС: 2 года)

## Раздел 4 Общая информация

Ни при каких обстоятельствах производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате ненадлежащего использования прибора или несоблюдения инструкций, приведенных в руководстве. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в руководство или описанную в нем продукцию без извещений и обязательств. Обновленные версии руководства можно найти на веб-сайте производителя.

### 4.1 Информация по безопасности

Изготовитель не несет ответственности за любые повреждения, вызванные неправильным применением или использованием изделия, включая, без ограничения, прямой, неумышленный или косвенный ущерб, и снимает с себя ответственность за подобные повреждения в максимальной степени, допускаемой действующим законодательством. Пользователь несет исключительную ответственность за выявление критических рисков в работе и установку соответствующих механизмов для защиты обследуемой среды в ходе возможных неполадок оборудования.

Внимательно прочтите все руководство пользователя, прежде чем распаковывать, устанавливать или вводить в эксплуатацию оборудование. Соблюдайте все указания и предупреждения относительно безопасности. Их несоблюдение может привести к серьезной травме обслуживающего персонала или выходу из строя оборудования.

Для обеспечения степени защиты, гарантированной для данного оборудования, его не следует эксплуатировать каким-либо иным способом, кроме того, который указан производителем оборудования. Используйте и устанавливайте данное оборудование строго в соответствии с требованиями данного руководства.

#### 4.1.1 Информация о потенциальных опасностях

##### **▲ ОПАСНОСТЬ**

Указывает на потенциально или непосредственно опасные ситуации, которые, если их не избежать, приведут к смерти или серьезным травмам.

##### **▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Указывает на потенциально или непосредственно опасные ситуации, которые, если их не избежать, могут привести к смерти или серьезным травмам.

##### **▲ ОСТОРОЖНО**

Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к травмам малой и средней тяжести.







##### **УВЕДОМЛЕНИЕ**

Указывает на ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к повреждению оборудования. Информация, на которую следует обратить особое внимание.

<sup>2</sup> Информацию о конфигурации Ethernet и Modbus см. в документации к контроллеру SC4500.


## 4.1.2 Экеткетки с предупреждающими надписями

Прочитайте все наклейки и ярлыки на корпусе прибора. При несоблюдении указанных на них требований существует опасность получения травм и повреждений прибора. Нанесенный на корпус прибора предупредительный символ вместе с предостережением об опасности или осторожности содержится в руководстве пользователя.




	Это символ предупреждения об опасности. Для предотвращения возможной травмы соблюдайте все меры по технике безопасности, отображаемые с настоящим символом. Если символ на приборе, см. руководство по эксплуатации или информацию по технике безопасности.
	Этот символ указывает на наличие химической опасности и указывает на то, что только лица, имеющие необходимую квалификацию и опыт по работе с химикатами, допускаются к выполнению операций с химикатами и обслуживанию связанных с оборудованием систем подачи химикатов.
	Этот символ указывает на опасность поражения электрическим током и/или на возможность получения смертельной электротравмы.
	Этот символ указывает на наличие устройств, чувствительных к электростатическому разряду, и указывает, что следует быть очень внимательными во избежание их повреждения.
	Этот символ указывает, что отмеченный элемент должен иметь защитное заземление. Если в комплект поставки прибора не входит электровилка с заземлением (на шнуре питания), следует подключить заземление к клемме защитного заземления.
	Возможен запрет на утилизацию электрооборудования, отмеченного этим символом, в европейских домашних и общественных системах утилизации. Пользователь может бесплатно вернуть старое или неработающее оборудование производителю для утилизации.

RU

## 4.1.3 Химическая и биологическая безопасность

<b>⚠ ОПАСНОСТЬ</b>	
	Химическая или биологическая опасность. Если этот прибор используется для мониторинга процесса производства или подачи химических веществ, для которых необходимо соблюдать нормативные ограничения и требования по мониторингу, связанные со здоровьем населения, общественной безопасностью, производством пищевых продуктов и напитков, то на пользователя прибора возлагается ответственность за ознакомление с этими требованиями и их выполнение, а также за обеспечение наличия и установки необходимых и достаточных механизмов для соответствия применимым правилам в случае сбоя в работе прибора.

## 4.2 Иконки, используемые в иллюстрациях

			
Детали, поставляемые производителем	Детали, поставляемые пользователем	Смотрите	Выполните шаги в обратном порядке

Требуется участие двух человек	Слушайте	Только при помощи пальцев	Не используйте инструменты	Не прикасаться

### 4.3 Назначение

Анализаторы Nach серии EZ предназначены для использования лицами, которым постоянно необходимо измерять параметры качества воды в пробах в промышленных и экологических целях. Анализаторы Nach серии EZ не обрабатывают и не изменяют воду, а также не используются для управления процедурами.

### 4.4 Компоненты прибора

Убедитесь в том, что все компоненты в наличии. См. [Рисунок 4](#) на стр. 452. Если какой-либо элемент отсутствует или поврежден, немедленно свяжитесь с производителем или торговым представителем.

## Раздел 5 Установка

### ▲ ОПАСНОСТЬ



Различные опасности. Работы, описываемые в данном разделе, должны выполняться только квалифицированным персоналом.

### 5.1 Инструкции по установке

#### ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Опасность возникновения пожара. Пользователь должен гарантировать соблюдение достаточных мер предосторожности в случаях, когда оборудование используется с огнеопасными жидкостями. Необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности и требования к безопасности. Сюда входят контроль за проливанием и протечками, должная вентиляция, постоянный присмотр за используемым оборудованием, контроль за тем, чтобы включенный прибор никогда не оставался без присмотра (перечисленные меры не являются исчерпывающими).

#### ▲ ОСТОРОЖНО



Опасность вредного химического воздействия. Необходимо соблюдать правила техники безопасности и использовать индивидуальные средства защиты, соответствующие используемым химикатам. При составлении протоколов по технике безопасности воспользуйтесь действующими паспортами безопасности / паспортами безопасности материалов (MSDS/SDS).

#### ▲ ОСТОРОЖНО



Опасность вредного химического воздействия. Утилизируйте химические вещества и отходы в соответствии с местными, региональными и общегосударственными правилами и законами.

- Анализатор следует устанавливать в помещении на безопасном участке.
- Установите анализатор в среде, защищенной от коррозионных жидкостей.
- Установите анализатор в чистом, сухом, хорошо проветриваемом месте с контролем температуры.
- Установите анализатор максимально близко к точке отбора пробы.
- Не устанавливайте анализатор под прямыми солнечными лучами или вблизи источников тепла.

- Убедитесь, что имеется достаточный зазор для трубных и электрических соединений.
- Оставьте достаточно места перед анализатором, чтобы открывать дверцу анализатора. См. [Размеры анализатора](#) на стр. 311.
- Убедитесь, что окружающие условия соответствуют рабочим спецификациям. См. [Характеристики](#) на стр. 307.

Несмотря на то, что анализатор не предназначен для использования с легковоспламеняющимися пробами, некоторые анализаторы EZ используют легковоспламеняющиеся реагенты. Дополнительную информацию о реагентах, используемых в анализаторе, см. в листе методов и реагентов для соответствующей модели серии EZ. Если в анализаторе используются легковоспламеняющиеся реагенты, соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Держите анализатор вдали от источников тепла, искр и открытого пламени.
- Не ешьте, не пейте и не курите рядом с анализатором.
- Используйте местную систему вытяжной вентиляции.
- Используйте искрозащитные и взрывозащитные приборы и систему освещения.
- Не допускайте возникновения электростатических разрядов. См. [Замечания, касающиеся электростатического разряда \(ESD\)](#) на стр. 312.
- Перед использованием полностью очистите и высушите прибор.
- Перед перерывами и по окончании рабочего периода мойте руки.
- Снимите загрязненную одежду. Постирать одежду перед повторным использованием.
- С этими жидкостями необходимо обращаться в соответствии с требованиями местного законодательства относительно допустимых пределов воздействия.

## 5.2 Размеры анализатора

Размеры анализатора см. на [Рисунок 5](#) на стр. 454.

## 5.3 Механическая установка

### 5.3.1 Монтаж прибора на стену

#### ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Риск получения травмы. Убедитесь, что стена, на которой монтируется оборудование, способна выдерживать вес, который превышает вес оборудования в 4 раза.

#### ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Риск получения травмы. Приборы или компоненты тяжелые. Для установки или перемещения используйте помощь.

#### ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Риск получения травмы. Тяжелый предмет. Для безопасной эксплуатации прибор необходимо надежно закрепить на стене, столе или полу.

С помощью монтажных кронштейнов установите прибор ровно в вертикальном положении на плоской вертикальной поверхности стены. См. [Рисунок 6](#) на стр. 456.

Устанавливайте прибор в таком месте, где пользователь сможет легко отсоединить его от источника питания.

Убедитесь, что под анализатором имеется достаточный зазор для установки бутылок.

Крепежные элементы предоставляет пользователь. Убедитесь, что настенный крепежный элемент имеет достаточную несущую способность (приблизительно 160 кг). Монтажные приспособления должны соответствовать типу стены.

### 5.3.2 Откройте дверцу анализатора

Используйте прилагаемый ключ для разблокировки двух замков сбоку анализатора. См. [Рисунок 7](#) на стр. 456. Перед началом работы обязательно закройте дверцу, чтобы обеспечить требуемую степень защиты корпуса и категорию безопасности.

## 5.4 Электрические подключения

### ▲ ОПАСНОСТЬ



Опасность смертельного поражения электрическим током. Всегда отключайте питание прибора, прежде чем выполнять электрические подключения.

### 5.4.1 Замечания, касающиеся электростатического разряда (ESD)

### УВЕДОМЛЕНИЕ



Возможность повреждения прибора. Чувствительные электронные компоненты могут быть повреждены статическим электричеством, что приведет к ухудшению рабочих характеристик прибора или его последующей поломке.

Выполните следующие шаги процедуры для предотвращения повреждения прибора электростатическим разрядом:

- Коснитесь заземленной металлической поверхности, например, шасси прибора, металлического трубопровода или трубы, чтобы снять электростатический заряд с тела.
- Избегайте чрезмерных перемещений. Транспортировку чувствительных к электростатическим разрядам компонентов следует производить в антистатических контейнерах или упаковках.
- Следует носить антистатический браслет, соединенный проводом с землей.
- Следует работать в электростатически безопасном окружении с антистатическими напольными и настольными ковриками.

### 5.4.2 Электрический доступ

Проложите кабели внешних устройств через кабельные сальники. См. [Рисунок 8](#) на стр. 458. Неиспользуемые кабельные сальники следует закрывать заглушками.

[Рисунок 9](#) на стр. 461 отображает компоненты внутри анализатора. Выключатель питания автоматически отключает сетевое питание от силовой линии переменного тока в случае перегрузки по току (короткого замыкания) или избыточного напряжения.

### 5.4.3 Подключение к внешним устройствам

Подключите внешние устройства, которые будут использоваться с анализатором, к сигнальным и управляющим клеммам анализатора. См. [Рисунок 10](#) на стр. 466 и [Таблица 1](#) на стр. 312.

**Таблица 1 Сигнальные и управляющие клеммы — описание**

Контакт	Описание
АО1–АО8 (P101)	Восемь аналоговых выходов для управления внешними устройствами. Для получения дополнительной информации см. расширенную онлайн-версию руководства пользователя.
FCT1–FCT5 (P102)	Пять реле (беспотенциальные контакты) Максимальная нагрузка составляет 24 В пост. тока, 0,5 А. <ul style="list-style-type: none"><li>• FCT1 — сигнал неисправности</li><li>• FCT2 — сигнал об обслуживании</li><li>• FCT3 — анализатор готов</li><li>• FCT4 и FCT5 — для использования в будущем</li></ul>

**Таблица 1 Сигнальные и управляющие клеммы — описание (продолжение)**

Контакт	Описание
DI1–DI7 (P103)	<p>Семь цифровых входов для дистанционного управления анализатором<sup>5</sup>Подключите цифровые входы к внешнему беспотенциальному контакту (24 В пост. тока), чтобы анализатор запустил измерение для канала.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DI1 — удаленный запуск для канала 1</li> <li>• DI2 — удаленный запуск для канала 2</li> <li>• DI3 - DI7 — для использования в будущем</li> </ul>
FB1 - FB4 (P104)	<p>Разъемы Profibus DP или Modbus RTU (RS485)</p> <p><b>Profibus DP:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FB1 — A1 (вход)</li> <li>• FB2 — A2 (выход)</li> <li>• FB3 — B1 (вход)</li> <li>• FB4 — B2 (выход)</li> <li>• SHL — экран</li> </ul> <p><b>Modbus RTU:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FB1 — D (+)</li> <li>• FB2 — D (-)</li> <li>• FB3 — не используется</li> <li>• FB4 — не используется</li> <li>• SHL — экран</li> </ul> <p>Инструкции для настройки Modbus и меток телеграммы см. в документации к контроллеру SC4500.</p>
24 В пост. тока / 1 А (P105)	<p>Источник питания 24 В пост. тока для блоков фильтрации EZ9010 и EZ9020</p>
STR1–STR8 (P106)	<p>Восемь цифровых выходов для дополнительной панели Moduplex. Подключите оголенные провода клапана каждого канала на панели Moduplex к соответствующим разъемам STR.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• STR1 — канал 1</li> <li>• STR2 — канал 2</li> <li>• ...</li> <li>• STR8 — канал 8</li> </ul>

<sup>5</sup> Если анализатор находится в режиме обслуживания, дистанционное управление отключено.

**Таблица 1 Сигнальные и управляющие клеммы — описание (продолжение)**

Контакт	Описание
EXT9 - EXT12 (P107)	<p>Четыре цифровых выхода для дополнительной панели фильтрации EZ9150. Подсоедините электрические клапаны и насос на панели фильтрации EZ9150 к разъемам EXT.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EXT9 — промывочный клапан</li> <li>• EXT10 — клапан обратной промывки</li> <li>• EXT11 — дренажный клапан перелива</li> <li>• EXT12 — насос фильтрации</li> </ul>
D01- D06 (P108 и P109)	<p>Шесть выходов пневматических клапанов для панели EZ9150.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• D01 — впускной пробоотборный клапан</li> <li>• D02 — дренажный клапан перелива</li> <li>• D03 — клапан канала 1</li> <li>• D04 — клапан канала 2</li> <li>• D05 — клапан канала 3</li> <li>• D06 — клапан канала 4</li> </ul>

#### 5.4.4 Подключение к сети переменного тока

### ▲ ОПАСНОСТЬ



Опасность поражения электрическим током и возникновения пожара. Шнур электропитания и вилка без фиксации положения, входящие в комплект поставки, должны соответствовать действующим национальным нормативам.


- Убедитесь, что линия питания оснащена автоматом защиты цепи с достаточной допустимой нагрузкой по току.
- Убедитесь, что рядом с анализатором установлен автоматический выключатель или аварийный переключатель, чтобы при необходимости можно было немедленно отключить анализатор от источника питания.
- Подключите оборудование в соответствии с местными, региональными и национальными электротехническими нормативами.
- Вставьте прилагаемый кабель питания в кабельный сальник, расположенный на боковой стороне анализатора.
- Затяните кабельный сальник, чтобы надежно закрепить кабель питания и обеспечить требуемую степень защиты корпуса.

Подключите анализатор к источнику переменного тока с помощью прилагаемого кабеля питания переменного тока. См. [Таблица 2](#) на стр. 314 и [Рисунок 11](#) на стр. 468.

### УВЕДОМЛЕНИЕ

Не устанавливайте переключатель питания в положение включения. Выполните все электрические и трубные соединения перед запуском, в противном случае анализатор может быть поврежден.

**Таблица 2 Сведения о проводке - электропитание переменного тока**

Клемма	Описание	Цвет кабеля - Северная Америка и Канада	Цвет кабеля-ЕС
L	Напряжение / линия (L)	Черный (1)	Коричневый
N	Нейтральный провод (N)	Белый (2)	Синий
	Защитное заземление (PE)	Зеленый с желтой полоской	Зеленый с желтой полоской

## 5.5 Монтаж трубок

### 5.5.1 Инструкции по использованию линии подачи пробы

#### ▲ ОСТОРОЖНО



Опасность возникновения пожара. Этот прибор не предназначен для использования с легковоспламеняющимися пробами.

Для оптимальной работы прибора необходимо выбрать правильное, репрезентативное место отбора пробы. Проба должна быть репрезентативной для всей системы.

- Убедитесь, что поток отбора проб выше потока к анализатору.
- Убедитесь, что линия отбора проб находится под атмосферным давлением, если анализатор использует перистальтический насос для перемещения пробы в сосуд для анализа.
- Убедитесь, что линия отбора проб собирает пробу от малой емкости перелива рядом с анализатором.
- Используйте линию подачи пробы, которая входит в комплект поставки. Не изменяйте длину линии подачи пробы.

Пробу в емкости перелива необходимо постоянно обновлять. Если размер твердых частиц в пробе слишком большой, рекомендуется также обеспечить фильтрацию пробы.

### 5.5.2 Инструкции по установке дренажных линий

#### ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Опасность возникновения пожара. Пользователь должен гарантировать соблюдение достаточных мер предосторожности в случаях, когда оборудование используется с огнеопасными жидкостями. Необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности и требования к безопасности. Сюда входят контроль за проливанием и протечками, должная вентиляция, постоянный присмотр за используемым оборудованием, контроль за тем, чтобы включенный прибор никогда не оставался без присмотра (перечисленные меры не являются исчерпывающими).

#### ▲ ОСТОРОЖНО



Опасность вредного химического воздействия. Утилизируйте химические вещества и отходы в соответствии с местными, региональными и общегосударственными правилами и законами.

#### УВЕДОМЛЕНИЕ

Не соединяйте дренажные линии с другими линиями, поскольку может возникнуть противодействие или произойти повреждение анализатора. Убедитесь, что дренажные линии сообщаются с воздухом.

#### УВЕДОМЛЕНИЕ

Во избежание повреждения анализатора и возникновения противодействия убедитесь, что анализатор расположен выше используемых дренажных систем, и что дренажная линия имеет постоянный уклон вниз. Установите дренажные линии с вертикальным уклоном не менее 2,54 см (1 дюйм) на 0,3 м (1 фут) длины труб.

Анализатор использует дренажные трубы, чтобы сливать пробы и реагенты после выполнения анализа. Чтобы обеспечить полное удаление жидкостей из прибора, необходимо правильно установить дренажные линии. Неправильная установка может привести к тому, что жидкость попадет обратно в прибор и повредит его. Достаточно обеспечить слив дренажной линии в отверстие в полу или в раковину. Рекомендуемый наружный диаметр для дренажной трубы – 32 мм. См. [Рисунок 12](#) на стр. 471.

- Дренажные линии должны быть как можно короче.
- Убедитесь, что слив расположен ниже анализатора.
- Убедитесь, что на всем своем протяжении дренажные линии находятся под наклоном.

- Убедитесь, что на дренажных линиях отсутствуют резкие изгибы и заземления.
- Убедитесь, что дренажные линии сообщаются с воздухом и не находятся под давлением.
- Убедитесь, что дренажные линии закрыты от окружающей среды в помещении установки.
- Не перекрывайте дренажную линию и не погружайте в жидкую среду.

Также рекомендуется организовать подключение к водопроводу рядом с анализатором, чтобы регулярно промывать дренажную систему и дренажные трубы чистой водой для профилактики засорения в результате кристаллизации.

Дополнительную информацию о реагентах, используемых в анализаторе, см. в листе методов и реагентов для соответствующей модели серии EZ. Если в анализаторе используются легковоспламеняющиеся реагенты, соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Не подключайте дренажную линию к сливу в полу.
- Утилизируйте отходы в соответствии с местным, региональным и государственным законодательством.

### 5.5.3 Инструкции по установке вентиляционной линии

#### ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Опасность возникновения пожара. Пользователь должен гарантировать соблюдение достаточных мер предосторожности в случаях, когда оборудование используется с огнеопасными жидкостями. Необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности и требования к безопасности. Сюда входят контроль за проливанием и протечками, должная вентиляция, постоянный присмотр за используемым оборудованием, контроль за тем, чтобы включенный прибор никогда не оставался без присмотра (перечисленные меры не являются исчерпывающими).

#### ▲ ОСТОРОЖНО



Опасность вредного химического воздействия. Утилизируйте химические вещества и отходы в соответствии с местными, региональными и общегосударственными правилами и законами.

#### УВЕДОМЛЕНИЕ

Не соединяйте вентиляционную линию (порт выхода отработавших газов) с другими линиями, поскольку может возникнуть противодавление или произойти повреждение анализатора. Убедитесь, что вентиляционная линия сообщается с воздухом за пределами здания.

#### УВЕДОМЛЕНИЕ

Во избежание повреждения анализатора и возникновения противодавления убедитесь, что анализатор расположен выше используемых вентиляционных систем, и что вентиляционная линия имеет постоянный уклон вниз. Установите вентиляционную линию с вертикальным уклоном не менее 2,54 см (1 дюйм) на 0,3 м (1 фут) длины труб.

Анализатор использует вентиляционную линию для поддержания атмосферного давления в сосуде для анализа. Правильная установка вентиляционной линии важна для того, чтобы во время работы насоса жидкость не попала из вентиляционной линии в сосуд для анализа. Неправильная установка может привести к тому, что газ попадет обратно в анализатор и повредит его. Рекомендуемый наружный диаметр магистральной трубы вентиляционной линии составляет 32 мм. См. [Рисунок 12](#) на стр. 471.

- Вентиляционная линия должна быть как можно короче.
- Убедитесь, что на всем своем протяжении вентиляционная линия находится под наклоном.
- Убедитесь, что на вентиляционной линии отсутствует резкий изгиб и заземления.
- Убедитесь, что вентиляционная линия закрыта от окружающей среды в помещении установки и находится под нулевым давлением.
- Убедитесь, что вентиляционная линия всегда выше слива.
- Не перекрывайте вентиляционную линию и не погружайте в жидкую среду.

Если в анализаторе используются легковоспламеняющиеся реагенты, соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Не подключайте вентиляционную линию к сливу в полу.
- Утилизируйте отходы в соответствии с местным, региональным и государственным законодательством.

#### 5.5.4 Подключение трубок к анализатору для проверки компонентов

### ▲ ОСТОРОЖНО




Опасность возникновения пожара. Это изделие не предназначено для работы с легковоспламеняющимися жидкостями.

RU


Перед вводом в эксплуатацию анализатора со всеми реагентами необходимо провести проверку компонентов с деионизированной водой. См. иллюстрации и раздел [Выполнение проверки компонентов](#) на стр. 321.

1. Установите четыре трубки запорных клапанов, как показано на иллюстрированной инструкции к шагу 1.
  - a. Нажмите черную кнопку, затем вставьте трубку в клапан.
  - b. Отпустите кнопку, когда трубка будет установлена правильно.
2. Убедитесь, что дренажная трубка правильно установлена в сосуде для проб. Следуйте инструкциям на представленном ниже рисунке 2.
3. Убедитесь, что трубка биореактора правильно установлена в сосуде биореактора. Следуйте инструкциям на представленном ниже рисунке 3.
4. Подсоедините все трубки анализатора к большой бутылке с деионизированной водой, чтобы выполнить проверку компонентов. Следуйте инструкциям на представленном ниже рисунке 3. Трубки устанавливаются на заводе-изготовителе.

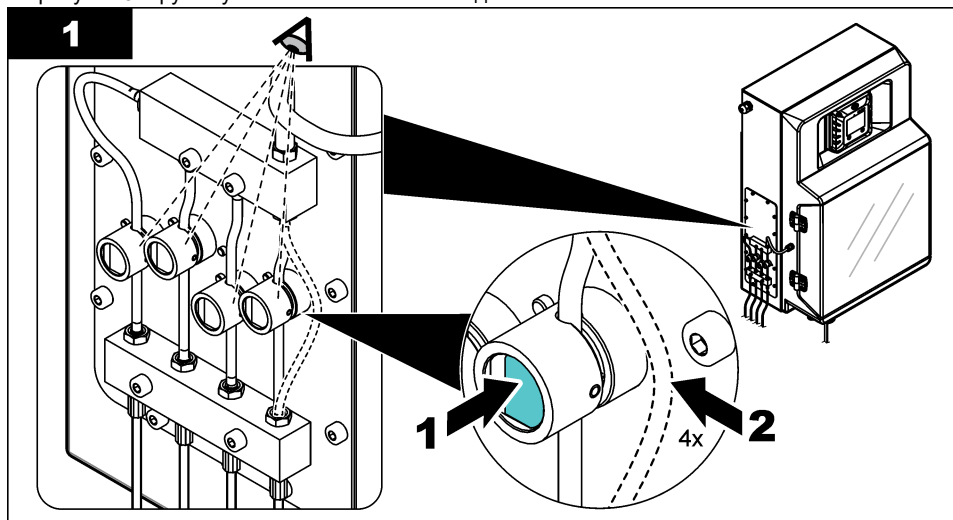


2

RU

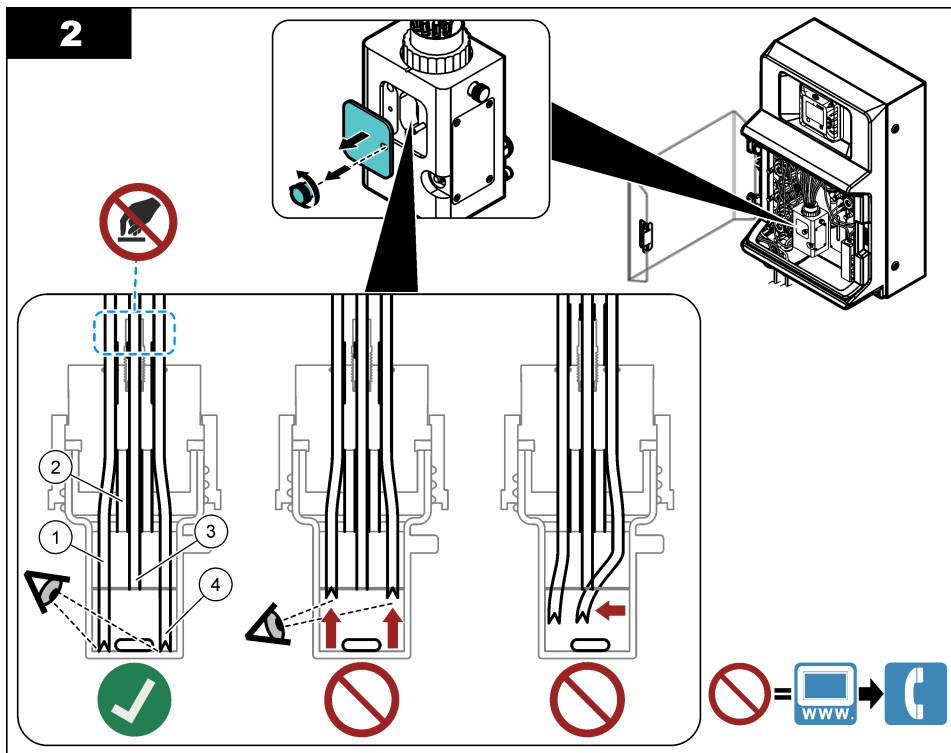

1 Дренажная трубка	3 Пробоотборный трубопровод
2 Трубки для реагентов и вентиляционная трубка (верхняя трубка)	4 Трубка биореактора

3

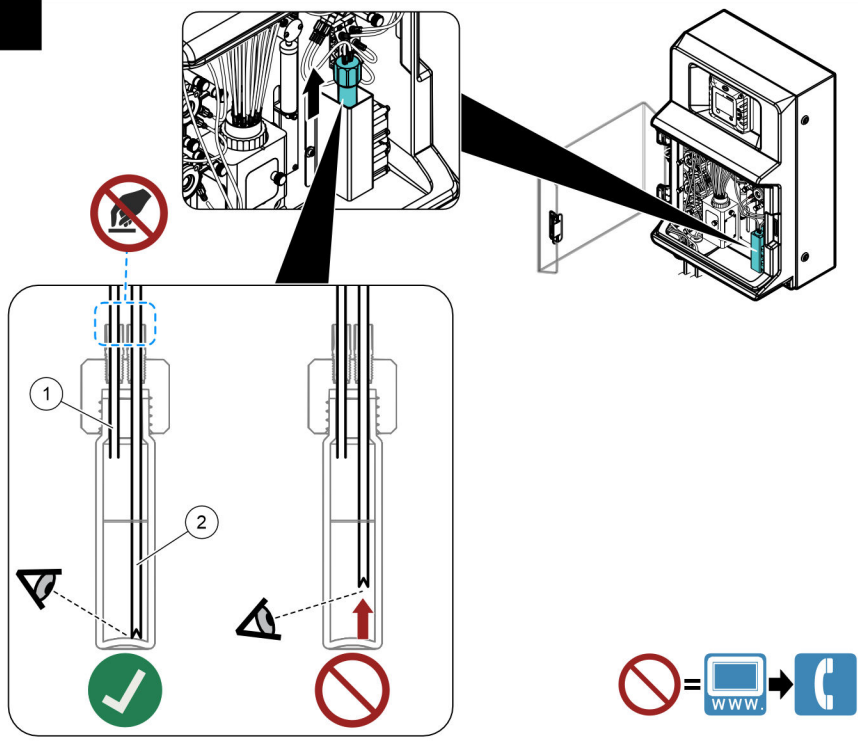


RU

1 Вентиляционная трубка

2 Трубка биореактора

4

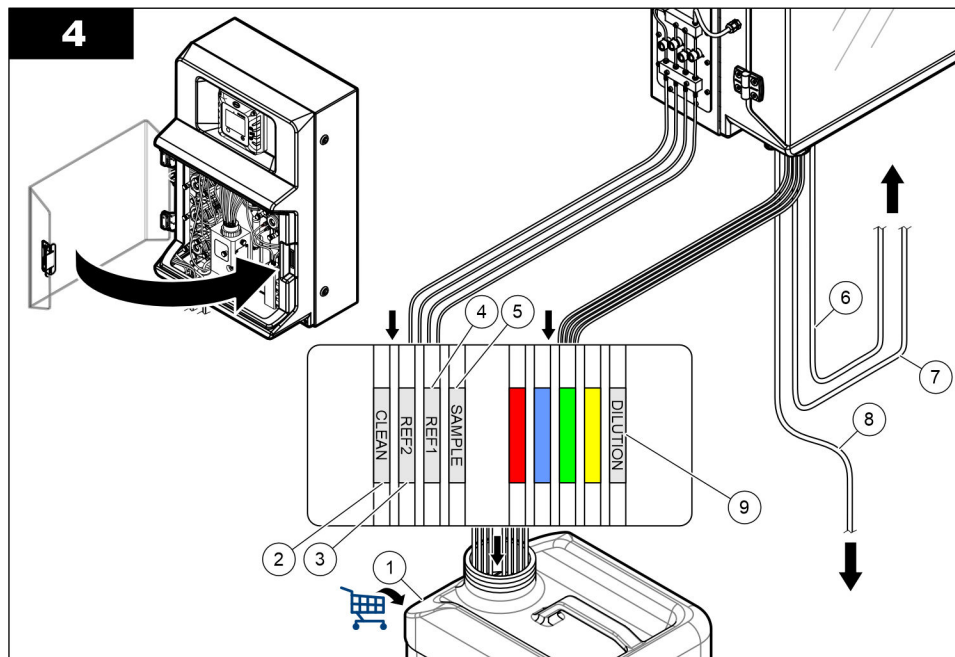

1 Деионизированная вода	4 Трубка с эталонным раствором 1 (REF1)	7 Вентиляционный биореактор
2 Трубка с раствором для очистки	5 Трубка входа пробы	8 Дренажная трубка
3 Трубка с эталонным раствором 2 (REF2)	6 Вентиляционная трубка	9 Трубка для разбавления и микронасоса реагента

## Раздел 6 Начало работы

### 6.1 Первоначальный запуск

**Примечание:** Перед запуском убедитесь, что монтаж, прокладка труб и электропроводки полностью завершены. См. [Установка](#) на стр. 310.

При первом включении анализатора виртуальный ассистент при запуске поможет выполнить первые этапы по настройке. Выполните все описанные ниже этапы, чтобы убедиться в правильной работе анализатора.

**Примечание:** Убедитесь, что используются правильные реагенты для выбранного диапазона измерений. Для получения дополнительной информации см. расширенную онлайн-версию руководства пользователя.

1. Откройте дверцу анализатора. См. [Откройте дверцу анализатора](#) на стр. 312.
2. Установите переключатель питания во включенное положение. См. [Рисунок 9](#) на стр. 461.
3. Закройте дверцу анализатора с помощью ключа, который входит в комплект поставки.
4. Подождите, пока завершится процедура инициализации.
5. Следуйте инструкциям на дисплее, чтобы выбрать язык, часовой пояс, дату и время. Для установки других настроек см. документацию к контроллеру SC4500.
6. Коснитесь дисплея, чтобы открыть меню **EZ2700sc**.
7. Выберите **Меню устройства**, чтобы запустить виртуального ассистента при запуске.

Появится экран приветствия.

8. Выполните этапы, отображаемые на дисплее, чтобы выбрать соответствующий диапазон измерений. Нажмите **ОК**.
9. Если установлен блок фильтрации, выберите **Вкл** В противном случае выберите **Выкл**
10. Выберите количество каналов для анализатора. Нажмите **ОК**.
11. Если конфигурация, показанная на странице сводки, верна, нажмите **ОК**.  
Появится главное меню **EZ2700sc**.
12. Продолжите проверку компонентов. См. [Выполнение проверки компонентов](#) на стр. 321.

## 6.2 Выполнение проверки компонентов

### ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Опасность защемления. Движущиеся части могут защемить и привести к травме. Не прикасайтесь к движущимся частям.

Выполните проверку компонентов перед вводом анализатора в эксплуатацию. Используйте меню **Обслуживание** для запуска различных функций анализатора и проверки работы компонентов.

#### Необходимые условия:

- Если анализатор находится в рабочем режиме, выберите **Обслуживание > Запустить режим обслуживания**.
- Убедитесь, что трубки для пробы, реагента и раствора находятся в контейнере с деионизированной водой. См. [Подключение трубок к анализатору для проверки компонентов](#) на стр. 317.

#### 6.2.1 Осмотр мешалки

1. Снимите светозащитный экран с блока фотометра. См. [Рисунок 13](#) на стр. 472.
2. Убедитесь, что мешалка находится на дне сосуда для проб.  
*Примечание:* Осмотрите мешалку во время процедуры заправки, чтобы убедиться, что она вращается правильно. Запуск процедуры заправки описан в [Осмотр насосов и запорных клапанов](#) на стр. 321.
3. Установите светозащитный экран на фотометр.

#### 6.2.2 Осмотр насосов и запорных клапанов

1. Проверьте работу насосов и запорных клапанов, чтобы убедиться в отсутствии утечек.
2. Убедитесь, что сосуд для анализа заполняется деионизированной водой. См. [Рисунок 14](#) на стр. 474.
3. Убедитесь, что деионизированная вода выходит из дренажной трубки.
4. Выберите **Обслуживание > Запуск заправки** и залейте отдельно все жидкости.  
В случае утечки осмотрите все соединения и обратитесь к расширенной версии руководства пользователя в Интернете для получения дополнительной информации.
  - a. Выберите **Заправка эталона 1** и нажмите **ОК**.
  - b. Выберите **Заправка эталона 2** и нажмите **ОК**.
  - c. Выберите **Заправка чистящего раствора** и нажмите **ОК**.
  - d. Выберите **Заправка для промывки** и нажмите **ОК**.
  - e. Выберите **Заправка дозатора** и нажмите **ОК**.
  - f. Выберите **Заправить канал > Заправить все каналы** и нажмите **ОК**.  
После завершения процедуры каждая процедура заправки автоматически останавливается.

### 6.2.3 Осмотр микронасосов

Осмотрите микронасосы на предмет утечек и пузырьков воздуха.

1. Снимите светозащитный экран с фотометра.
2. Выберите **Обслуживание > Запуск заправки > Заправить все реагенты**.
3. Убедитесь, что деионизированная вода поступает в микронасос через каждую из трубок микронасоса (реагента). Затем она непрерывно поступает в сосуд для анализа без образования пузырьков воздуха. См. [Рисунок 15](#) на стр. 475.
4. Если микронасосы не работают должным образом (пузырьки в трубке), используйте шприц, чтобы ввести деионизированную воду в соответствующую трубку и удалить пузырьки. См. [Рисунок 16](#) на стр. 476.
5. Установите светозащитный экран на фотометр.

### 6.2.4 Проверка фотометра

Перед проверкой фотометра убедитесь, что внешняя поверхность сосуда для анализа чистая, чтобы проверка прошла успешно. Дополнительную информацию по очистке компонентов анализатора см. в расширенной онлайн-версии руководства пользователя.

1. Нажмите на значок главного меню, затем выберите **Устройства**.
2. Выберите **EZ2700sc**.
3. Прокрутите экран вниз и выберите **Меню устройства**.
4. Выберите **Обслуживание > Проверка фотометра**.
5. Нажмите **ОК**, чтобы начать измерение.  
После завершения темновой калибровки результат отображается на дисплее.
6. Нажмите **ОК**, чтобы продолжить.
7. Убедитесь, что трубка "REF1" подсоединена к контейнеру с деионизированной водой. Убедитесь, что светозащитный экран установлен правильно. См. [Рисунок 18](#) на стр. 479.
8. Нажмите **ОК**.  
Дождитесь, когда сосуд для анализа заполнится.
9. С помощью отвертки настройте напряжение выходного сигнала датчика на 9 В. См. [Рисунок 17](#) на стр. 476.
10. Подождите, пока на экране не отобразится значение 9 В. Затем нажмите **ОК**.
11. Нажмите **ОК**, чтобы продолжить.

## 6.3 Проверка входного сигнала

Выполните проверку цифровых входов перед вводом анализатора в эксплуатацию.

**Необходимые условия:** Подключите цифровые входы к внешнему беспотенциальному контакту (24 В пост. тока).

Выполните проверку цифрового входного сигнала и аналогового выходного сигнала следующим образом:

1. Нажмите на значок главного меню, затем выберите **Устройства**.
2. Выберите **EZ2700sc**.
3. Прокрутите экран вниз и выберите **Меню устройства**.
4. Выберите **Диагностика > Сигналы**.  
Сигналы отображаются на цифровых выходах.
5. Сравните состояние цифровых входов на дисплее с напряжением, подаваемым на цифровые входы (24 В = Вкл; 0 В = Выкл).

## 6.4 Проверка выходного сигнала

Выполните проверку аналоговых выходов перед вводом анализатора в эксплуатацию.

**Необходимые условия:** Настройте аналоговые выходы (АО1 - АО8, Р101) для выбора измерения канала, отображаемого каждым аналоговым выходом. Для получения дополнительной информации см. расширенную онлайн-версию руководства пользователя.

Выполните проверку аналогового выходного сигнала следующим образом:

1. Нажмите на значок главного меню.
2. Выберите **Выходы > АОС выходов mA > Проверка/Обслуживание**.

Опция	Описание
Проверка функции	Выполняет проверку выходов выбранного модуля.
Состояние выхода	Показывает состояние выходов выбранного модуля.

3. При помощи мультиметра измерьте значение mA на каждом аналоговом выходе.
4. Сравните значение mA, измеренное на аналоговых выходах, с ожидаемыми значениями mA.

## 6.5 Установка последовательности каналов

Выберите последовательность измерения каналов, количество измерений для каждого канала и время ожидания перед началом измерения. Введите не более 16 строк, в каждой из которых может быть не более 16 циклов.

1. Нажмите на значок главного меню, затем выберите **Устройства**.
2. Выберите **EZ2700sc**.
3. Прокрутите экран вниз и выберите **Меню устройства**.
4. Если анализатор находится в рабочем режиме, выберите **Обслуживание > Запустить режим обслуживания**.  
Подождите, пока анализатор не перейдет в режим обслуживания.
5. Выберите **Конфигурация > Установка последовательности каналов**.
6. С помощью стрелок на боковой панели выберите положение (номер в последовательности), затем нажмите **OK** для настройки этого положения.
7. Выберите опцию.

Опция	Описание
Выбор	Позволяет выбрать соответствующий канал или время ожидания.
Количество измерений	Устанавливает количество измерений для канала.
Время ожидания	Устанавливает время ожидания для выбранного канала.

8. Нажмите **OK** для сохранения изменений.

## 6.6 Подача растворов и пробы

### ▲ ОСТОРОЖНО



Опасность вредного химического воздействия. Необходимо соблюдать правила техники безопасности и использовать индивидуальные средства защиты, соответствующие используемым химикатам. При составлении протоколов по технике безопасности воспользуйтесь действующими паспортами безопасности / паспортами безопасности материалов (MSDS/SDS).

## ▲ ОСТОРОЖНО



Опасность вредного химического воздействия. Утилизируйте химические вещества и отходы в соответствии с местными, региональными и общегосударственными правилами и законами.

## ▲ ОСТОРОЖНО



Опасность возникновения пожара. Это изделие не предназначено для работы с легковоспламеняющимися жидкостями.

Контейнеры с реагентами поставляются вместе с анализатором. См. [Рисунок 18](#) на стр. 479. Контейнеры для эталонного раствора 1, эталонного раствора 2 и деионизированной воды предоставляет пользователь. Дополнительные контейнеры можно приобрести у производителя.

Устанавливайте контейнеры

- максимально близко к анализатору
- на 1 метр ниже нижней части анализатора

Схему установки контейнера см. на [Рисунок 18](#) на стр. 479.

Реагенты и растворы предоставляет пользователь. Используйте только реагенты, поставляемые сертифицированной компанией, или специальные реагенты производителя. В качестве альтернативы реагенты может приготовить пользователь. Следуйте инструкциям в листе методов и реагентов для соответствующей модели, который можно найти на веб-сайте производителя.

Трубки устанавливаются на заводе-изготовителе. Прочтите этикетку на каждой из труб, чтобы определить порядок подключения. Для получения информации о необходимых реагентах, растворах и стандартах см. лист методов и реагентов для соответствующей модели, который можно найти на веб-сайте производителя.

1. После проверки компонентов установите трубки "CLEAN" (раствор для очистки), "REF1" (эталонный раствор 1) и "REF2" (эталонный раствор 2) в соответствующие контейнеры. См. [Рисунок 18](#) на стр. 479.
2. Установите каждую трубку для реагента с цветовой кодировкой в контейнер для реагента с таким же цветом на этикетке.
3. Подсоедините источник пробы (или выход пробы на панели Moduplex или панель фильтра) к трубке входа пробы на анализаторе. См. [Рисунок 18](#) на стр. 479.
4. Нажмите на значок главного меню, затем выберите **Устройства**.
5. Выберите **EZ2700sc**.
6. Прокрутите экран вниз и выберите **Меню устройства**.
7. Выберите **Обслуживание > Запуск заправки > Заправить все**.

## 6.7 Выполнение подтверждения перед первым запуском

Выполните подтверждение, чтобы результаты измерений находились в пределах допустимого диапазона. Для получения дополнительной информации см. расширенную онлайн-версию руководства пользователя.

1. Нажмите на значок главного меню, затем выберите **Устройства**.
2. Выберите **EZ2700sc**.
3. Прокрутите экран вниз и выберите **Меню устройства**.
4. Чтобы начать процесс подтверждения, выберите **Калибровка > Подтверждение > Запустить подтверждение**.

Во время подтверждения деионизированная вода измеряется в бутылке с эталоном 2.

5. Чтобы увидеть результаты, выберите опцию:

- **Калибровка > Подтверждение > История подтверждения**
- **Диагностика > Исторические данные > Подтверждение**

## 6.8 Запуск анализатора

Для запуска анализатора:

1. Нажмите на значок главного меню, затем выберите **Устройства**.
2. Выберите **EZ2700sc**.
3. Прокрутите экран вниз и выберите **Меню устройства**.
4. Выберите **Обслуживание > Запустить рабочий режим**.

RU

# İçindekiler

- |                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1 Ek bilgi sayfa 326          | 4 Genel bilgiler sayfa 328 |
| 2 Ürüne genel bakış sayfa 326 | 5 Kurulum sayfa 329        |
| 3 Teknik özellikler sayfa 327 | 6 Başlatma sayfa 339       |

## Bölüm 1 Ek bilgi

Temel kullanım kılavuzu, devreye alma için yeterli bilgileri içerir. Daha kapsamlı bir kullanım kılavuzu, çevrimiçi olarak mevcuttur ve daha fazla bilgi içerir.

### ⚠ TEHLİKE



Birden fazla tehlike! Daha fazla bilgi, kapsamlı kullanım kılavuzunun aşağıda gösterilen bölümlerinde verilmiştir.

- Kullanıcı arabirimi ve gezinme
- Çalıştırma
- Bakım
- Sorun giderme
- Yedek parça listeleri

Genişletilmiş kullanım kılavuzuna gitmek için aşağıdaki QR kodlarını tarayın.



Avrupa dilleri



Amerikan ve Asya dilleri

## Bölüm 2 Ürüne genel bakış

Hach EZ2700sc analiz cihazı, endüstriyel ve çevre uygulamalarından alınan su numunelerinde bir parametreyi ölçen çevrimiçi analiz cihazıdır. Bkz. [Şekil 1](#) sayfa 439, [Şekil 2](#) sayfa 444 ve [Şekil 3](#) sayfa 448.

Analiz cihazı, genel su analizi (ör. nitrat, fosfat) için çevrimiçi bir kolorimetrik analiz cihazıdır. Analiz cihazı; Uzaktan başlatma, otomatik doğrulama, otomatik kalibrasyon, otomatik temizleme ve Modbus seçeneklerine sahiptir.

Numune suyu, numune hortumu aracılığıyla analiz cihazına girer. Analiz cihazındaki pompalar, valfler ve şırıngalar numuneyi ve reaktifleri analiz panelindeki ölçüm hücrelerine taşır. Kaptaki analiz tamamlandığında, analiz cihazı numuneyi tahliye hortumu aracılığıyla atar. Analiz sonuçları SC4500 Kontrol Ünitesinin ekranında gösterilir. SC4500 Kontrol Ünitesi analiz cihazı verilerini (veri günlüğü, olay günlüğü, ayarlar günlüğü ve servis günlüğü) kaydeder. Analiz cihazını çalıştırmak ve yapılandırmak için SC4500 Kontrol Ünitesini kullanın.

Analiz cihazının ölçebileceği numune akışı (kanal) sayısını artırmak için (2, 4 veya 8) analiz cihazıyla birlikte Moduplex çoklu akış panelini satın alın.

Numuneyi ön koşullandırmak için (filtrasyon, çökelme) analiz cihazıyla birlikte EZ9010, EZ9020, EZ9150, EZ9200 veya EZ9250 filtrasyon panelini satın alın.

## Bölüm 3 Teknik özellikler

Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Teknik Özellik	Ayrıntılar
Boyutlar (G x Y x D)	460 x 688 x 340 mm (18,1 x 27,1 x 13,4 inç)
Muhafaza	IP44; ABS, PMMA ve kaplanmış çelik
Ekran	IP66, kapasitif dokunmatik yüzeyli 3,5 inç TFT renkli ekran
Ağırlık	40 kg (88 lb)
Güç gereksinimleri	100 ila 240 VAC $\pm$ 10%, 50/60 Hz
Güç tüketimi	240 VA maksimum
Yükseklik	Maksimum 2000 m (6560 ft)
Aşırı gerilim kategorisi	II
Ortam koşulları	Yalnızca iç mekanda kullanım içindir
Kirlilik derecesi	2
Çalışma sıcaklığı	10 - 30°C (50 - 86°F); %5 - 95 bağıl nem, yoğuşma olmadan, aşınma olmadan
Depolama sıcaklığı	-20 ila 60°C (-4 ila 140°F), %95 bağıl nem, yoğuşmasız maksimum
Numune girişleri	Bir
Numune basıncı	Harici taşma kabıyla (atmosfer basıncına açık)
Numune akış hızı	100 ila 300 mL/dk
Numune sıcaklığı	10 ila 30°C (50 ila 86°F)
Numune kalitesi	< 100 $\mu$ m parçacık, < 0,1 g/l maksimum Bulanıklık < 50 NTU
Aşındırıcı ortamlar için hava tahliyesi	0,2 bar (20 kPa veya 3 psi); kuru ve temiz hava
Boşaltma	Atmosferik basınç, tahliyeli, minimum $\emptyset$ 32 mm
Topraklama bağlantısı	Düşük empedanslı (< 1 $\Omega$ ), > 2,5 mm <sup>1</sup> (13 AWG) topraklama kablosu ile kuru ve temiz topraklama direği
Analog çıkışlar	Maksimum sekiz adet 0 - 20 mA (veya 4 - 20 mA) analog çıkış <b>Not:</b> Analog çıkışlar döngü gücü sağlar. SCADA veya PLC sisteminin kontaklarına güç sağlanamıyor.
Dijital girişler	Yedi dijital giriş: Uzaktan başlatma için iki dijital giriş. Kalan dijital girişler ileride kullanıma yöneliktir.
Dijital çıkışlar	EZ9150 panelinin valfleri ve pompaları için dört güç beslemeli dijital çıkış; Moduplex panelinin valfleri için sekiz güç beslemeli dijital çıkış; 24 VDC, 500 mA.
Röleler	Beş potansiyelsiz kontak (FCT), maksimum yükleme 24 VDC, 0,5 A (dirençli yük)
Ethernet bağlantıları	Claros Ethernet bağlantısı ve Modbus TCP/IP Ethernet konektörü; LAN versiyonu; 10/100 Mbps veya Profinet ya da Ethernet IP
RS485 iletişimleri	Profibus DP veya Modbus RTU

TR

<sup>2</sup> Ethernet yapılandırması ve Modbus yapılandırması hakkında bilgi için SC4500 Kontrol Ünitesi belgelerine bakın.

Teknik Özellik	Ayrıntılar
Sertifikalar	UL ve CSA güvenlik standartlarına göre onaylı CE, ETL, UKCA
Garanti	1 yıl (AB: 2 yıl)

## Bölüm 4 Genel bilgiler

Üretici, hiçbir koşulda ürünün yanlış kullanımından veya kılavuzdaki talimatlara uyulmamasından kaynaklanan hasarlardan sorumlu tutulamaz. Üretici, bu kılavuzda ve açıkladığı ürünlerde, önceden haber vermeden ya da herhangi bir zorunluluğa sahip olmadan değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır. Güncellenmiş basımlara, üreticinin web sitesinden ulaşılabilir.

### 4.1 Güvenlik bilgileri

Üretici, doğrudan, arızı ve sonuç olarak ortaya çıkan zararlar dahil olacak ancak bunlarla sınırlı olmayacak şekilde bu ürünün hatalı uygulanması veya kullanılmasından kaynaklanan hiçbir zarardan sorumlu değildir ve yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde bu tür zararları reddeder. Kritik uygulama risklerini tanımlamak ve olası bir cihaz arızasında prosesleri koruyabilmek için uygun mekanizmaların bulunmasını sağlamak yalnızca kullanıcının sorumluluğundadır.

Bu cihazı paketinden çıkarmadan, kurmadan veya çalıştırmadan önce lütfen bu kılavuzun tümünü okuyun. Tehlikeler ve uyarılarla ilgili tüm ifadeleri dikkate alın. Bunların yapılmaması kullanıcının ciddi şekilde yaralanmasına veya cihazın hasar görmesine neden olabilir.




Ekipman üretici tarafından belirtilmeyen bir şekilde kullanılırsa, ekipmanın sağladığı koruma bozulabilir. Bu donanımı, bu kılavuzda belirtilenden başka bir şekilde kullanmayın ve kurmayın.




#### 4.1.1 Tehlikeyle ilgili bilgilerin kullanılması

<b>▲ TEHLİKE</b>
Kaçınılmadığı takdirde ölüm veya ciddi yaralanmaya yol açan potansiyel veya tehdit oluşturacak tehlikeli bir durumu belirtir.
<b>▲ UYARI</b>
Kaçınılmadığı takdirde ölüm veya ciddi yaralanmaya yol açabilecek potansiyel veya tehdit oluşturabilecek tehlikeli bir durumu belirtir.
<b>▲ DİKKAT</b>
Küçük veya orta derecede yaralanmalarla sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli durumu gösterir.
<b>BİLGİ</b>
Engellenmediği takdirde cihazda hasara neden olabilecek bir durumu belirtir. Özel olarak vurgulanması gereken bilgiler.

#### 4.1.2 Önlem etiketleri


Cihazın üzerindeki tüm etiketleri okuyun. Talimatlara uyulmadığı takdirde yaralanma ya da cihazda hasar meydana gelebilir. Cihaz üzerindeki bir sembol, kılavuzda bir önlem ibaresiyle belirtilir.

	Bu, güvenlik uyarı sembolüdür. Olası yaralanmaları önlemek için bu sembolü izleyen tüm güvenlik mesajlarına uyun. Cihaz üzerinde mevcutsa çalıştırma veya güvenlik bilgileri için kullanım kılavuzuna başvurun.
	Bu sembol kimyasal maddelerden zarar görme tehlikesi olduğunu gösterir ve yalnızca uzman ve kimyasal maddelerle çalışmak üzere eğitilmiş kimselerin kimyasal maddelerle çalışması ya da ekipmanın kimyasal salım sistemi üzerinde bakım çalışması yapması gerektiğini belirtir.
	Bu sembol elektrik çarpması ve/veya elektrik çarpması sonucu ölüm riskinin bulunduğunu gösterir.

	Bu sembol Elektrostatik Boşalmaya (ESD-Electro-static Discharge) duyarlı cihaz bulunduğunu ve ekipmana zarar gelmemesi için dikkatli olunması gerektiğini belirtir.
	Bu sembol işaretli parçanın koruyucu topraklama bağlantısı gerektirdiğini gösterir. Cihaz beraberinde topraklama fiş kablosuyla birlikte gelmediyse koruyucu toprak bağlantısını koruma iletkenli bağlantı ucuna takın.
	Bu sembolü taşıyan elektrikli cihazlar, Avrupa evsel ya da kamu atık toplama sistemlerine atılamaz. Eski veya kullanım ömrünü doldurmuş cihazları, kullanıcı tarafından ücret ödenmesine gerek olmadan atılması için üreticiye iade edin.






TR

#### 4.1.3 Kimyasal ve biyolojik güvenlik

<b>⚠ TEHLİKE</b>	
	Kimyasal veya biyolojik tehlikeler. Bu cihaz, kamu sağlığı, kamu güvenliği, yiyecek ve içecek üretimi veya işleme ile ilgili yasal sınırlamaların ve takip gereksinimlerinin söz konusu olduğu bir arıtma işlemi ve/veya kimyasal besleme sistemini izlemek için kullanılıyorsa yürürlükteki tüm yönetmelikler hakkında bilgi sahibi olmak ve bunlara uymak ve cihazın arızalanması durumunda yürürlükteki yönetmeliklere uyum için ilgili alanda yeterli ve uygun mekanizmaların bulunmasını sağlamak bu cihazın kullanıcısının sorumluluğundadır.

#### 4.2 Resimlerde kullanılan simgeler

			
Üretici tarafından sağlanan parçalar	Kullanıcı tarafından sağlanan parçalar	Bakın	Adımları ters sırayla uygulayın

				
İki kişiden yararlanın	Dinleyin	Yalnızca parmaklarınızı kullanın	Alet kullanmayın	Dokunmayın

#### 4.3 Kullanım amacı

Hach EZ serisi analiz cihazları, endüstriyel ve çevresel uygulamalardan alınan numunelerde su kalitesi parametrelerini ölçmesi gereken kişiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Hach EZ serisi analiz cihazları, suyu arıtmaz veya değiştirmez ve prosedürlerin kontrolü için kullanılmaz.

#### 4.4 Ürün bileşenleri

Bütün bileşenlerin teslim alındığından emin olun. Bkz. [Şekil 4](#) sayfa 453. Eksik veya hasarlı bir öğe varsa derhal üretici ya da satış temsilcisiyle iletişime geçin.

### Bölüm 5 Kurulum

<b>⚠ TEHLİKE</b>	
	Birden fazla tehlike. Belgenin bu bölümünde açıklanan görevleri yalnızca yetkili personel gerçekleştirmelidir.

## 5.1 Montaj kılavuzu

### ⚠ UYARI



Yangın tehlikesi. Kullanıcı, cihaz yanıcı sıvılar gerektiren yöntemlerle kullanılırken yeterli önlemleri aldığından emin olmalıdır ve bu sorumluluğu üstlenir. Doğru kullanıcı önemlerine ve güvenlik protokollerine uyduğunuzdan emin olun. Bu önlemler arasında, sadece bunlarla sınırlı olmaksızın, dökülme ve sızıntıların kontrol edilmesi, doğru havalandırma yapılması, gözetimsiz kullanmaması ve güç takılıken cihazın gözetimsiz bırakılmaması bulunur.

### ⚠ DİKKAT



Kimyasal maddelere maruz kalma tehlikesi. Laboratuvar güvenlik talimatlarına uyun ve kullanılan kimyasallara uygun tüm kişisel koruma ekipmanlarını kullanın. Güvenlik protokolleri için mevcut güvenlik veri sayfalarına (MSDS/SDS) başvurun.

### ⚠ DİKKAT



Kimyasal maddelere maruz kalma tehlikesi. Kimyasal maddeleri ve atıkları yerel, bölgesel ve ulusal yönetmeliklere uygun şekilde atın.

- Analiz cihazını iç mekanda, tehlikesiz ortama kurun.
- Analiz cihazını, aşındırıcı sıvılara karşı korunan bir ortama kurun.
- Analiz cihazını temiz, kuru, iyi havalandırılan ve sıcaklık kontrolü yapılan bir konumda kurun.
- Analiz cihazını, numuneleme noktasına mümkün olduğu kadar yakın bir konumda kurun.
- Analizörü doğrudan güneş ışığı alan bir yerde ya da bir ısı kaynağının yakınında kurmayın.
- Çevresinde sıhhi tesisat ve elektrik bağlantılarını yapmak için yeterli boşluk olduğundan emin olun.
- Analiz cihazının ön kısmında, cihazın kapısını açmaya imkan tanıyacak yeterli alan bıraktığınızdan emin olun. Bkz. [Analiz cihazı boyutları](#) sayfa 330.
- Ortam koşullarının, çalıştırma teknik özellikleri kapsamında olduğundan emin olun. Bkz. [Teknik özellikler](#) sayfa 327.

Analiz cihazı yanıcı numunelerle kullanım için tasarlanmamış olsa da bazı EZ analiz cihazları yanıcı reaktifler kullanır. Analiz cihazında kullanılan reaktiflerle ilgili daha fazla bilgi için ilgili EZ serisi modelinin Yöntem ve Reaktif Sayfasına bakın. Analiz cihazı yanıcı reaktifler kullanıyorsa aşağıdaki güvenlik önlemlerine uyduğunuzdan emin olun:


- Analiz cihazını ısıdan, kıvılcımlardan ve açık alevden uzak tutun.
- Analiz cihazının yanında yemek yemeyin, bir şeyler içmeyin veya sigara içmeyin.
- Yerel bir egzoz havalandırma sistemi kullanın.
- Kıvılcımlara veya patlamaya karşı dayanıklı cihazlar ve aydınlatma sistemi kullanın.
- Elektrostatik boşalmaları önleyin. Bkz. [Elektrostatik boşalma \(ESD\) ile ilgili önemli bilgiler](#) sayfa 331.
- Kullanmadan önce cihazı tamamen temizleyin ve kurulaşın.
- Molalardan önce ve çalışma süresinin sonunda ellerinizi yıkayın.
- Kirlenen kıyafetleri çıkarın. Yeniden kullanmadan önce kıyafetleri yıkayın.
- Bu sıvılar, izin verilen maruz kalma sınırları kapsamında yerel düzenleyici kurum gerekliliklerine uygun olarak kullanılmalıdır.


## 5.2 Analiz cihazı boyutları


Analiz cihazı boyutları için bkz. [Şekil 5](#) sayfa 454.

## 5.3 Mekanik kurulum

### 5.3.1 Cihazın duvara montajı

⚠ UYARI	
	Fiziksel yaralanma tehlikesi. Duvar montajının, ekipman ağırlığının 4 katına kadar taşıyabildiğinden emin olun.

⚠ UYARI	
	Fiziksel yaralanma tehlikesi. Cihazlar veya bileşenler ağırdır. Kurarken veya taşırken yardım alın.

⚠ UYARI	
	Fiziksel yaralanma tehlikesi. Cihaz ağırdır. Cihazın emniyetli çalışması için cihazın bir duvara, masaya veya zemine güvenli bir şekilde yerleştirildiğinden emin olun.

Cihazı düz, dikey bir duvar yüzeyine dik ve düz bir şekilde takmak için verilen montaj braketterini kullanın. Bkz. [Şekil 6](#) sayfa 456.

Cihazı, kullanıcının cihaz ile güç kaynağının bağlantısını kolayca kesebileceği bir yere ve konuma kurun.

Şişeleri takmak için analiz cihazının altında yeterli boşluk olduğundan emin olun.

Montaj donanımı kullanıcı tarafından sağlanır. Duvar bağlantı elemanının yeterli yük taşıma kapasitesine sahip olduğundan emin olun (yaklaşık 160 kg veya 353 lb). Montaj donanımı duvarın özellikleri için onaylanmış olmalıdır.


### 5.3.2 Analizörün kapısını açma

Analizörün yan tarafındaki iki kilidi açmak için verilen anahtarı kullanın. Bkz. [Şekil 7](#) sayfa 456. Muhafazanın çevre koruma sınıfını ve güvenlik derecesini korumak için çalıştırmadan önce kapıyı kapatmış olduğunuzdan emin olun.

## 5.4 Elektriksel kurulum

⚠ TEHLİKE	
	Elektrik çarpması nedeniyle ölüm tehlikesi. Elektrik bağlantısı yapmadan önce cihaza giden elektriği mutlaka kesin.

### 5.4.1 Elektrostatik boşalma (ESD) ile ilgili önemli bilgiler

BİLGİ	
	Potansiyel Cihaz Hasarı. Hassas dahili elektronik bileşenler, statik elektrikten zarar görebilir ve bu durum cihaz performansının düşmesine ya da cihazın arızalanmasına neden olabilir.

Cihazda ESD hasarını önlemek için bu prosedürdeki adımlara başvurun:

- Statik elektriği gövdeden boşaltmak için bir cihazın şasisi, metal bir iletim kanalı ya da boru gibi topraklanmış bir metal yüzeye dokununuz.
- Aşırı hareketten sakının. Statik elektriğe duyarlı bileşenleri, statik elektrik önleyici konteynırlar veya ambalajlar içinde taşıyın.
- Toprağa kabloyla bağlı bir bileklik giyin.
- Statik elektrik önleyici zemin pedleri ve tezgah pedleri içeren statik emniyetli bir alanda çalışın.

## 5.4.2 Elektrik erişimi

Harici cihazların kablolarını kablo rakorlarından geçirin. Bkz. [Şekil 8](#) sayfa 459. Kullanılmayan kablo rakorlarındaki fişleri saklayın.

[Şekil 9](#) sayfa 462 analiz cihazının içindeki bileşenleri gösterir. Güç düğmesi, aşırı akım (örneğin kısa devre) veya aşırı gerilim durumu meydana geldiğinde ana güç kaynağını otomatik olarak AC güç hattından kesen bir devre kesicidir.

## 5.4.3 Harici cihazları bağlama

Analiz cihazı ile birlikte kullanılacak harici cihazları analiz cihazındaki sinyal ve kontrol terminallerine bağlayın. Bkz. [Şekil 10](#) sayfa 467 ve [Tablo 1](#) sayfa 332.

**Tablo 1 Sinyal ve kontrol terminalleri: Açıklamalar**

Pim	Açıklama
AO1–AO8 (P101)	Harici cihazları kontrol etmek için sekiz analog çıkış. Daha fazla bilgi için çevrimiçi kapsamlı kullanım kılavuzuna bakın.
FCT1–FCT5 (P102)	Beş röle (potansiyelsiz kontaklar). Maksimum yükleme 24 VDC, 0,5 A'dır. <ul style="list-style-type: none"><li>• FCT1: Arıza alarmı</li><li>• FCT2: Bakım alarmı</li><li>• FCT3: Analiz cihazı hazır</li><li>• FCT4 ve FCT5: İleride kullanılmak üzere</li></ul>
DI1–DI7 (P103)	Analiz cihazını uzaktan kontrol etmek için yedi dijital giriş <sup>5</sup> Analiz cihazını bir kanal için ölçümü başlatmak üzere tetiklemek için dijital girişleri harici bir potansiyelsiz kontakta (24 VDC) bağlayın. <ul style="list-style-type: none"><li>• DI1: Kanal 1 için uzaktan başlatma</li><li>• DI2: Kanal 2 için uzaktan başlatma</li><li>• DI3 ila DI7: İleride kullanılmak üzere</li></ul>
FB1–FB4 (P104)	Profibus DP veya Modbus RTU (RS485) konnektörleri <b>Profibus DP:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• FB1: A1 (giriş)</li><li>• FB2: A2 (çıkış)</li><li>• FB3: B1 (giriş)</li><li>• FB4: B2 (çıkış)</li><li>• SHL: Kalkan</li></ul> <b>Modbus RTU:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• FB1: D (+)</li><li>• FB2: D (-)</li><li>• FB3: kullanılmıyor</li><li>• FB4: kullanılmıyor</li><li>• SHL: Kalkan</li></ul> Modbus yapılandırma talimatları ve telegram etiketleri için SC4500 Kontrol Ünitesi belgelerine bakın.
24 VDC/1 A (P105)	EZ9010 ve EZ9020 filtrasyon üniteleri için 24 V DC güç kaynağı

<sup>5</sup> Analiz cihazı bakım modundaydı uzaktan kumanda devre dışı bırakılır.

**Tablo 1 Sinyal ve kontrol terminalleri: Açıklamalar (devamı)**

Pim	Açıklama
STR1–STR8 (P106)	İsteğe bağlı Moduplex panel için sekiz dijital çıkış. Moduplex panelindeki her bir kanal valfinin çıplak tellerini ilgili STR konektörlerine bağlayın. <ul style="list-style-type: none"><li>• STR1: Kanal 1</li><li>• STR2: Kanal 2</li><li>• ...</li><li>• STR8: Kanal 8</li></ul>
EXT9–EXT12 (P107)	İsteğe bağlı EZ9150 filtrasyon paneli için dört dijital çıkış. EZ9150 filtrasyon panelindeki elektrikli valfleri ve pompayı EXT konektörlerine bağlayın. <ul style="list-style-type: none"><li>• EXT9: Durulama valfi</li><li>• EXT10: Geri yıkama valfi</li><li>• EXT11: Tahliye taşma valfi</li><li>• EXT12: Filtrasyon pompası</li></ul>
D01–D06 (P108 ve P109)	EZ9150 paneli için altı pnömomatik valf çıkışı. <ul style="list-style-type: none"><li>• D01: Numune giriş valfi</li><li>• D02: Tahliye taşma valfi</li><li>• D03: Kanal 1 valfi</li><li>• D04: Kanal 2 valfi</li><li>• D05: Kanal 3 valfi</li><li>• D06: Kanal 4 valfi</li></ul>

#### 5.4.4 AC güç bağlantısı

### ⚠ TEHLİKE



Elektrik çarpması ve yangın tehlikeleri. Temin edilen kablunun ve kilitlenmeyen fişin ilgili ülke gerekliliklerine uygun olduğundan emin olun.

- Elektrik hattına yeterli elektrik akımı kapasitesine sahip bir devre kesicinin bağlandığından emin olun.
- Analiz cihazının güç kaynağı bağlantısının gerektiğinde hemen kesilebilmesi için devre kesicinin veya bir acil durum anahtarının analiz cihazının yakınına takıldığından emin olun.
- Cihazı yerel ya da ulusal elektrik yönetmeliklerine göre bağlayın.
- Verilen güç kablosunu analiz cihazının yan tarafındaki kablo rakorundan geçirerek takın.
- Güç kablosunu güvenli bir şekilde tutmak ve muhafazanın çevre koruma sınıfını korumak için kablo rakorunu sıkın.

Verilen AC güç kablosunu kullanarak analiz cihazını AC gücüne bağlayın. Bkz. [Tablo 2](#) sayfa 334 ve [Şekil 11](#) sayfa 468.

## BİLGİ

Güç düğmesini açık konuma getirmeyin. Çalıştırmadan önce tüm elektrik ve tesisat bağlantılarını tamamlayın, aksi takdirde analiz cihazında hasar meydana gelebilir.

**Tablo 2 Kablo tesisatı bilgileri: AC gücü**

Terminal	Açıklama	Kablo rengi-Kuzey Amerika ve Kanada	Kablo rengi-AB
L	Yüklü/Hat (L)	Siyah (1)	Kahverengi
N	Nötr (N)	Beyaz (2)	Mavi
	Koruyucu topraklama (PE)	Sarı şeritli yeşil	Sarı şeritli yeşil

## 5.5 Akış tesisatının ayarlanması

### 5.5.1 Numune hattı yönergeleri

#### ⚠ DİKKAT



Yangın tehlikesi. Bu ürün yanıcı numunelerle kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

En iyi cihaz performansı için iyi bir temsil edici numuneleme noktası seçin. Numune tüm sistemi temsil edici olmalıdır.

- Numune akış hızının analiz cihazına giden akışın hızından daha yüksek olduğundan emin olun.
- Analiz cihazında, numuneyi analiz kabına taşımak için peristaltik pompa kullanılmaktaysa numune hattının atmosferik basınçta olduğundan emin olun.
- Numune hattının, numuneyi analiz cihazının yakınındaki küçük bir taşma kabından topladığından emin olun.
- Ürünle birlikte numune hattını kullanın. Numune hattının uzunluğunu değiştirmeyin.

Taşma kabındaki numune sürekli tazelenmelidir. Numunedeki katı miktarı çok yüksekse numunenin filtrelenmesi önerilir.

### 5.5.2 Tahliye hattı yönergeleri

#### ⚠ UYARI



Yangın tehlikesi. Kullanıcı, cihaz yanıcı sıvılar gerektiren yöntemlerle kullanılırken yeterli önlemleri aldığından emin olmalıdır ve bu sorumluluğu üstlenir. Doğru kullanıcı önemlerine ve güvenlik protokollerine uyduğunuzdan emin olun. Bu önlemler arasında, sadece bunlarla sınırlı olmaksızın, dökülme ve sızıntıların kontrol edilmesi, doğru havalandırma yapılması, gözetimsiz kullanılmaması ve güç takılıyken cihazın gözetimsiz bırakılmaması bulunur.

#### ⚠ DİKKAT



Kimyasal maddelere maruz kalma tehlikesi. Kimyasal maddeleri ve atıkları yerel, bölgesel ve ulusal yönetmeliklere uygun şekilde atın.

## BİLGİ

Tahliye hatlarını diğer hatlara bağlamayın; aksi halde analiz cihazında basınç ve hasar oluşabilir. Tahliye hatlarının hava aldığından emin olun.

## BİLGİ

Analiz cihazında karşı basınç ve hasar oluşmasını önlemek için analiz cihazının tesiste kullanılan tahliyelerden yüksekte olduğundan ve tahliye hattının sabit bir şekilde aşağı doğru eğimli olduğundan emin olun. Tahliye hatlarını, her 0,3 m (1 ft) hortum uzunluğu için en az 2,54 cm (1 inç) dikey eğim sağlayarak takın.

Analiz cihazı, analiz bittikten sonra numune ve reaktifleri atmak için tahliye hattını kullanır. Tüm sıvının cihazdan tamamen çıkarıldığından emin olunması için tahliye hatlarının doğru bir şekilde takılması önemlidir. Yanlış kurulum, sıvının cihaza geri dönüp hasar vermesine neden olabilir. Tahliye hattı için zemin ya da lavabo tahliye noktası yeterlidir. Tahliye hortumu için önerilen dış çap 32 mm'dir. Bkz. [Şekil 12](#) sayfa 471.

- Tahliye hatlarını olabildiğince kısa tutun.
- Tahliye noktasının analiz cihazından aşağıda olduğundan emin olun.
- Tahliye hatlarının sürekli olarak aşağı eğimli olmasını sağlayın.
- Tahliye hatlarında keskin bükümler ve sıkışma olmadığından emin olun.
- Tahliye hatlarının hava aldığından ve basıncın sıfır olduğundan emin olun.
- Tahliye hatlarının kurulum odası ortamına kapalı olduğundan emin olun.
- Tahliye hattının tıkanmasına ya da sıvı altında kalmasına izin vermeyin.

Kristalleşme nedeniyle tıkanmayı önlemek amacıyla tahliye lavabosunun ve tahliye hortumlarının düzenli olarak yıkanması için analiz cihazının yanında bir su bağlantısı kullanılması da önerilmektedir.

Analiz cihazında kullanılan reaktiflerle ilgili daha fazla bilgi için ilgili EZ serisi modelinin Yöntem ve Reaktif Sayfasına bakın. Analiz cihazı yanıcı reaktifler kullanıyorsa aşağıdaki güvenlik önlemlerine uydüğunuzdan emin olun:

- Tahliye hattını bir zemin tahliye noktasına bağlamayın.
- Atıkları yerel, bölgesel ve ulusal çevre yönetmeliklerine uygun şekilde bertaraf edin.

### 5.5.3 Havalandırma hattı yönergeleri

#### ⚠ UYARI



Yangın tehlikesi. Kullanıcı, cihaz yanıcı sıvılar gerektiren yöntemlerle kullanılırken yeterli önlemleri aldığından emin olmalıdır ve bu sorumluluğu üstlenir. Doğru kullanıcı önemlerine ve güvenlik protokollerine uydüğunuzdan emin olun. Bu önlemler arasında, sadece bunlarla sınırlı olmaksızın, dökülme ve sızıntıların kontrol edilmesi, doğru havalandırma yapılması, gözetimsiz kullanmaması ve güç takılıken cihazın gözetimsiz bırakılmaması bulunur.

#### ⚠ DİKKAT



Kimyasal maddelere maruz kalma tehlikesi. Kimyasal maddeleri ve atıkları yerel, bölgesel ve ulusal yönetmeliklere uygun şekilde atın.

## BİLGİ

Havalandırma hattını (egzoz gazı bağlantı noktası) diğer hatlara bağlamayın; aksi halde analiz cihazında karşı basınç veya hasar oluşabilir. Havalandırma hattının binanın dış cephesinde havaya açıldığından olduğundan emin olun.

## BİLGİ

Analiz cihazında karşı basınç ve hasar oluşmasını önlemek için analiz cihazının tesiste kullanılan havalandırmalardan yüksekte olduğundan ve havalandırma hattının sabit bir şekilde aşağı doğru eğimli olduğundan emin olun. Havalandırma hattını, her 0,3 m (1 ft) hortum uzunluğu için en az 2,54 cm (1 inç) dikey eğim sağlayarak takın.

Analiz cihazı, analiz kabını atmosferik basınçta tutmak için havalandırma hattını kullanır. Havalandırma hattının doğru şekilde takılması, pompanın çalışması sırasında havalandırma hattından analiz kabına sıvı girmediğinden emin olmak için önemlidir. Yanlış kurulum, gazın analiz

cihazına geri dönerek cihaza hasar vermesine neden olabilir. Havalandırma hattında kolektör hortumu için önerilen dış çap 32 mm'dir. Bkz. [Şekil 12](#) sayfa 471.

- Havalandırma hattını olabildiğince kısa tutun.
- Havalandırma hattının sürekli olarak aşağı eğimli olmasını sağlayın.
- Havalandırma hattında keskin bükülmeler ve sıkışma olmadığından emin olun.
- Havalandırma hattının kurulum odası ortamına kapalı durumda ve basıncın sıfır olduğundan emin olun.
- Havalandırma hattının her zaman tahliyeden daha yüksek olduğundan emin olun.
- Havalandırma hattının tıkanmasına ya da sıvı altında kalmasına izin vermeyin.

Analiz cihazı yanıcı reaktifler kullanıyorsa aşağıdaki güvenlik önlemlerine uyduğunuzdan emin olun:

- Havalandırma hattını bir zemin tahliye noktasına bağlamayın.
- Atıkları yerel, bölgesel ve ulusal çevre yönetmeliklerine uygun şekilde bertaraf edin.

#### 5.5.4 Bileşen testi için analiz cihazının bağlantısını yapın.


### ⚠ DİKKAT




Yangın tehlikesi. Bu ürün yanıcı sıvılarla kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

Tüm reaktifleri içeren analiz cihazı çalıştırılmadan önce deiyonize su ile bileşen testi yapılmalıdır. Gösterilen adımlara ve [Bileşen testlerini gerçekleştirme](#) sayfa 340 kısmına başvurun.

1. Dört sıkıştırma valfi hortumunu aşağıdaki resimli adım 1'de gösterildiği gibi takın.
  - a. Siyah düğmeye basın, ardından hortumu valfin içine itin.
  - b. Hortum doğru şekilde takıldığında düğmeyi bırakın.
2. Tahliye hortumunun numune kabına doğru şekilde takıldığından emin olun. Aşağıdaki resimli adım 2'ye bakın.
3. Sindirici hortumunun sindirici kazanına doğru şekilde takıldığından emin olun. Aşağıdaki resimli adım 3'e bakın.
4. Bileşenleri test etmek için tüm analiz cihazı sıvı hortumlarını büyük bir deiyonize su şişesine bağlayın. Aşağıdaki resimli adım 3'e bakın. Hortumlar fabrikada takılır.



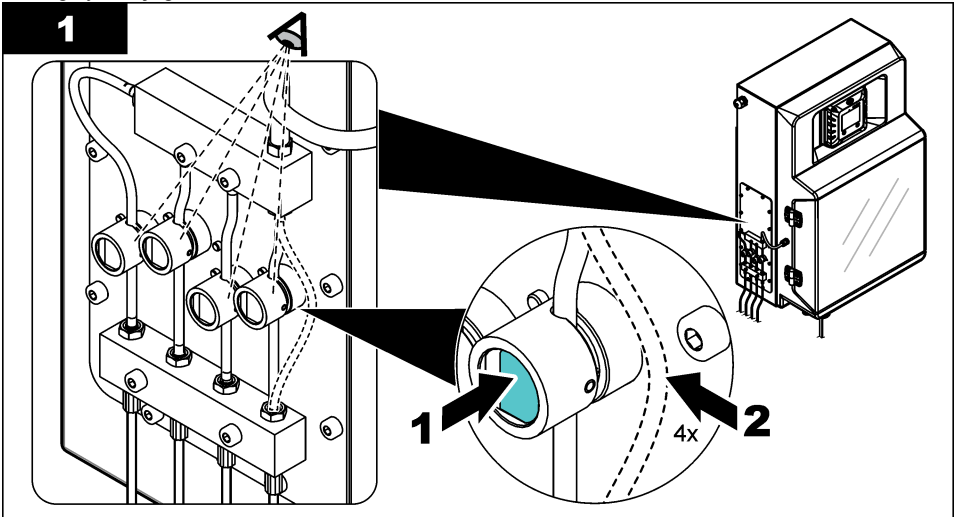


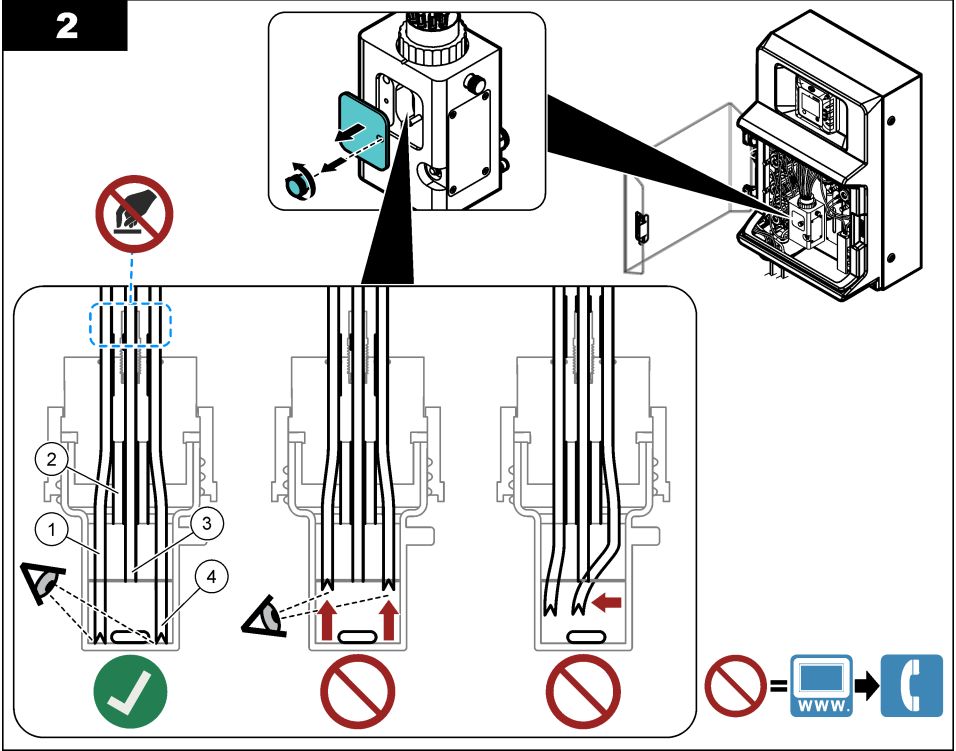**2**

TR

1 Tahliye hortumu	3 Numune hortumu
2 Reaktifler ve havalandırma hortumu (üst hortum)	4 Sindirici hortumu


3

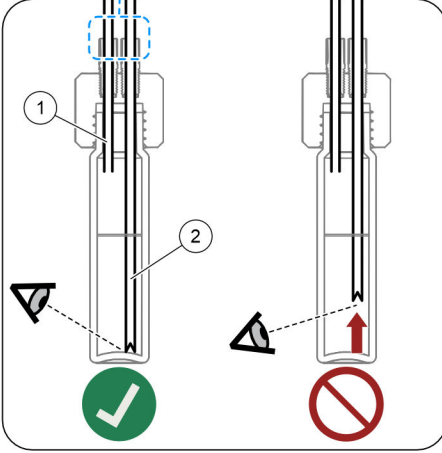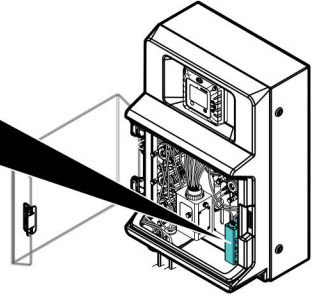

1 Havalandırma hortumu

2 Sindirici hortumu

4

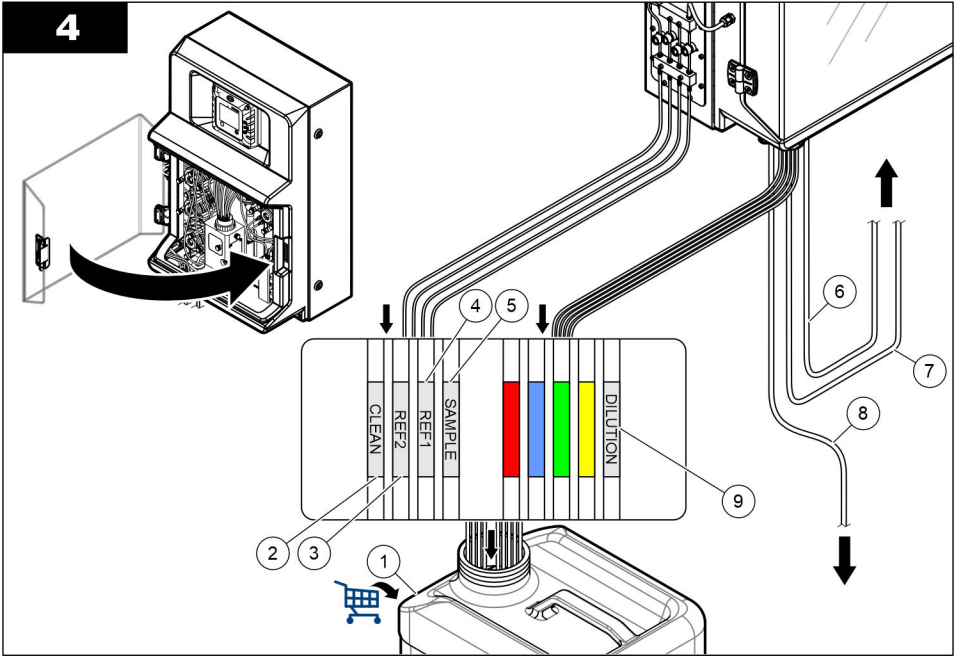

1 Deiyonize su	4 Referans 1 çözeltisi (REF1) hortumu	7 Havalandırma sindirici hortumu
2 Temizleme çözeltisi hortumu	5 Numune girişi hortumu	8 Tahliye hortumu
3 Referans 2 çözeltisi (REF2) hortumu	6 Havalandırma hortumu	9 Seyreltme ve reaktif mikropompa hortumları

## Bölüm 6 Başlatma

### 6.1 İlk çalıştırma

**Not:** Çalıştırmadan önce, montaj, hortum ve elektrik tesisatlarının tam olarak yapıldığından emin olun. Bkz. Kurulum sayfa 329.

Analiz cihazı ilk kez açıldığında başlangıç asistanı kurulumu tamamlamak için ilk adımlarda yardımcı olur. Analiz cihazının düzgün çalıştığından emin olmak için takip eden tüm adımları tamamlayın.

**Not:** Seçilen ölçüm aralığı için doğru reaktifleri kullandığınızdan emin olun. Daha fazla bilgi için çevrimiçi kapsamlı kullanım kılavuzuna bakın.

1. Analizör cihazının kapısını açın. Bkz. [Analizörün kapısını açma](#) sayfa 331.
2. Güç düğmesini AÇIK konuma getirin. Bkz. [Şekil 9](#) sayfa 462.
3. Analiz cihazının kapağını ürünle birlikte verilen anahtarla kapatın.
4. Başlatma prosedürünün tamamlanmasını bekleyin.
5. Dil, saat dilimi, tarih ve saat ayarlarını seçmek için ekrandaki istemlere yanıt verin. Diğer kontrol ünitesi ayarlarını yapılandırmak için SC4500 Kontrol Ünitesi belgelerine bakın.
6. **EZ2700sc** öğesini görüntülemek için ekrana dokunun.
7. Başlangıç asistanını başlatmak için **Cihaz menüsü** öğesini seçin. Karşılama ekranı görüntülenir.
8. Uygun ölçüm aralığını seçmek için ekranda gösterilen adımları tamamlayın. **OK (Tamam)** öğesine basın.

9. Bir filtrasyon ünitesi takılıysa **Açık** ögesini seçin. Aksi takdirde **Kapalı** ögesini seçin.
10. Analiz cihazı için kanal sayısını seçin. **OK (Tamam)** ögesine basın.
11. Özet sayfasında gösterilen yapılandırma doğruysa **OK (Tamam)** düğmesine basın. **EZZ2700sc** ana menüsü görüntülenir.
12. Bileşen testine devam edin. Bkz. [Bileşen testlerini gerçekleştirme](#) sayfa 340.

## 6.2 Bileşen testlerini gerçekleştirme

### ▲ UYARI



Sıkışma tehlikesi. Hareketli parçalar organ ve uzuvların sıkışmasına ve yaralanmaya yol açabilir. Hareketli parçalara dokunmayın.

Analiz cihazını çalıştırmadan önce bileşen testlerini yapın. Bileşen çalışmasını incelemek üzere farklı analiz cihazı işlevlerini başlatmak için **Bakım** menüsünü kullanın.

#### Ön gereklilikler:

- Analiz cihazı çalışma modundaydıysa **Bakım > Start maintenance mode (Bakım modunu başlat)** ögesini seçin.
- Numune, reaktif ve çözeltili hortumlarının deiyonize su içeren bir kapta olduğundan emin olun. Bkz. [Bileşen testi için analiz cihazının bağlantısını yapın.](#) sayfa 336.

#### 6.2.1 Karıştırıcıyı inceleme

1. Işık kalkanını fotometre ünitesinden çıkarın. Bkz. [Şekil 13](#) sayfa 472.
2. Karıştırıcının numune kabının dibinde olduğundan emin olun.  
**Not:** Hazırlama prosedürü sırasında karıştırıcıyı kontrol ederek karıştırıcının düzgün şekilde döndüğünden emin olun. Hazırlama prosedürü [Pompaları ve sıkıştırma valflerini inceleme](#) sayfa 340 bölümünde açıklandığı gibi başlatılır.
3. Işık kalkanını fotometreye takın.

#### 6.2.2 Pompaları ve sıkıştırma valflerini inceleme

1. Sızıntı olmadığından emin olmak için pompaların ve sıkıştırma valflerinin çalışmasını inceleyin.
2. Analiz kabının deiyonize su ile dolu olduğundan emin olun. Bkz. [Şekil 14](#) sayfa 475.
3. Deiyonize suyun tahliye hortumundan çıktığından emin olun.
4. **Bakım > Start priming (Hazırlamayı başlat)** ögesini seçin ve tüm sıvıları ayrı ayrı hazırlayın. Bir sızıntı meydana gelirse tüm bağlantıları inceleyin ve daha fazla bilgi için çevrimici kapsamlı kullanım kılavuzuna bakın.
  - a. **Hazırlama referansı 1** ögesini seçin ardından **OK (Tamam)** ögesine basın.
  - b. **Hazırlama referansı 2** ögesini seçin ardından **OK (Tamam)** ögesine basın.
  - c. **Temizleme çözeltilisini hazırla** ögesini seçin ardından **OK (Tamam)** ögesine basın.
  - d. **Durulamaya hazırla** ögesini seçin ardından **OK (Tamam)** ögesine basın.
  - e. **Çağırıcıyı hazırla** ögesini seçin ardından **OK (Tamam)** ögesine basın.
  - f. **Kanalları hazırla > Tüm kanalları hazırla** ögesini seçin ardından **OK (Tamam)** ögesine basın.  
Prosedür tamamlandığında her bir hazırlama prosedürü otomatik olarak durdurulur.

#### 6.2.3 Mikropompaları inceleme

Mikro pompalarda sızıntı ve hava kabarcıkları olup olmadığını kontrol edin.

1. Işık kalkanını fotometreden çıkarın.
2. **Bakım > Start priming (Hazırlamayı başlat) > Tüm reaktifleri hazırla** ögesini seçin.

3. Deiyonize suyun mikropompa (reaktif) hortumlarının her birinden mikropompaya girdiğinden emin olun. Ardından, hava kabarcığı olmadan durmaksızın analiz kabına girdiğinden emin olun. Bkz. [Şekil 15](#) sayfa 475.
4. Mikropompalar düzgün çalışmıyorsa (hortumda kabarcıklar varsa) kabarcıkları gidermek için deiyonize suyu ilgili hortuma itmek üzere şırınga prosedürünü kullanın. Bkz. [Şekil 16](#) sayfa 476.
5. Işık kalkanını fotometreye takın.

#### 6.2.4 Fotometre kontrolü yapma

Kontrol işleminin başarıyla tamamlanabilmesi için fotometre kontrolünden önce analiz kabının dış kısmının temiz olduğundan emin olun. Analiz cihazı bileşenlerini temizlemeye dair daha fazla bilgi için çevrimiçi kapsamlı kullanım kılavuzuna bakın.

1. Ana menü simgesine basın ve ardından **Cihazlar** öğesini seçin.
2. **EZ2700sc** öğesini seçin.
3. Ekranın en altına inin ve ardından **Cihaz menüsü** öğesini seçin.
4. **Bakım > Fotometre kontrolü** öğesini seçin.
5. Ölçümü başlatmak için **OK (Tamam)** öğesine basın. Koyuluk kalibrasyonu tamamlandığında sonuç ekranda görüntülenir.
6. Devam etmek için **OK (Tamam)** öğesine basın.
7. "REF1" hortumunun deiyonize suyla dolu bir kaba bağlandığından emin olun. Işık kalkanının takılı olduğundan emin olun. Bkz. [Şekil 18](#) sayfa 479.
8. **OK (Tamam)** öğesine basın. Analiz kabı dolana kadar bekleyin.
9. Sensör çıkışı gerilimini 9 V olarak ayarlamak için bir tornavida kullanın. Bkz. [Şekil 17](#) sayfa 476.
10. Ekranda 9 V değeri görüntülenene kadar bekleyin. Ardından **OK (Tamam)** öğesine basın.
11. Devam etmek için **OK (Tamam)** öğesine basın.

### 6.3 Giriş sinyali testi gerçekleştirme

Analiz cihazını çalıştırmaya başlamadan önce dijital girişlerin testini gerçekleştirin.

**Ön gereklilikler:** Dijital girişleri harici bir potansiyelsiz kantağa (24 VDC) bağlayın.

Aşağıdaki gibi bir dijital giriş sinyali ve analog çıkış sinyali testi yapın:

1. Ana menü simgesine basın ve ardından **Cihazlar** öğesini seçin.
2. **EZ2700sc** öğelerini seçin.
3. Ekranın en altına inin ve ardından **Cihaz menüsü** öğesini seçin.
4. **Diagnostics (Tanılama) > Sinyaller** öğesini seçin. Dijital girişlerdeki sinyaller gösterilir.
5. Ekrandaki dijital girişlerin durumunu dijital girişlere sağlanan gerilimlerle karşılaştırın (24 V = Açık; 0 V = Kapalı).

### 6.4 Çıkış sinyali testi gerçekleştirme

Analiz cihazını çalıştırmaya başlamadan önce analog çıkışların testini gerçekleştirin.

**Ön gereklilikler:** Her bir analog çıkış tarafından temsil edilen kanal ölçümünü seçmek için analog çıkışları (AO1-AO8, P101) yapılandırın. Daha fazla bilgi için çevrimiçi kapsamlı kullanım kılavuzuna bakın.

Analog çıkış sinyali testini aşağıda belirtildiği gibi yapın:

1. Ana menü simgesine basın.
2. **Çıkışlar > mA çıkışları AOC > Test/Bakım** ögesini seçin.

Seçenek	Açıklama
İşlev testi	Seçili modüldeki çıkışlarda bir test yapar.
Çıkış durumu	Seçili modüldeki çıkışların durumlarını gösterir.

3. Her analog çıkıştaki mA değerini ölçmek için bir avometre kullanın.
4. Analog çıkışlarda ölçülen mA değerini beklenen mA değerleriyle karşılaştırın.

## 6.5 Kanal sırasını ayarlama




Kanalların ölçülme sırasını, her kanalın kaç kez ölçüleceğini ve bir kanal ölçülmeden önceki bekleme süresini seçin. Her biri en fazla 16 döngü olan en fazla 16 satır girin.

1. Ana menü simgesine basın ve ardından **Cihazlar** ögesini seçin.
2. **EZ2700sc** ögesini seçin.
3. Ekranın en altına inin ve ardından **Cihaz menüsü** ögesini seçin.
4. Analiz cihazı çalışma modundaydı **Bakım > Start maintenance mode (Bakım modunu başlat)** ögesini seçin.  
Analiz cihazının bakım moduna girmesini bekleyin.
5. **Yapılandırma > Kanal sıra ayarı** ögesini seçin.
6. Bir konum (sıradaki sayı) seçmek için yan çubuktaki okları kullanın, ardından bu konumu yapılandırmak için **OK (Tamam)** ögesine basın.
7. Bir seçenek belirleyin.

Seçenek	Açıklama
Seç	Geçerli kanalı veya bekleme süresini seçer.
Number of measurements (Ölçüm sayısı)	Kanal için ölçüm sayısını ayarlar.
Bekleme süresi	Seçilen kanal için bekleme süresini ayarlar.

8. Değişiklikleri kaydetmek için **OK (Tamam)** ögesine basın.

## 6.6 Çözeltileri ve numuneyi yerleştirme

▲ DİKKAT	
	Kimyasal maddelere maruz kalma tehlikesi. Laboratuvar güvenlik talimatlarına uyun ve kullanılan kimyasallara uygun tüm kişisel koruma ekipmanlarınızı kullanın. Güvenlik protokolleri için mevcut güvenlik veri sayfalarına (MSDS/SDS) başvurun.
▲ DİKKAT	
	Kimyasal maddelere maruz kalma tehlikesi. Kimyasal maddeleri ve atıkları yerel, bölgesel ve ulusal yönetmeliklere uygun şekilde atın.
▲ DİKKAT	
	Yangın tehlikesi. Bu ürün yanıcı sıvılarla kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

Reaktif kapları analiz cihazıyla birlikte verilir. Bkz. [Şekil 18](#) sayfa 479. Referans 1 çözeltisi ve Referans 2 çözeltisi ve deiyonize su için kaplar kullanıcı tarafından temin edilir. Üreticiden daha fazla kap satın alınabilir.

## Kapları

- analiz cihazının mümkün olduğunca yakınına
- analiz cihazının tabanının 1 metre altına yerleştirin

Kabın takılması için bkz. [Şekil 18](#) sayfa 479.

Reaktifler ve çözeltiler kullanıcı tarafından tedarik edilir. Yalnızca sertifikalı bir şirket tarafından sağlanan reaktifleri veya üreticiye özel reaktifleri kullanın. Alternatif olarak reaktifler kullanıcı tarafından hazırlanabilir. Üreticinin web sitesinde bulunan ilgili model için Yöntem ve Reaktif Sayfasındaki talimatları izleyin.

Hortumlar fabrikada takılır. Hortumların üzerindeki etiketleri okuyarak doğru tesisat bağlantılarını belirleyin. Doğru reaktifler, çözeltiler ve standartlar için üreticinin web sitesinde bulunan model ile ilgili Yöntem ve Reaktif Sayfasına bakın.

1. Bileşen testleri tamamlandıktan sonra, "CLEAN" (temizleme çözeltisi), "REF1" (Referans 1 çözeltisi) ve "REF2" (Referans 2 çözeltisi) hortumlarını ilgili kaplara takın. Bkz. [Şekil 18](#) sayfa 479.
2. Renk kodlu her bir reaktif hortumunu, etiketinde aynı renk bulunan reaktif kabına yerleştirin.
3. Numune kaynağını (veya Moduplex panelinin ya da filtre panelinin numune çıkışı) analiz cihazının numune giriş hortumuna bağlayın. Bkz. [Şekil 18](#) sayfa 479.
4. Ana menü simgesine basın ve ardından **Cihazlar** öğesini seçin.
5. **EZ2700sc** öğesini seçin.
6. Ekranın en altına inin ve ardından **Cihaz menüsü** öğesini seçin.
7. **Bakım > Start priming (Hazırlamayı başlat) > Tümünü hazırla** öğesini seçin.

## 6.7 İlk başlatmadan önce doğrulama yapma

Ölçümlerin tolerans aralığı içinde olduğundan emin olmak için doğrulama yapın. Daha fazla bilgi için çevrimiçi kapsamlı kullanım kılavuzuna bakın.

1. Ana menü simgesine basın ve ardından **Cihazlar** öğesini seçin.
2. **EZ2700sc** öğesini seçin.
3. Ekranın en altına inin ve ardından **Cihaz menüsü** öğesini seçin.
4. Doğrulamayı başlatmak için **Kalibrasyon > Validation (Doğrulama) > Doğrulamayı başlat** öğesini seçin.  
Doğrulamada Referans 2 şişesindeki deiyonize su ölçülür.
5. Sonuçları göstermek için bir seçenek belirleyin:
  - **Kalibrasyon > Validation (Doğrulama) > Validation history (Doğrulama geçmişi)**
  - **Diagnostics (Tanılama) > Geçmiş veriler > Validation (Doğrulama)**

## 6.8 Analiz cihazını başlatma

Analiz cihazını başlatmak için:

1. Ana menü simgesine basın ve ardından **Cihazlar** öğesini seçin.
2. **EZ2700sc** öğesini seçin.
3. Ekranın en altına inin ve ardından **Cihaz menüsü** öğesini seçin.
4. **Bakım > Start operational mode (Çalışma modunu başlat)** öğesini seçin.

## Obsah

- 1 [Ďalšie informácie](#) na strane 344
- 2 [Opis výrobku](#) na strane 344
- 3 [Technické údaje](#) na strane 345

- 4 [Všeobecné informácie](#) na strane 346
- 5 [Inštalácia](#) na strane 348
- 6 [Spustenie do prevádzky](#) na strane 357

## Odsek 1 Ďalšie informácie

Základná používateľská príručka obsahuje informácie, ktoré sú dostatočné na uvedenie do prevádzky. Rozšírená používateľská príručka je k dispozícii online a obsahuje ďalšie informácie.

### ⚠ NEBEZPEČIE



Viacnásobné nebezpečenstvo! Ďalšie informácie sú uvedené v jednotlivých častiach rozšírenej používateľskej príručky, ktoré sú zobrazené nižšie.

- Používateľské rozhranie a navigácia
- Prevádzka
- Údržba
- Odstránenie porúch
- Zoznamy náhradných dielov

Naskenujte nasledujúce kódy QR a prejdite na rozšírenú používateľskú príručku.



Európske jazyky



Americké a ázijské jazyky

## Odsek 2 Opis výrobku

Analýzátor Hach EZ2700sc je online analyzátor, ktorý meria jeden parameter vo vzorkách vody z priemyselných a environmentálnych aplikácií. Pozri [Obrázok 1](#) na strane 439, [Obrázok 2](#) na strane 444 a [Obrázok 3](#) na strane 448.

Analýzátor je online kolorimetrický analyzátor na základnú analýzu vody (napr. dusičnany, fosforečnany). Analyzátor má možnosti vzdialeného spustenia, automatickej validácie, automatickej kalibrácie, automatického čistenia a Modbusu.

Voda vzorky vstupuje do analyzátora cez hadičku na vzorku. Čerpadlá, ventily a striekačky v analyzátore posúvajú vzorku a reagentie do meracej kvety na analytickom paneli. Po dokončení procesu analýzy v nádobe analyzátor zlikviduje vzorku cez odtokovú hadičku. Výsledky analýzy sa zobrazia na displeji kontroléra SC4500. Kontrolér SC4500 ukladá údaje analyzátora (protokol údajov, protokol udalostí, nastavenia protokolu a servisný protokol). Na ovládanie a konfiguráciu analyzátora použite kontrolér SC4500.

Ak chcete zvýšiť počet prúdov vzoriek (kanálov), ktoré môže analyzátor merať (2, 4 alebo 8), zakúpte si k analyzátoru panel Moduplex s viacerými prúdmi.

Na predprípravu vzorky (filtrácia, usadzovanie) si k analyzátoru zakúpte filtračný panel EZ9010, EZ9020, EZ9150, EZ9200 alebo EZ9250.

## Odsek 3 Technické údaje

Technické údaje podliehajú zmenám bez upozornenia.

Technický údaj	Podrobnosti
Rozmery (Š x V x H)	460 x 688 x 340 mm (18,1 x 27,1 x 13,4 palca)
Kryt	IP44; ABS, PMMA a oceľ s povrchovou úpravou
Displej	IP66, 3,5-palcový farebný displej TFT s kapacitnou dotykovou klávesnicou
Hmotnosť	40 kg (88 libier)
Požiadavky na napájanie	100 až 240 V AC $\pm 10$ %, 50/60 Hz
Príkon	240 VA maximálny
Nadmorská výška	Maximálne 2000 m (6560 ft)
Kategória prepätia	II
Podmienky okolitého prostredia	Len na použitie vnútri
Stupeň znečisťovania	2
Prevádzková teplota	10 až 30 °C (50 až 86 °F); 5 až 95 % relatívna vlhkosť, nekondenzujúca, nekorozívna
Teplota skladovania	-20 až 60 °C (-4 až 140 °F), 95 % relatívna vlhkosť, nekondenzujúca, max.
Vstupy vzorky	Jeden
Tlak vzorky	Pomocou externej prietokovej nádoby (otvorenej na atmosférický tlak)
Rýchlosť prietoku vzorky	100 až 300 mL/min
Teplota vzorky	10 až 30 °C (50 až 86 °F)
Kvalita vzorky	< 100 $\mu$ m častice, maximálne < 0,1 g/L Turbidita < 50 NTU
Preplachovanie vzduchom pre korozívne prostredia	0,2 baru (20 kPa alebo 3 psi); suchý a čistý vzduch
Odtok	Atmosférický tlak, ventilovaný, min. $\varnothing$ 32 mm
Uzemňovacia prípojka	Suchá a čistá uzemňovacia lišta s nízkou impedanciou (< 1 $\Omega$ ) s uzemneným káblom > 2,5 mm <sup>2</sup> (13 AWG)
Analogové výstupy	Maximálne osem analogových výstupov 0 – 20 mA (alebo 4 – 20 mA) <b>Poznámka:</b> Napájanie slučky zabezpečujú analogové výstupy. Napájanie nie je možné priviesť do kontaktov systému SCADA alebo PLC.
Digitálne vstupy	Sedem digitálnych vstupov: dva digitálne vstupy na diaľkové spustenie. Zvyšné digitálne vstupy sú určené na budúce použitie.
Digitálne výstupy	Štyri digitálne výstupy pod napätím pre ventily a čerpadlá panela EZ9150; osem digitálnych výstupov pod napätím pre ventily panela Moduplex; 24 V DC, 500 mA.
Relé	Päť bezpotenciálových kontaktov (FCT), maximálne zaťaženie 24 V jednosmerné, 0,5 A (odporová záťaž)
Ethernetové pripojenia	Ethernetové pripojenie Claros a ethernetový konektor Modbus TCP/IP; verzia LAN; 10/100 Mb/s alebo Profinet, alebo Ethernet IP
Komunikácia RS485	Profibus DP alebo Modbus RTU

SK

<sup>2</sup> Informácie o konfigurácii siete Ethernet a konfigurácii Modbus nájdete v dokumentácii ku kontroléru SC4500.

Technický údaj	Podrobnosti
Certifikáty	S certifikátom CE, ETL vzhľadom na bezpečnostné normy UL a CSA, UKCA
Záruka	1 rok (EÚ: 2 roky)

## Odsek 4 Všeobecné informácie

Za žiadnych okolností výrobca nebude niesť zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním produktu alebo nedodržaním pokynov v príručke. Výrobca si vyhradzuje právo na vykonávanie zmien v tomto návode alebo na predmetnom zariadení kedykoľvek, bez oznámenia alebo záväzku. Revidované vydania sú k dispozícii na webových stránkach výrobcu.

### 4.1 Bezpečnostné informácie

Výrobca nie je zodpovedný za škody spôsobené nesprávnym alebo chybným používaním tohto zariadenia vrátane, okrem iného, priamych, náhodných a následných škôd, a odmieta zodpovednosť za takéto škody v plnom rozsahu povolenom príslušným zákonom. Používateľ je výhradne zodpovedný za určenie kritického rizika pri používaní a zavedenie náležitých opatrení na ochranu procesov počas prípadnej poruchy prístroja.

Pred vybalením, nastavením alebo prevádzkou tohto zariadenia si prečítajte celý návod. Venujte pozornosť všetkým výstrahám a upozorneniam na nebezpečenstvo. Zanedbanie môže mať za následok vznik vážnych zranení obsluhy alebo poškodenie zariadenia.

Ak sa zariadenie používa spôsobom, ktorý nie je špecifikovaný výrobcom, môže dôjsť k narušeniu ochrany poskytovanej zariadením. Nepoužívajte ani neinštalujte toto zariadenie spôsobom iným, než sa uvádza v tomto návode.

#### 4.1.1 Informácie o možnom nebezpečenstve

##### ▲ NEBEZPEČIE

Označuje potenciálne alebo bezprostredne nebezpečnú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, spôsobí smrť alebo vážne zranenie.

##### ▲ VAROVANIE

Označuje potenciálne alebo bezprostredne nebezpečnú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, by mohla spôsobiť smrť alebo vážne zranenie.

##### ▲ UPOZORNENIE

Označuje potenciálne ohrozenie s možným ľahkým alebo stredne ťažkým poranením.

##### POZNÁMKA

Označuje situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, môže spôsobiť poškodenie prístroja. Informácie, ktoré vyžadujú zvýšenú pozornosť.

#### 4.1.2 Výstražné štítky





Preštudujte si všetky štítky a značky, ktoré sa nachádzajú na zariadení. Pri nedodržaní pokynov na nich hrozí poranenie osôb alebo poškodenie prístroja. Symbol na prístroji je vysvetlený v príručke s bezpečnostnými pokynmi.




Toto je výstražný symbol týkajúci sa bezpečnosti. Aby ste sa vyhli prípadnému zraneniu, dodržte všetky bezpečnostné pokyny, ktoré nasledujú za týmto symbolom. Tento symbol vyznačený na prístroji, odkazuje na návod na použitie, kde nájdete informácie o prevádzke alebo bezpečnostné informácie.







Tento symbol označuje chemické nebezpečenstvo a znamená, že manipulovať s chemikáliami a vykonávať údržbu systémov dodávania chemických látok, ktoré sú súčasťou zariadenia, môžu jedine kvalifikované osoby vyškolené v oblasti práce s chemikáliami.

	Tento symbol indikuje, že hrozí riziko zásahu elektrickým prúdom a/alebo možnosť usmernenia elektrickým prúdom.
	Tento symbol indikuje prítomnosť zariadení citlivých na elektrostatické výboje (ESD) a upozorňuje na to, že je potrebné postupovať opatrne, aby sa vybavenie nepoškodilo.
	Tento symbol indikuje, že označená položka si vyžaduje ochranné uzemňovacie zapojenie. Ak sa zariadenie nedodáva s uzemnenou zástrčkou na šnúre, ochranné uzemňovacie zapojenie vytvorte prepojením so svorkovnicami ochranného vodiča.
	Elektrické zariadenie označené týmto symbolom sa v rámci Európy nesmie likvidovať v systémoch likvidácie domového alebo verejného odpadu. Staré zariadenie alebo zariadenie na konci životnosti vráťte výrobcovi na bezplatnú likvidáciu.

#### 4.1.3 Chemická a biologická bezpečnosť

<b>⚠ NEBEZPEČIE</b>	
	Chemické alebo biologické nebezpečenstvá. Ak sa tento prístroj používa na monitorovanie procesu úpravy a/alebo systému na dávkovanie chemických látok, pre ktoré existujú regulačné limity a požiadavky na monitorovanie spojené s verejným zdravím, bezpečnosťou, výrobou jedla alebo nápojov alebo ich spracovaním, je zodpovednosťou používateľa tohto prístroja poznať príslušné predpisy, riadiť sa nimi a mať dostatočné a osvedčené mechanizmy v súlade s príslušnými predpismi v prípade poruchy prístroja.

#### 4.2 Ikony použité na ilustráciách

			
Diely dodané výrobcom	Diely dodané užívateľom	Pozrite si	Vykonajte postup v opačnom poradí

				
Zapojte dvoch ľudí	Vypočujte si	Používajte iba prsty	Nepoužívajte nástroje	Nedotýkajte sa ho

#### 4.3 Účel použitia

Analyzátory Hach radu EZ sú určené na použitie osobami, ktoré musia kontinuálne merať parametre kvality vody vo vzorkách z priemyselných a environmentálnych aplikácií. Analyzátory Hach radu EZ neošetrujú ani nemenia vodu a nepoužívajú sa na kontrolné postupy.

#### 4.4 Komponenty produktu

Uistite sa, že vám boli doručené všetky súčasti. Pozri **Obrázok 4** na strane 453. Ak nejaká položka chýba alebo je poškodená, okamžite kontaktujte výrobcu alebo obchodného zástupcu.

## Odsek 5 Inštalácia

### ⚠ NEBEZPEČIE



Viacnásobné nebezpečenstvo. Úkony popísané v tejto časti návodu smú vykonávať iba kvalifikovaní pracovníci.

### 5.1 Pokyny na inštaláciu

#### ⚠ VAROVANIE



Nebezpečenstvo vzniku požiaru. Za vykonanie primeraných opatrení v rámci metód použitia, pri ktorých sa používajú horľavé kvapaliny, zodpovedá používateľ. Uistite sa, že dodržiavate správne používateľské pokyny a bezpečnostné protokoly. To zahŕňa (nie však výhradne) kontroly úniku kvapalín a tesnenia, zaistenie správnej ventilácie, zabránenie bezobslužnému používaniu a ubezpečenie sa, že nástroj pripojený k napájaniu nikdy nezostane bez dozoru.

#### ⚠ UPOZORNENIE



Nebezpečenstvo expozície chemikáliám. Dodržiavajte laboratórne bezpečnostné postupy a používajte všetky osobné ochranné pomôcky zodpovedajúce chemikáliám, s ktorými pracujete. Bezpečnostné protokoly nájdete v aktuálnych kartách bezpečnostných údajov (KBU).

#### ⚠ UPOZORNENIE



Nebezpečenstvo expozície chemikáliám. Chemikálie a odpad likvidujte podľa miestnej, regionálnej a štátnej legislatívy.

- Analyzátor inštalujte vnútri miestnosti, mimo rizikového prostredia.
- Analyzátor inštalujte v prostredí, ktoré je chránené pred korozívnymi tekutinami.
- Analyzátor inštalujte na čistom, suchom, dobre odvetrávanom mieste s reguláciou teploty.
- Analyzátor inštalujte čo možno najbližšie k miestu odberu vzoriek.
- Analyzátor nemontujte na mieste s priamym slnečným svetlom ani v blízkosti zdroja tepla.
- Uistite sa, že máte dostatočný odstup na montáž a elektrické pripojenia.
- Pred analyzátorom ponechajte dostatočný priestor na otvorenie dvierok analyzátora. Pozri [Rozmery analyzátora](#) na strane 349.
- Uistite sa, že sa podmienky prostredia nachádzajú v rámci prevádzkových technických údajov. Pozri [Technické údaje](#) na strane 345.

Hoci analyzátor nie je určený na použitie s horľavými vzorkami, niektoré analyzátory EZ používajú horľavé reagensy. Ďalšie informácie o reagensoch používaných v analyzátore nájdete v metodickom a reagenčnom hárku príslušného modelu série EZ. Ak analyzátor používa horľavé reagensy, dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia:


- Udržiavajte analyzátor v bezpečnej vzdialenosti od horúčavy, iskier a otvoreného plameňa.
- V blízkosti analyzátora nejedzte, nepite ani nefajčite.
- Používajte miestny odvodušňovací vetrací systém.
- Používajte spotrebiče a osvetľovací systém odolné voči iskrám a výbuchu.
- Zabráňte elektrostatickým výbojom. Pozri [Upozornenia na elektrostatické výboje](#) na strane 349.
- Pred použitím prístroj dôkladne vyčistite a osušte.
- Umyte si ruky pred prestávkami a na konci pracovnej doby.
- Odstráňte kontaminovaný odev. Pred ďalším použitím si umyte ruky.
- S týmito tekutinami sa musí zaobchádzať podľa požiadaviek miestnych regulačných orgánov na prípustné limity expozície.


## 5.2 Rozmery analyzátora


Rozmery analyzátora uvádza [Obrázok 5](#) na strane 454.

## 5.3 Mechanická montáž

### 5.3.1 Montáž prístroja na stenu

▲ VAROVANIE	
	Nebezpečenstvo poranenia osôb. Uistite sa, že pri montáži na stenu táto vydrží 4-násobnú hmotnosť zariadenia.

▲ VAROVANIE	
	Nebezpečenstvo poranenia osôb. Prístroje alebo komponenty sú ťažké. Pri inštalácii alebo premiestňovaní požiadajte o pomoc ďalšie osoby.

▲ VAROVANIE	
	Nebezpečenstvo poranenia osôb. Objekt je ťažký. Na zaistenie bezpečnej prevádzky sa ubezpečte, že je nástroj bezpečne pripavený na stenu, stôl alebo podlahu.

Pomocou dodaných montážnych konzol pripevnite prístroj zvislo a vodorovne na rovný, zvislý povrch steny. [Obrázok 6](#) na strane 456

Prístroj nainštalujte na takom mieste a v takej polohe, aby ho používateľ mohol ľahko odpojiť od zdroja napájania.

Uistite sa, že máte dostatočný odstup od analyzátora na inštaláciu fliaš.

Montážne vybavenie zabezpečí používateľ. Uistite sa, že upevnenie na stenu má dostatočnú nosnosť (približne 160 kg alebo 353 libier). Montážne vybavenie musí byť schválené pre vlastnosti steny.


### 5.3.2 Otvorte dvere analyzátora

Pomocou dodaného kľúča odblokujte dva zámky na strane analyzátora. Pozri [Obrázok 7](#) na strane 456. Pred prevádzkou nezabudnite zatvoriť dvierka, aby ste zachovali stupeň environmentálnej ochrany krytu a bezpečnostnú klasifikáciu.

## 5.4 Elektrická inštalácia

▲ NEBEZPEČIE	
	Nebezpečenstvo smrteľného úrazu elektrickým prúdom. Pred vykonaním elektrických pripojení vždy odpojte zariadenie od napájania.

### 5.4.1 Upozornenia na elektrostatické výboje

POZNÁMKA	
	Nebezpečenstvo poškodenia zariadenia. Elektrostatický výboj môže poškodiť jemné elektronické súčiastky vo vnútri zariadenia a spôsobiť tak jeho obmedzenú funkčnosť alebo poruchu.

Aby ste predišli poškodeniu prístroja elektrostatickými výbojmi, postupujte podľa krokov tohto postupu:

- Dotknite sa uzemneného kovového povrchu, ako je napríklad kostra prístroja, kovová trubička alebo rúra, aby ste vybili statickú elektrinu z telesa prístroja.

- Vyhýbajte sa nadmernému pohybu. Premiestňujte staticky citlivé súčasti v antistatických nádobách alebo baleniach.
- Majte nasadené západné pútko pripojené káblom k uzemneniu.
- Pracujte v staticky bezpečnom prostredí s antistatickým podlahovým čalúnením a čalúnením na pracovných stoloch.

#### 5.4.2 Prístup k elektrickým pripojeniam

Káble externých zariadení prestrčte cez káblové priechodky. Pozri **Obrázok 8** na strane 459. Kryty káblových priechodiek, ktoré sa nepoužívajú, si ponechajte.

**Obrázok 9** na strane 461 zobrazuje komponenty vnútri analyzátoru. Hlavný vypínač je istič, ktorý automaticky vypne hlavné napájanie z elektrického vedenia striedavého prúdu, ak sa vyskytne stav nadmerného prúdu (napr. skrat) alebo prepätia.

#### 5.4.3 Pripojenie externých zariadení

Externé zariadenia, ktoré sa budú používať s analyzátorom, pripojte k signálnym a ovládacím svorkám analyzátoru. Pozrite **Obrázok 10** na strane 466 a **Tabuľka 1** na strane 350.

**Tabuľka 1 Signálne a ovládacie svorky – opisy**

Kolík	Opis
AO1 – AO8 (P101)	Osem analógových výstupov na ovládanie externých zariadení. Viac informácií nájdete v rozšírenej verzii používateľskej príručky online.
FCT1 – FCT5 (P102)	Päť relé (bezpotenciálové kontakty). Maximálne zaťaženie je 24 V DC, 0,5 A. <ul style="list-style-type: none"> <li>• FCT1 – alarm poruchy</li> <li>• FCT2 – alarm údržby</li> <li>• FCT3 – analyzátor je pripravený</li> <li>• FCT4 a FCT5 – na budúce použitie</li> </ul>
DI1 – DI7 (P103)	Sedem digitálnych vstupov na diaľkové ovládanie analyzátoru <sup>5</sup> Digitálne vstupy pripojte k externému bezpotenciálovému kontaktu (24 V DC), aby sa zapol analyzátor a spustil meranie v danom kanáli. <ul style="list-style-type: none"> <li>• DI1 – diaľkové spustenie pre kanál 1</li> <li>• DI2 – diaľkové spustenie pre kanál 2</li> <li>• DI3 až DI7 – na budúce použitie</li> </ul>
FB1 – FB4 (P104)	Konektory Profibus DP alebo Modbus RTU (RS485) <p><b>Profibus DP:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FB1 – A1 (vstup)</li> <li>• FB2 – A2 (výstup)</li> <li>• FB3 – B1 (vstup)</li> <li>• FB4 – B2 (výstup)</li> <li>• SHL – kryt</li> </ul> <p><b>Modbus RTU:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FB1 – D (+)</li> <li>• FB2 – D (-)</li> <li>• FB3 – nepoužíva sa</li> <li>• FB4 – nepoužíva sa</li> <li>• SHL – kryt</li> </ul> <p>Pokyny na konfiguráciu Modbus a značky telegramov nájdete v dokumentácii ku kontroléru SC4500.</p>
24 V DC/1 A (P105)	Napájanie 24 V DC pre filtračné jednotky EZ9010 a EZ9020

<sup>5</sup> Ak je analyzátor v režime údržby, diaľkové ovládanie je deaktivované.

**Tabuľka 1 Signálne a ovládacie svorky – opisy (pokračovanie)**

Kolík	Opis
STR1 – STR8 (P106)	Osem digitálnych výstupov pre voliteľný panel Moduplex. Holé vodiče každého kanálového ventilu na paneli Moduplex pripojte k príslušným konektorom STR. <ul style="list-style-type: none"> <li>• STR1 – kanál 1</li> <li>• STR2 – kanál 2</li> <li>• ...</li> <li>• STR8 – kanál 8</li> </ul>
EXT9 – EXT12 (P107)	Štyri digitálne výstupy pre voliteľný filtračný panel EZ9150. Elektrické ventily a čerpadlo na filtračnom paneli EZ9150 pripojte ku konektorom EXT. <ul style="list-style-type: none"> <li>• EXT9 – ventil oplachovania</li> <li>• EXT10 – ventil spätného preplachovania</li> <li>• EXT11 – vypúšťací prepadový ventil</li> <li>• EXT12 – filtračné čerpadlo</li> </ul>
D01 – D06 (P108 a P109)	Šesť pneumatických ventilov výstupu pre panel EZ9150. <ul style="list-style-type: none"> <li>• D01 — uzavierací ventil vzorky</li> <li>• D02 — odtok prepadového ventilu</li> <li>• D03 — ventil kanála 1</li> <li>• D04 — ventil kanála 2</li> <li>• D05 — ventil kanála 3</li> <li>• D06 — ventil kanála 4</li> </ul>

SK

#### 5.4.4 Zapojenie do elektrickej siete so striedavým prúdom

### ⚠ NEBEZPEČIE



Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom a vzniku požiaru. Ubezpečte sa, že dodaná prírodná šnúra a zástrčka bez poistky spĺňajú predpisy danej krajiny.


- Uistite sa, že na vedení je nainštalovaný istič s dostatočnou kapacitou elektrického prúdu.
- Skontrolujte, či je v blízkosti analyzátora nainštalovaný istič alebo núdzový vypínač, aby bolo možné analyzátor v prípade potreby okamžite odpojiť od napájania.
- Prístroj pripojte v súlade s miestnymi, štátnymi alebo vnútroštátnymi elektrickými predpismi.
- Dodaný napájací kábel nainštalujte cez káblovú priechodku, ktorá je na boku analyzátora.
- Uťahnite káblovú priechodku, aby pevne držala napájací kábel a zachovala ekologickú triedu krytu.

Analyzátor pripojte k napájaniu striedavým prúdom pomocou dodaného sieťového kábla. Pozri **Tabuľka 2** na strane 352 a **Obrázok 11** na strane 468.

## POZNÁMKA

Hlavný vypínač nenastavujte do polohy zapnutia. Pred spustením dokončite všetky elektrické a montážne pripojenia, pretože v opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu analyzátora.

**Tabuľka 2 Informácie o rozvodoch – napájanie striedavým prúdom**

Svorka	Opis	Farba kábla - Severná Amerika a Kanada	Farba kábla - EÚ
L	Pod prúdom/vedenie (L)	Čierna (1)	Hnedá
N	Neutrálny vodič (N)	Biela (2)	Modrá
	Ochranné uzemnenie (PE)	Zelená so žltým pruhom	Zelená so žltým pruhom

## 5.5 Montáž

### 5.5.1 Pokyny k odberu vzorky

#### ▲ UPOZORNENIE



Nebezpečenstvo vzniku požiaru. Tento výrobok nie je určený na použitie s horľavými vzorkami.

Výberom vhodného a reprezentatívneho miesta odberu vzoriek zabezpečte maximálny výkon prístroja. Vzorka musí zastupovať celý systém.

- Uistite sa, že prietok vzorky je vyšší ako prietok analyzátora.
- Uistite sa, že hadička na vzorky je pri atmosférickom tlaku, ak analyzátor používa peristaltické čerpadlo na pohyb vzorky do analytickej nádoby.
- Uistite sa, že hadička na vzorky odoberá vzorku z malej prietokovej nádoby v blízkosti analyzátora.
- Použite dodanú hadičku so vzorkou. Nemeňte dĺžku hadičky so vzorkou.

Vzorka v prietokovej nádobe sa musí nepretržite obnovovať. Ak je veľkosť tuhých častíc vo vzorke príliš veľká, odporúča sa aj filtrácia vzorky.

### 5.5.2 Pokyny na použitie odtokovej hadičky

#### ▲ VAROVANIE



Nebezpečenstvo vzniku požiaru. Za vykonanie primeraných opatrení v rámci metód použitia, pri ktorých sa používajú horľavé kvapaliny, zodpovedá používateľ. Uistite sa, že dodržiavate správne používateľské pokyny a bezpečnostné protokoly. To zahŕňa (nie však výhradne) kontroly úniku kvapalín a tesnenia, zaistenie správnej ventilácie, zabránenie bezobslužnému používaniu a ubezpečenie sa, že nástroj pripojený k napájaniu nikdy nezostane bez dozoru.

#### ▲ UPOZORNENIE



Nebezpečenstvo expozície chemikáliám. Chemikálie a odpad likvidujte podľa miestnej, regionálnej a štátnej legislatívy.

## POZNÁMKA

Nepripájajte odtokovú hadičku k iným hadičkám, pretože by mohol v analyzátore vzniknúť spätný tlak alebo by sa analyzátor mohol poškodiť. Uistite sa, že sú odtokové vedenia otvorené a odvetrané.

## POZNÁMKA

Aby sa predišlo spätnému tlaku do analyzátoru a jeho poškodeniu, zabezpečte, aby bol analyzátor umiestnený vyššie ako laboratórne odtoky a odtokové vedenie malo konštantný spád nadol. Nainštalujte odtokové hadičky s vertikálnym sklonom 2,54 cm (1 palec) alebo viac na každých 0,3 m (1 stopa) dĺžky hadičky.

Analyzátor používa odtokovú hadičku na vypustenie vzorky a reagencií po analýze. Je dôležité, aby bola odtoková hadička správne nainštalovaná. Zaisťte sa tým, že všetka kvapalina bude z prístroja odstránená. Nesprávna montáž môže spôsobiť spätné vtekanie kvapaliny do prístroja a viesť tak k poškodeniam. Pre odtokovú hadičku je vhodný odtok v podlahe alebo výlevka. Odporúčany vonkajší priemer odtokovej hadičky je 32 mm. Pozri **Obrázok 12** na strane 471.

- Odtoková hadička má byť čo možno najkratšia.
- Uistite sa, že odtok je nižšie ako analyzátor.
- Zabezpečte, aby mala odtoková hadička konštantný sklon nadol.
- Uistite sa, že sa na odtokovej hadičke nenachádzajú prudké ohyby a že nie je nijak stlačená.
- Uistite sa, že je odtoková hadička otvorená, má voľný koniec a že nie je pod žiadnym tlakom.
- Uistite sa, že odtokové hadičky sú uzavreté voči okolitému prostrediu v miestnosti montáže.
- Nezapchávajújte ani neponárajte odtokovú hadičku.

Odporúčame aj prípojku vody v blízkosti analyzátoru, aby sa výlevka a hadička na odpad pravidelne premývali čistou vodou, čím sa predídte upchatiu spôsobenému kryštalizáciou.

Ďalšie informácie o reagenčiách používaných v analyzátoch nájdete v metodickom a reagenčnom hárku príslušného modelu série EZ. Ak analyzátor používa horľavé reagenty, dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

- Nemontujte odtokovú hadičku do podlahového odtoku.
- Odpad likvidujte v súlade s miestnymi, štátnymi a národnými environmentálnymi predpismi.

### 5.5.3 Pokyny na použitie odvzdušňovacej hadičky

#### ▲ VAROVANIE



Nebezpečenstvo vzniku požiaru. Za vykonanie primeraných opatrení v rámci metód použitia, pri ktorých sa používajú horľavé kvapaliny, zodpovedá používateľ. Uistite sa, že dodržiavate správne používateľské pokyny a bezpečnostné protokoly. To zahŕňa (nie však výhradne) kontroly úniku kvapalín a tesnenia, zaistenie správnej ventilácie, zabránenie bezobslužnému používaniu a ubezpečenie sa, že nástroj pripojený k napájaniu nikdy nezostane bez dozoru.

#### ▲ UPOZORNENIE



Nebezpečenstvo expozície chemikáliám. Chemikálie a odpad likvidujte podľa miestnej, regionálnej a štátnej legislatívy.

## POZNÁMKA

Nepripájajte odvzdušňovaciu hadičku (port pre výfukové plyny) k iným hadičkám, pretože by mohol v analyzátoch vzniknúť spätný tlak alebo by sa analyzátor mohol poškodiť. Uistite sa, že odvzdušňovacia hadička je na vývode plynov von z budovy otvorená pre vzduch.

## POZNÁMKA

Aby sa predišlo spätnému tlaku do analyzátoru a jeho poškodeniu, zabezpečte, aby bol analyzátor umiestnený vyššie ako laboratórne odvzdušňovacie hadičky a odvzdušňovacia hadička mala konštantný spád nadol. Nainštalujte odvzdušňovaciu hadičku s vertikálnym sklonom 2,54 cm (1 palec) alebo viac na každých 0,3 m (1 stopa) dĺžky hadičky.

Analyzátor používa vetraciu hadičku na udržiavanie atmosférického tlaku v analytickej nádobe. Správna inštalácia vetracej hadičky je dôležitá, aby sa počas prevádzky čerpadla nedostala z vetracej hadičky do analytickej nádoby žiadna kvapalina. Nesprávna montáž môže spôsobiť spätné

prúdenie plynu do analyzátoru a spôsobiť poškodenie. Odporúčaný vonkajší priemer zbernej časti odvodušňovacej hadičky je 32 mm. Pozri [Obrázok 12](#) na strane 471.

- Odvodušňovacia hadička má byť čo možno najkratšia.
- Zabezpečte, aby mala odvodušňovacia hadička konštantný sklon nadol.
- Uistite sa, že sa na odvodušňovacej hadičke nenachádzajú prudké ohyby a že nie je nijak stlačená.
- Uistite sa, že odvodušňovacia hadička je uzavretá voči okolitému prostrediu v miestnosti montáže a má nulový tlak.
- Skontrolujte, či je odvodušňovacia hadička vždy vyššie ako odtok.
- Nezapchávejte ani neponárajte odvodušňovaciu hadičku.

Ak analyzátor používa horľavé reagenty, dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

- Nemontujte odvodušňovaciu hadičku do podlahového odtoku.
- Odpad likvidujte v súlade s miestnymi, štátnymi a národnými environmentálnymi predpismi.

#### 5.5.4 Pripojte analyzátor na test komponentov



### ▲ UPOZORNENIE



Nebezpečenstvo vzniku požiaru. Tento výrobok nie je určený na použitie s horľavými kvapalinami.

Pred uvedením analyzátoru so všetkými reagentami do prevádzky sa musí vykonať test komponentov s deionizovanou vodou. Pozrite si ilustrovaný postup a [Vykonanie testov komponentov](#) na strane 358.

1. Nainštalujte štyri hadičky škrtiaceho ventilu, ako je znázornené v nasledujúcom kroku 1.
  - a. Stlačte čierne tlačidlo a potom zasuňte hadičku do ventilu.
  - b. Keď je hadička správne nainštalovaná, uvoľnite tlačidlo.
2. Skontrolujte, či je odtoková hadička správne nainštalovaná v nádobe na vzorky. Pozrite si nasledujúci ilustrovaný postup č. 2.
3. Skontrolujte, či sú hadičky mineralizátora správne nainštalované v nádobe mineralizátora. Pozrite si nasledujúci ilustrovaný postup č. 3.
4. Všetky hadičky analyzátoru kvapaliny pripojte k veľkej fľaši s deionizovanou vodou a vykonajte test komponentov. Pozrite si nasledujúci ilustrovaný postup č. 3. Hadičky sú nainštalované z výroby.

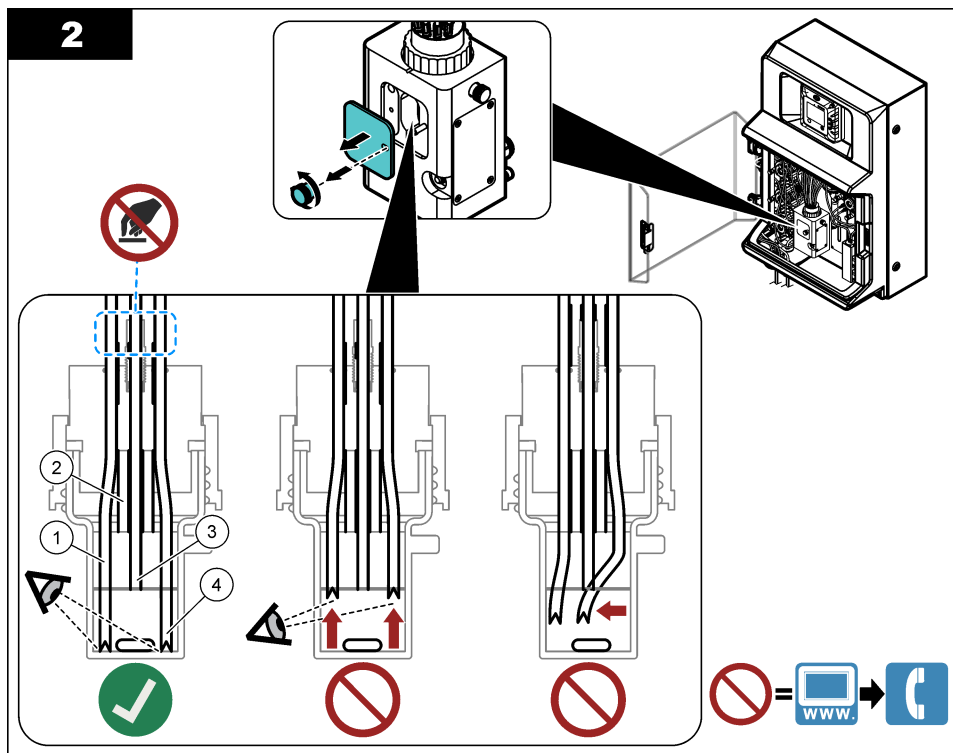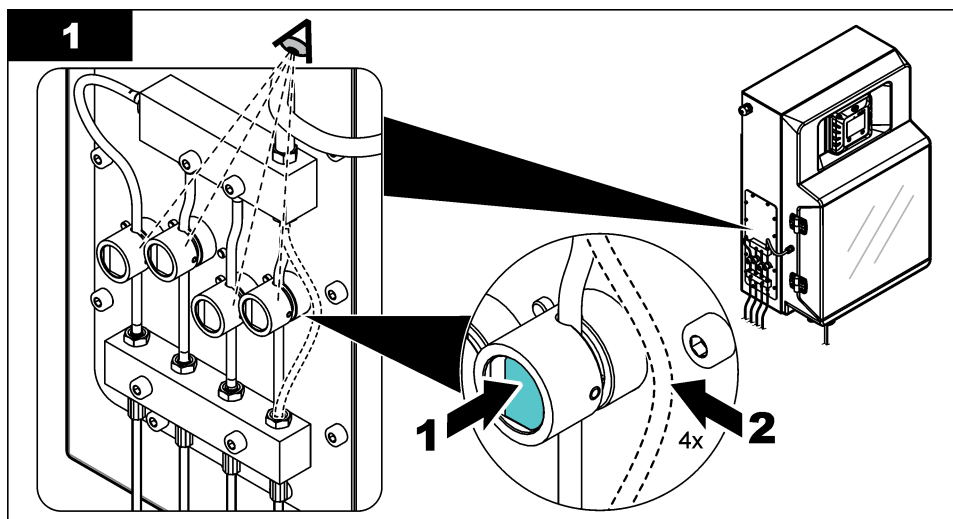




1 Odtoková hadička

2 Hadička na reagentie a vetracia hadička (horná hadička)

3 Hadička na vzorky

4 Hadička mineralizátora


3

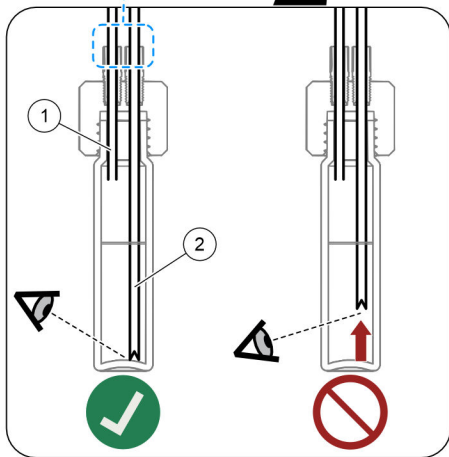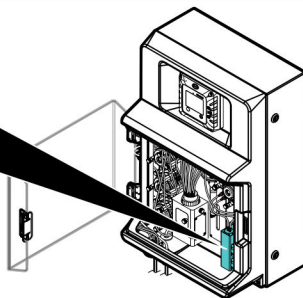

1 Vetracie hadičky

2 Hadička mineralizátora

4

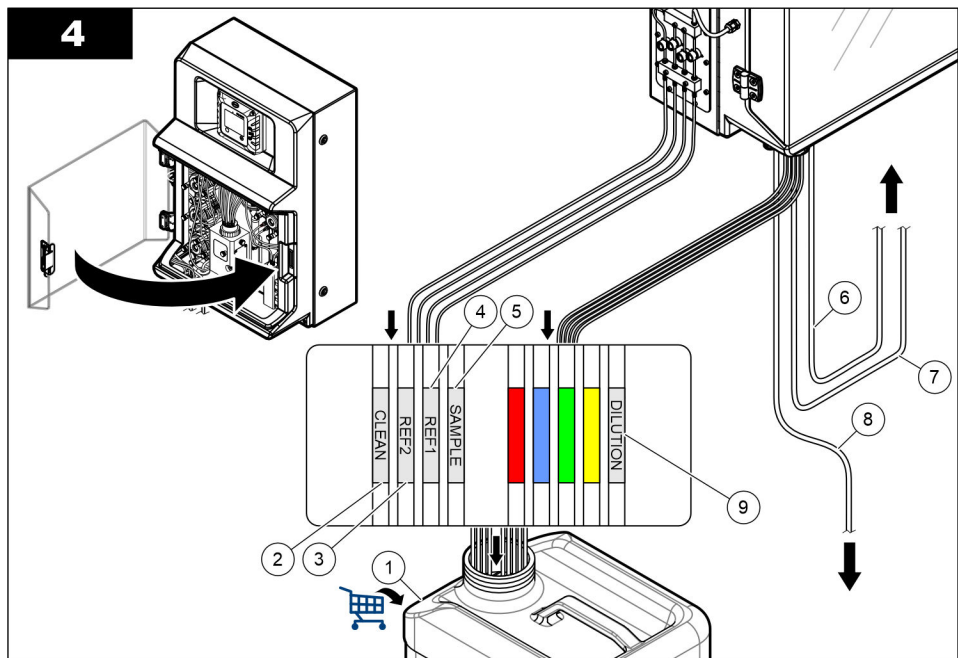

1 Deionizovaná voda	4 Hadička na referenčný roztok 1 (REF1)	7 Vetracie mineralizátora
2 Hadička na čistiaci roztok	5 Hadička vstupu vzorky	8 Odtoková hadička
3 Hadička na referenčný roztok 2 (REF2)	6 Vetracie hadičky	9 Hadička na riedenie a pre mikročerpadlo reagencie

## Odsek 6 Spustenie do prevádzky

### 6.1 Počítačové spustenie

**Poznámka:** Pred uvedením do prevádzky sa uistite, že montáž, pripojenie hadičky a elektrické inštalácie sú úplne dokončené. Pozri [Inštalácia](#) na strane 348.

Keď sa analyzátor prvýkrát nastaví na zapnutie, asistent pri spustení pomôže s prvými krokmi na dokončenie nastavenia. Dokončíte všetky nasledujúce kroky, aby ste sa uistili, že analyzátor funguje správne.

**Poznámka:** Skontrolujte, či používate správne činidlá pre zvolený rozsah merania. Viac informácií nájdete v rozšírenej verzii používateľskej príručky online.

- Otvorte dvere analyzátoru. Pozri [Otvorte dvere analyzátoru](#) na strane 349.
- Nastavte hlavný vypínač do polohy zapnutia. Pozri [Obrázok 9](#) na strane 461.
- Zatvorte dvierka analyzátoru dodaným kľúčom.
- Počkajte na dokončenie postupu inicializácie.
- Reagujte na výzvy na displeji a vyberte jazyk, časové pásmo, dátum a čas.  
Ak chcete nakonfigurovať ostatné nastavenia kontroléra, prečítajte si dokumentáciu ku kontroléru SC4500.
- Ťuknutím na displej zobrazíte ponuku **EZ2700sc**.
- Ak chcete spustiť asistenta pri spustení, vyberte možnosť **Ponuka zariadenia**. Zobrazí sa uvítacia obrazovka.

8. Vykonaťte kroky zobrazené na displeji a vyberte príslušný rozsah merania. Stlačte tlačidlo **OK**.
9. Ak je nainštalovaná filtračná jednotka, vyberte možnosť **Zap..** Ak nie, vyberte možnosť **Vyp..**
10. Vyberte počet kanálov pre analyzátor. Stlačte tlačidlo **OK**.
11. Ak je konfigurácia zobrazená na stránke súhrnu správna, stlačte tlačidlo **OK**.  
Zobrazí sa hlavná ponuka **EZ2700sc**.
12. Pokračujte testom komponentov. Pozri [Vykonalie testov komponentov](#) na strane 358.

## 6.2 Vykonalie testov komponentov

### ▲ V A R O V A N I E



Nebezpečenstvo príviknutia. Pohyblivé časti môžu spôsobiť príviknutie a úraz. Nedotýkajte sa pohyblivých častí.

Pred uvedením analyzátora do prevádzky vykonajte testy komponentov. Pomocou menu **Údržba** spustíte rôzne funkcie analyzátora na kontrolu činnosti komponentov.

#### Potreby:

- Ak je analyzátor v prevádzkovom režime, vyberte možnosť **Údržba > Spustiť režim údržby**.
- Uistite sa, že hadičky na vzorku, reagentie a roztoky sú v nádobe s deionizovanou vodou. [Prípojte analyzátor na test komponentov](#) na strane 354

### 6.2.1 Kontrola miešadla

1. Odstráňte svetelný kryt z jednotky fotometra. Pozri [Obrázok 13](#) na strane 472.
2. Uistite sa, že je miešadlo na dne nádoby na vzorky.  
*Poznámka:* Počas postupu plnenia skontrolujte, či sa miešadlo správne otáča. Postup plnenia sa začína v časti [Kontrola čerpadiel a škrtiacich ventilov](#) na strane 358.
3. Svetelný kryt nainštalujte na fotometer.

### 6.2.2 Kontrola čerpadiel a škrtiacich ventilov

1. Skontrolujte činnosť čerpadiel a škrtiacich ventilov, aby ste sa uistili, že nedochádza k úniku.
2. Uistite sa, že sa nádoba na analýzu naplnila deionizovanou vodou. [Obrázok 14](#) na strane 474
3. Uistite sa, že deionizovaná voda vychádza z odtokovej hadičky.
4. Vyberte **Údržba > Spustiť plnenie** a všetky kvapaliny naplňte samostatne.

Ak dôjde k úniku, skontrolujte všetky pripojenia a viac informácií nájdete v rozšírenej verzii používateľskej príručky online.

- a. Vyberte položku **Naplňte referenciu 1** a stlačte tlačidlo **OK**.
- b. Vyberte položku **Naplňte referenciu 2** a stlačte tlačidlo **OK**.
- c. Vyberte položku **Naplňte čistiaci roztok** a stlačte tlačidlo **OK**.
- d. Vyberte položku **Naplňte oplachovanie** a stlačte tlačidlo **OK**.
- e. Vyberte položku **Naplňte dávkovač** a stlačte tlačidlo **OK**.
- f. Vyberte položku **Naplňte kanál > Naplňte všetky kanály** a stlačte tlačidlo **OK**.  
Každý postup naplnenia sa automaticky zastaví po dokončení postupu.

### 6.2.3 Kontrola mikročerpadiel

Skontrolujte mikročerpadlá na prítomnosť netesností a vzduchových bublín.

1. Odstráňte svetelný kryt z fotometra.
2. Vyberte **Údržba > Spustiť plnenie > Naplňte všetky reagentie**.

3. Uistite sa, že sa deionizovaná voda dostáva do mikročerpadlo cez každú zo skúmaviek mikročerpadla (reagencie). Potom sa plynulo vloží do analytickej nádoby bez vzduchových bublín. Pozri [Obrázok 15](#) na strane 475.
4. Ak mikročerpadlá nefungujú správne (bublínky v hadičkách), použite postup so striekačkou a do príslušných hadičiek natlačte deionizovanú vodu, aby ste odstránili bublinky. Pozri [Obrázok 16](#) na strane 476.
5. Svetelný kryt nainštalujte na fotometer.

### 6.2.4 Vykonať kontrolu fotometra

Pred kontrolou fotometra sa uistite, že vonkajšia časť analytickej nádoby je čistá, aby sa kontrola mohla úspešne dokončiť. Ďalšie informácie o čistení komponentov analyzátora nájdete v rozšírenej verzii používateľskej príručky online.

1. Stlačte ikonu hlavnej ponuky a potom vyberte **Zariadenia**.
2. Vyberte **EZ2700sc**.
3. Prejdite do spodnej časti obrazovky a vyberte položku **Ponuka zariadenia**.
4. Vyberte položku **Údržba > Kontrola fotometra**.
5. Stlačením tlačidla **OK** spustíte meranie.  
Po dokončení kalibrácie tmavej hodnoty sa výsledok zobrazí na displeji.
6. Pokračujte stlačením tlačidla **OK**.
7. Skontrolujte, či sú hadičky „REF1“ pripojené k nádobe naplnenej deionizovanou vodou. Uistite sa, že je nainštalovaný svetelný štít. Pozri [Obrázok 18](#) na strane 479.
8. Stlačte tlačidlo **OK**.  
Počkajte, kým sa naplní analytická nádoba.
9. Pomocou skrutkovača nastavte výstupné napätie sondy na 9 V. Pozri [Obrázok 17](#) na strane 476.
10. Počkajte, kým sa na obrazovke nezobrazí hodnota 9 V. Potom stlačte tlačidlo **OK**.
11. Pokračujte stlačením tlačidla **OK**.

## 6.3 Vykonalenie testu vstupného signálu

Pred uvedením analyzátora do prevádzky vykonajte test digitálnych vstupov.

**Základné požiadavky:** Digitálne vstupy pripojte k externému bezpotenciálovému kontaktu (24 V DC).

Test digitálneho vstupného signálu a analógového výstupného signálu vykonajte takto:

1. Stlačte ikonu hlavnej ponuky a potom vyberte **Zariadenia**.
2. Vyberte **EZ2700sc**.
3. Prejdite do spodnej časti obrazovky a vyberte položku **Ponuka zariadenia**.
4. Vyberte **Diagnostika > Signály**.  
Zobrazia sa signály na digitálnych vstupoch.
5. Porovnajme stav digitálnych vstupov na displeji s napätiami privádzanými na digitálne vstupy (24 V = Zap.; 0 V = Vyp.).

## 6.4 Vykonalenie testu výstupného signálu

Pred uvedením analyzátora do prevádzky vykonajte test analógových výstupov.

**Základné požiadavky:** Nakonfigurujte analógové výstupy (AO1 – AO8, P101), aby ste vybrali merací kanál reprezentovaný každým analógovým výstupom. Viac informácií nájdete v rozšírenej verzii používateľskej príručky online.

Vykonajte test analógového výstupného signálu nasledovne:

1. Stlačte ikonu hlavnej ponuky.
2. Vyberte položku **Výstupy > mA výstupy AOC > Test/údržba**.

Možnosť	Opis
<b>Test funkcie</b>	Vykoná test výstupov vybraného modulu.
<b>Stav výstupu</b>	Zobrazí stav výstupov na vybranom module.

3. Pomocou multimetra odmerajte hodnotu mA na každom analógovom výstupe.
4. Porovnajte hodnoty mA namerané na analógových výstupoch s očakávanými hodnotami mA.

## 6.5 Nastavenie sekvencie kanálov

Vyberte sekvenciu merania kanálov, počet meraní pri každom kanáli a čakaciu dobu pred meraním kanála. Zadaťte maximálne 16 položiek, každú s maximálne 16 cyklami.

1. Stlačte ikonu hlavnej ponuky a potom vyberte **Zariadenia**.
2. Vyberte **EZ2700sc**.
3. Prejdite do spodnej časti obrazovky a vyberte položku **Ponuka zariadenia**.
4. Ak je analyzátor v prevádzkovom režime, vyberte možnosť **Údržba > Spustiť režim údržby**. Počkajte, kým sa analyzátor prepne do režimu údržby.
5. Vyberte **Konfigurácia > Nastavenie sekvencie kanálov**.
6. Pomocou šípok na bočnom paneli vyberte pozíciu (číslo v poradí) a potom stlačením tlačidla **OK** túto pozíciu nakonfigurujte.
7. Vyberte jednu možnosť.

Možnosť	Opis
<b>Vybrať</b>	Vyberie príslušný kanál alebo čakaciu dobu.
<b>Počet meraní</b>	Nastaví počet meraní pre kanál.
<b>Čakacia doba</b>	Nastaví čakaciu dobu pre vybraný kanál.

8. Stlačením **OK** zmeny uložte.

## 6.6 Pripojenie roztokov a vzorky

### ▲ UPOZORNENIE



Nebezpečenstvo expozície chemikáliám. Dodržiavajte laboratórne bezpečnostné postupy a používajte všetky osobné ochranné pomôcky zodpovedajúce chemikáliám, s ktorými pracujete. Bezpečnostné protokoly nájdete v aktuálnych kartách bezpečnostných údajov (KBÚ).

### ▲ UPOZORNENIE



Nebezpečenstvo expozície chemikáliám. Chemikálie a odpad likvidujte podľa miestnej, regionálnej a štátnej legislatívy.

### ▲ UPOZORNENIE



Nebezpečenstvo vzniku požiaru. Tento výrobok nie je určený na použitie s horľavými kvapalinami.

Nádoby na reagentie sa dodávajú spolu s analyzátorom. **Obrázok 18** na strane 479 Nádoby na referenčný roztok 1, referenčný roztok 2 a na deionizovanú vodu dodáva používateľ. Ďalšie nádoby si môžete zakúpiť u výrobcu.

Nainštalujte nádoby

- čo najbližšie k analyzátoru
- 1 meter pod dno analyzátoru

Inštalácia nádoby je znázornená na obrázku **Obrázok 18** na strane 479.

Reagencie a roztoky dodáva používateľ. Používajte len reagenty dodávané certifikovanou spoločnosťou alebo používajte reagenty určené výrobcom. Používateľ si prípadne môže pripraviť reagenty sám. Postupujte podľa pokynov v metodickom a reagenčnom hárku pre príslušný model, ktoré nájdete na webovej stránke výrobcu.

Hadičky sú nainštalované z výroby. Pozrite si štítky na každej hadičke, podľa nich identifikujete správne montážne pripojenie. Správne reagenty, roztoky a štandardy nájdete v príslušnom metodickom a reagenčnom hárku pre daný model na webovej stránke výrobcu.

1. Po vykonaní testov komponentov vložte hadičky „CLEAN“ (čistiaci roztok), „REF1“ (referenčný roztok 1) a „REF2“ (referenčný roztok 2) do príslušných nádob. Pozri **Obrázok 18** na strane 479.
2. Každú farebne označenú hadičku s reagentom vložte do nádoby s reagentom rovnakej farby na štítku.
3. Zdroj vzorky (alebo výstup vzorky na paneli Moduplex alebo paneli filtra) pripojte k hadičke vstupu vzorky analyzátoru. Pozri **Obrázok 18** na strane 479.
4. Stlačte ikonu hlavnej ponuky a potom vyberte **Zariadenia**.
5. Vyberte **EZ2700sc**.
6. Prejdite do spodnej časti obrazovky a vyberte položku **Ponuka zariadenia**.
7. Vyberte **Údržba > Spustiť plnenie > Naplniť všetko**.

## 6.7 Vykonajte overenie pred prvým spustením

Vykonajte overenie, aby ste sa uistili, že sú merania v rámci tolerančného rozsahu. Viac informácií nájdete v rozšírenej verzii používateľskej príručky online.

1. Stlačte ikonu hlavnej ponuky a potom vyberte **Zariadenia**.
2. Vyberte **EZ2700sc**.
3. Prejdite do spodnej časti obrazovky a vyberte položku **Ponuka zariadenia**.
4. Na spustenie overenia vyberte položky **Kalibrácia > Overenie > Spustiť overenie**.  
Pri overovaní sa meria deionizovaná voda v referenčnej fľaši 2.
5. Ak chcete zobrazíť výsledky, vyberte možnosť:
  - **Kalibrácia > Overenie > História overení**
  - **Diagnostika > Historické údaje > Overenie**

## 6.8 Spustenie analyzátoru

Spustenie analyzátoru:

1. Stlačte ikonu hlavnej ponuky a potom vyberte **Zariadenia**.
2. Vyberte **EZ2700sc**.
3. Prejdite do spodnej časti obrazovky a vyberte položku **Ponuka zariadenia**.
4. Vyberte **Údržba > Spustiť prevádzkový režim**.

## Vsebina

- 1 [Dodatne informacije](#) na strani 362
- 2 [Pregled izdelka](#) na strani 362
- 3 [Specifikacije](#) na strani 363

- 4 [Splošni podatki](#) na strani 364
- 5 [Namestitvev](#) na strani 366
- 6 [Zagon](#) na strani 375

## Razdelek 1 Dodatne informacije

Osnovni uporabniški priročnik vsebuje dovolj natančne informacije za prvi zagon. Na spletu je na voljo razširjeni priročnik, ki vsebuje podrobnejše informacije.

### ⚠ NEVARNOST



Različne nevarnosti. V spodaj prikazanih razdelkih razširjenega uporabniškega priročnika so na voljo podrobnejše informacije.

- Uporabniški vmesnik in pomikanje
- Delovanje
- Vzdrževanje
- Odpravljanje težav
- Sezname nadomestnih delov

Če želite odpreti razširjeni uporabniški priročnik, skenirajte naslednje QR-kode.



Evropski jeziki



Ameriški in azijski jeziki

## Razdelek 2 Pregled izdelka

Analizator EZ2700sc Hach je on-line analizator, ki meri en parameter v vzorcih vode iz industrijskih in okoljskih vzorcev. Glejte [Slika 1](#) na strani 439, [Slika 2](#) na strani 444 in [Slika 3](#) na strani 448.

Analizator je spletni kolorimetrični analizator za sprotno splošno analizo vode (npr. nitratov, fosfatov). Analizator ima možnost daljinskega zagona, samodejnega preverjanja, samodejnega umerjanja, samodejnega čiščenja in Modbus.

Voda za vzorčenje vstopi v analizator preko cevi z vzorcem. Črpalke, ventili in brizge v analizatorju potiskajo vzorec in reagente v merilno celico na panelu za analitiko. Ko je postopek v posodi za analizo zaključen, analizator odstrani vzorec skozi odtočno cev. Rezultati analize se prikažejo na zaslonu kontrolne enote SC4500. Kontrolna enota SC4500 shrani podatke analizatorja (podatkovni dnevnik, dnevnik dogodkov, dnevnik nastavitvev in servisni dnevnik). Za upravljanje in konfiguriranje analizatorja uporabite kontrolno enoto SC4500.

Če želite povečati število vzorcev (kanalov), ki jih analizator lahko izmeri (2, 4 ali 8), kupite panel Moduplex z več vzorci skupaj z analizatorjem.

Za predpripravo vzorca (filtriranje, mirovanje) kupite filtrirno ploščo EZ9010, EZ9020, EZ9150, EZ9200 ali EZ9250 skupaj z analizatorjem.

## Razdelek 3 Specifikacije

Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov brez predhodnega obvestila.

Tehnični podatki	Podrobnosti
Mere (Š x D x G)	460 x 688 x 340 mm (18,1 x 27,1 x 13,4 palca)
Ohišje	IP44; ABS, PMMA in premazano jeklo
Zaslon	IP66, 3,5-palčni barvni kapacitivni zaslon TFT na dotik
Teža	40 kg (88 lb)
Napajanje	100 do 240 V AC ±10 %, 50/60 Hz
Poraba energije	Največ 240 VA
Nadmorska višina	Največ 2000 m (6560 ft)
Kategorija prenapetosti	II
Okoljski pogoji	Samo za uporabo v zaprtih prostorih
Stopnja onesnaževanja	2
Delovna temperatura	Od 10 do 30 °C (od 50 do 86 °F); 5 do 95 % relativne vlažnosti, brez kondenzacije, brez korozije
Temperatura skladiščenja	Od -20 do 60 °C (od -4 do 140 °F); največ 95-% relativna vlažnost, brez kondenzacije
Dovodi za vzorec	En
Tlak vzorca	Z zunanjo prelivno posodo (odprto za atmosferski tlak)
Hitrost pretoka vzorca	Od 100 do 300 mL/min
Temperatura vzorca	Od 10 do 30 °C (od 50 do 86 °F)
Kakovost vzorca	delci < 100 µm, največ < 0,1 g/L Motnost < 50 NTU
Čiščenje z zrakom za zelo jedka okolja	0,2 bara (20 kPa ali 3 psi); suh in čist zrak
Odtok	Pod atmosferskim tlakom, s prezračevanjem, najmanj Ø 32 mm
Priključek za ozemljitev	Suha in čista ozemljitvena palica z nizko impedanco (< 1 Ω) in ozemljitvenim kablom > 2,5 mm <sup>2</sup> (13 AWG)
Analogni izhodi	Največ osem 0–20 mA (ali 4–20 mA) analognih izhodov <b>Napotek:</b> Napajanje zanke zagotavljajo analogni izhodi. Kontaktov sistema SCADA ali PLC ni mogoče napajati z električno energijo.
Digitalni vhodi	Sedem digitalnih vhodov: dva digitalna vhoda za daljinski zagon. Ostali digitalni vhodi so za prihodnjo uporabo.
Digitalni izhodi	Štirje digitalni izhodi pod napetostjo za ventile in črpalke plošče EZ9150; osem digitalnih izhodov pod napetostjo za ventile panela Moduplex, 24 V DC, 500 mA.
Releji	Pet brezpotencialnih kontaktov (FCT), največja obremenitev 24 V DC; 0,5 A (uporovno breme)
Priključki za Ethernet	Priključek Ethernet za sistem Claros in konektor za Ethernet za Modbus TCP/IP; različica z omrežjem LAN; 10/100 Mbps ali Profinet ali IP za Ethernet

SL

<sup>2</sup> Več informacij o konfiguraciji za Ethernet in Modbus najdete v dokumentaciji kontrolne enote SC4500.

Tehnični podatki	Podrobnosti
Komunikacije RS485	Profibus DP ali Modbus RTU
Certifikati	Certifikat CE, ETL v skladu z varnostnimi standardi UL in CSA, UKCA
Garancija	1 leto (EU: 2 leti)

## Razdelek 4 Splošni podatki

Proizvajalec v nobenem primeru ni odgovorjen za škodo, ki bi bila posledica nepravilne uporabe izdelka ali neupoštevanja navodil v priročniku. Proizvajalec si pridržuje pravico do sprememb v navodilih in izdelku, ki ga opisuje, brez vnaprejšnjega obvestila. Prenovljene različice najdete na proizvajalčevi spletni strani.

### 4.1 Varnostni napotki

Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala kot posledica napačne aplikacije ali uporabe tega izdelka, kar med drugim zajema neposredno, naključno in posledično škodo, in zavrača odgovornost za vso škodo v največji meri, dovoljeni z zadevno zakonodajo. Uporabnik je v celoti odgovoren za prepoznavo tveganj, ki jih predstavljajo kritične aplikacije, in namestitvev ustreznih mehanizmov za zaščito procesov med potencialno okvaro opreme.

Še pred razpakiranjem, zagonom ali delovanjem te naprave v celoti preberite priložena navodila. Še posebej upoštevajte vse napotke o nevarnostih in varnostne napotke. Če jih ne upoštevate, lahko povzročite hude poškodbe uporabnika ali opreme.

Če se oprema uporablja na način, ki ga proizvajalec ni določil, se lahko zaščita, ki jo zagotavlja oprema, poslabša. Te naprave ne uporabljajte ali nameščajte na kakršenkoli drugačen način, kot je določeno v tem priročniku.

#### 4.1.1 Uporaba varnostnih informacij

##### ▲ NEVARNOST

Označuje možno ali neposredno nevarno situacijo, ki lahko povzroči smrt ali hude poškodbe.

##### ▲ OPOZORILO

Označuje možno ali neposredno nevarno situacijo, ki lahko privede do hude poškodbe ali povzroči smrt, če se ji ne izognete.

##### ▲ PREVIDNO

Označuje možno nevarno situacijo, ki lahko povzroči manjše ali srednje težke poškodbe.

##### OPOMBA

Označuje situacijo, ki lahko, če se ji ne izognete, povzroči poškodbe instrumenta. Informacija, ki zahteva posebno pozornost.

#### 4.1.2 Opozorilne oznake





Upoštevajte vse oznake in tablice, ki so nahajajo na napravi. Neupoštevanje tega lahko privede do telesnih poškodb ali poškodb naprave. Simbol na merilni napravi se nanaša na navodila s



To je varnostni opozorilni simbol. Upoštevajte vsa varnostna sporočila, ki sledijo temu simbolu, da se izognete poškodbam. Če se nahajajo na napravi, za informacije o delovanju ali varnosti glejte navodila za uporabo.




Ta simbol opozarja na tveganje kemičnih poškodb in označuje, da sme delo s kemikalijami ali vzdrževalna dela na sistemih za dovajanje kemikalij v povezavi s to opremo opravljati samo osebe, ki je ustrezno usposobljeno za delo s kemikalijami.

	Ta simbol opozarja, da obstaja tveganje električnega udara in/ali smrti zaradi elektrike.
	Ta simbol kaže na prisotnost naprav, ki so občutljive na elektrostatično razelektritev (ESD), in opozarja na to, da morate z ustreznimi ukrepi preprečiti nastanek škode in poškodb opreme.
	Ta simbol označuje, da je treba označeni predmet zaščititi z ozemljitveno povezavo. Če instrument ni opremljen z ozemljitvenim vtičem na kablu, izdelajte zaščitno ozemljitveno povezavo do priključka zaščitnega vodnika.
	Električne opreme, označene s tem simbolom, v EU ni dovoljeno odlagati v domačih ali javnih sistemih za odstranjevanje odpadkov. Staro ali izrabljeno opremo vrnite proizvajalcu, ki jo mora odstraniti brez stroškov za uporabnika.

SL

#### 4.1.3 Kemična in biološka varnost

<b>⚠ NEVARNOST</b>	
	Kemične ali biološke nevarnosti. Če instrument uporabljate za spremljanje postopka obdelave in/ali dovajanja kemikalij, ki je določen z zakonskimi omejitvami in zahtevami za spremljanje, povezanimi z javnim zdravjem, javno varnostjo, proizvodnjo hrane in pijač, je uporabnik tega instrumenta dolžan poznati in spoštovati vse zadevne predpise, poskrbeti pa mora tudi za zadostne in primerne mehanizme, ki zagotavljajo skladnost z zadevno zakonodajo v primeru okvare instrumenta.

#### 4.2 Ikone, uporabljene na ilustracijah

			
Deli, ki jih dobavlja proizvajalec	Deli, ki jih priskrbi uporabnik	Glejte	Ponovite korake v obratnem vrstnem redu

				
Delo za dve osebi	Poslušaj	Uporabljajte samo prste	Ne uporabljajte orodij	Ne dotikajte se

#### 4.3 Predvidena uporaba

Analizatorji serije EZ družbe Hach so namenjeni uporabnikom, ki morajo neprekinjeno meriti parametre kakovosti vode iz industrijskih in okoljskih vzorcev. Analizatorji Hach serije EZ ne čistijo ali obdelujejo in niso namenjeni krmiljenju postopkov.

#### 4.4 Sestavni deli izdelka

Preverite, ali ste prejeli vse sestavne dele. Glejte [Slika 4](#) na strani 453. Če kateri koli del manjka ali je poškodovan, se nemudoma obrnite na proizvajalca ali prodajnega zastopnika.

## Razdelek 5 Namestitvev

### ⚠ NEVARNOST



Različne nevarnosti Opravila, opisana v tem delu dokumenta, lahko izvaja samo usposobljeno osebje.

### 5.1 Navodila za namestitvev

#### ⚠ OPOZORILO



Nevarnost požara. Kadar se oprema uporablja za metode, ki vključujejo vnetljive tekočine, mora uporabnik poskrbeti za ustrezne previdnostne ukrepe. Upoštevajte primerne uporabniške previdnostne ukrepe in varnostne protokole. Sem med drugim sodijo ukrepi za nadzor politij in puščanja, primerno prezračevanje, vedno nadzorovana uporaba in pravilo, da instrument, kadar je pod napajanjem, nikoli ne ostane brez nadzora.

#### ⚠ PREVIDNO



Nevarnost izpostavljenosti kemikalijam. Upoštevajte varnostne predpise v laboratoriju in nosite vso osebno zaščitno opremo, primerno za delo s kemikalijami, ki jih trenutno uporabljate. Za varnostne protokole glejte veljavni varnostni list (MSDS/SDS).

#### ⚠ PREVIDNO



Nevarnost izpostavljenosti kemikalijam. Kemikalije in odpadke zavržite v skladu z lokalnimi, regionalnimi in nacionalnimi predpisi.

- Analizator je namenjen namestitvi v zaprte prostore, in sicer v varno okolje.
- Analizator namestite v okolje, ki je zaščiteno pred jedkimi tekočinami.
- Analizator namestite v čist in suh prostor z dobrim prezračevanjem in nadzorovano temperaturo.
- Analizator namestite čim bližje mesta za vzorčenje.
- Analizatorja ne namestite tako, da bo izpostavljen neposredni sončni svetlobi ali viru toplote.
- Poskrbeti morate, da je okoli instrumenta dovolj prostora za vodovodne in električne priključke.
- Poskrbeti morate, da je pred analizatorjem dovolj prostora za odpiranje vrat analizatorja. Glejte [Mere analizatorja](#) na strani 367.
- Poskrbite, da so pogoji okolja v skladu z specifikacijami delovanja instrumenta. Glejte [Specifikacije](#) na strani 363.

Čprav analizator ni zasnovan za uporabo z vnetljivimi vzorci, se nekaterih analizatorjih EZ uporabljajo vnetljivi reagenti. Za več informacij o reagentih, ki se uporabljajo v analizatorju, si oglejte list Metode in reagenti za ustrezen model serije EZ. Če se v analizatorju uporabljajo vnetljivi reagenti, upoštevajte naslednje previdnostne ukrepe:

- Analizator hranite zaščiteno pred vročino, iskrami in odprtim ognjem.
- V bližini analizatorja ne jejte, pijte ali kadite.
- Uporabljajte lokalni izpušni prezračevalni sistem.
- Naprave in sistem osvetlitve, ki jih uporabljate, morajo biti odporni na iskrenje in eksplozijo.
- Preprečite elektrostatične razelektritve. Glejte [Upoštevanje elektrostatične razelektritve \(ESD\)](#) na strani 367.
- Instrument pred uporabo temeljito očistite in posušite.
- Pred odmori in po koncu delovnega časa si umijte roke.
- Onesnažena oblačila odstranite. Preden jih znova oblečete, jih je treba oprati.
- S temi tekočinami je treba ravnati v skladu s predpisi o dovoljenih omejitvah izpostavljenosti, ki jih določa lokalni regulativni organ.

## 5.2 Mere analizatorja

Glejte [Slika 5](#) na strani 454 za mere analizatorja.

## 5.3 Mehanska namestitvev

### 5.3.1 Pritrditev instrumenta na steno

▲ OPOZORILO	
	Nevarnost telesnih poškodb. Stensko okovje mora biti zmožno držati 4-kratno težo opreme.

SL

▲ OPOZORILO	
	Nevarnost telesnih poškodb. Instrumenti ali sestavni deli so težki. Pri nameščanju ali premikanju poiščite pomoč.

▲ OPOZORILO	
	Nevarnost telesnih poškodb. Predmet je težak. Za varno uporabo se prepričajte, da je instrument varno pritrjen na steno, mizo ali tla.

Uporabite priložene namestitvene okvirje, da instrument namestite v pokončnem položaju na ravno, navpično površino stene. Glejte [Slika 6](#) na strani 456.

Instrument namestite na tako mesto in tak položaj, da lahko uporabnik instrument enostavno odklopi od vira napajanja.


Poskrbeti morate, da je pod analizatorjem dovolj prostora za namestitvev posod.

Opremo za namestitvev mora priskrbeti uporabnik. Prepričajte se, da stenska pritrdila zagotavljajo zadostno nosilnost (približno 160 kg ali 353 lb). Orodje za namestitvev mora biti odobreno za vrsto stene.


### 5.3.2 Odprite vrata analizatorja

Uporabite priloženi ključ za odklepanje obeh ključavnic na strani analizatorja. Glejte [Slika 7](#) na strani 456. Pred postopkom zaprite vrata, da ohranite stopnjo zaščite ohišja pred okoljskimi vplivi in oceno varnosti.

## 5.4 Električna priključitev

▲ NEVARNOST	
	Smrtna nevarnost zaradi električnega udara. Pred vsemi posegi v električne povezave vedno izključite napajanje.

### 5.4.1 Upoštevanje elektrostatične razelektritve (ESD)

OPOMBA	
	Možne poškodbe opreme. Elektrostatični naboj lahko poškoduje občutljive elektronske sklope, kar ima za posledico zmanjšano zmogljivost instrumenta ali celo okvaro.

Upošteвайте korake v teh navodilih in tako preprečite škodo na instrumentu, ki lahko nastane zaradi elektrostatične razelektritve (ESD):

- Dotaknite se ozemljene kovinske površine, kot je šasija instrumenta ali kovinska cev, da sprostite statično elektriko iz telesa.

- Izogibajte se prekomernemu gibanju. Statično–občutljive sestavne dele transportirajte v antistatičnih posodah ali embalaži.
- Nosite zaščitno opremo, ki je povezana z vodnikom, za ozemljitev.
- Delo naj poteka na statično varnem območju z antistatičnimi preprogami in podlogami na delovnih pulatih.

### 5.4.2 Dostop do elektrike

Kable zunanjih naprav napeljite skozi kabelske uvodnice. Glejte [Slika 8](#) na strani 459. Čepi naj ostanejo v neuporabljenih kabelskih uvodnicah.

[Slika 9](#) na strani 461 prikazuje sestavne dele v analizatorju. Stikalo za vklop/izklop je odklopnik tokokroga, ki samodejno prekine električno napajanje vodnika z izmeničnim tokom, če pride do nadtoka (npr. kratki stik) ali prenapetosti.

### 5.4.3 Priključitev zunanjih naprav

Priključite zunanje naprave, ki bodo uporabljene z analizatorjem, v signalne in kontrolne priključke. Glejte [Slika 10](#) na strani 466 in [Tabela 1](#) na strani 368.

**Tabela 1 Signalni in kontrolni priključki – opisi**

Pin	Opis
AO1–AO8 (P101)	Osem analognih izhodov za upravljanje zunanjih naprav. Glejte „Za več informacij in slik glejte razširjeni uporabniški priročnik na spletu.“
FCT1–FCT5 (P102)	<p>Pet relejev (brezpotencialni kontakti). Največja obremenitev je 24 V DC, 0,5 A.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FCT1 – Alarm za okvaro</li> <li>• FCT2 – Alarm za vzdrževanje</li> <li>• FCT3 – Analizator je pripravljen</li> <li>• FCT4 in FCT5 – Za poznejšo uporabo</li> </ul>
DI1–DI7 (P103)	<p>Sedem digitalnih vhodov za oddaljeno upravljanje analizatorja<sup>5</sup>Digitalne vhode priključite na zunanji brezpotencialni kontakt (24 V DC), da pri analizatorju sprožite začetek merjenja za kanal.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DI1 – Oddaljeni zagon za kanal 1</li> <li>• DI2 – Oddaljeni zagon za kanal 2</li> <li>• DI3 do DI7 – Za poznejšo uporabo</li> </ul>
FB1–FB4 (P104)	<p>Priključek Profibus DP ali Modbus RTU (RS485)</p> <p><b>Profibus DP:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FB1 – A1 (vhod)</li> <li>• FB2 – A2 (izhod)</li> <li>• FB3 – B1 (vhod)</li> <li>• FB4 – B2 (izhod)</li> <li>• SHL – Zaščita</li> </ul> <p><b>Modbus RTU:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FB1 – D (+)</li> <li>• FB2 – D (-)</li> <li>• FB3 – Se ne uporablja</li> <li>• FB4 – Se ne uporablja</li> <li>• SHL – Zaščita</li> </ul> <p>Za navodila o konfiguraciji Modbus in oznakah za telegram si oglejte dokumentacijo kontrolne enote SC4500.</p>
24 V DC/1A (P105)	Napajanje z močjo 24 V DC za filtrirni enoti EZ9010 in EZ9020

<sup>5</sup> Če je analizator v načinu vzdrževanja, je daljinsko upravljanje onemogočeno.

**Tabela 1 Signalni in kontrolni priključki – opisi (nadaljevanje)**

Pin	Opis
STR1–STR8 (P106)	<p>Osem digitalnih izhodov za izbirni panel Moduplex. Izpostavljene žice posameznega ventila za kanal na panelu Moduplex povežite s sorodnimi konektorji STR.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• STR1 – Kanal 1</li> <li>• STR2 – Kanal 2</li> <li>• ...</li> <li>• STR8 – Kanal 8</li> </ul>
EXT9–EXT12 (P107)	<p>Štirje digitalni izhodi za izbirni filtrirni panel EZ9150. Električne ventile in črpalko na filtrirnem panelu EZ9150 priključite na konektorje EXT.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EXT9 – Ventil za izpiranje</li> <li>• EXT10 – Ventil za povratni tok</li> <li>• EXT11 – Ventil za prelivni odtok</li> <li>• EXT12 – Črpalka za filtriranje</li> </ul>
D01–D06 (P108 in P109)	<p>Šest izhodov pnevmatskih ventilov za panel EZ9150.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• D01 – Ventil za dovod vzorca</li> <li>• D02 – Ventil za odtok preliva</li> <li>• D03 – Ventil kanala 1</li> <li>• D04 – Ventil kanala 2</li> <li>• D05 – Ventil kanala 3</li> <li>• D06 – Ventil kanala 4</li> </ul>

SL

#### 5.4.4 Priklp na napajanje z izmeničnim tokom

### ⚠ NEVARNOST



Nevarnost električnega udara in požara. Preverite, ali sta priloženi kabel in nezaskočni vtič v skladu z veljavnimi nacionalnimi predpisi.


- V elektroenergetski vod mora biti nameščen odklopnik tokokroga z zadostno zmogljivostjo električnega toka.
- Prepričajte se, da je v bližini analizatorja nameščen odklopnik tokokroga ali zasilno stikalo, da lahko analizator po potrebi takoj odklopite iz električnega napajanja.
- Opremo priključite v skladu z lokalnimi ali nacionalnimi predpisi za električne naprave.
- Priložen napajalni kabel napeljite skozi kabelsko uvodnico, ki je ob strani analizatorja.
- Kabelsko uvodnico zategnite za varno pritrditev napajalnega kabla in za ohranitev stopnje zaščite ohišja pred okoljskimi vplivi.

Analizator priključite v izmenično napajanje s priloženim kablom za izmenično napajanje. Glejte [Tabela 2](#) na strani 370 in [Slika 11](#) na strani 468.

## OPOMBA

Ne vklopite stikala za vklop/izklop. Pred zagonom zaključite vse električne in cevovodne povezave, saj lahko v nasprotnem primeru pride do poškodb analizatorja.

**Tabela 2 Informacije o ožičenju – izmenični tok**

Priključna sponka	Opis	Barva kabla - Severna Amerika in Kanada	Barva kabla-EU
L	Fazni/linijski (L)	Črna (1)	Rjava
N	Ničla (N)	Bela (2)	Modra
	Zaščitni ozemljitveni (PE)	zelena z rumeno črto	zelena z rumeno črto

## 5.5 Vodovodne napeljave

### 5.5.1 Priporočila glede voda za vzorčenje

#### ▲ PREVIDNO



Nevarnost požara. Ta izdelek ni namenjen za uporabo z vnetljivimi vzorci.

Za najboljše delovanje instrumenta izberite dobro, reprezentativno mesto za vzorčenje. Vzorec mora biti reprezentativen za celoten sistem.

- Poskrbite, da je pretok vzorca višje kot pretok do analizatorja.
- Če analizator uporablja peristaltično črpalko za potiskanje vzorca v posodo za analizo, poskrbite, da je linija za vzorec pod atmosferskim tlakom.
- Poskrbite, da linija za vzorec zajema vzorec iz male prelivne posode poleg analizatorja.
- Uporabite linijo vzorca, ki je priložena. Ne spreminjajte dolžine linije vzorca.

Vzorec v prelivni posodi je treba stalno osveževati. Če so trdni delci v vzorcu preveliki, je priporočeno tudi filtriranje vzorca.

### 5.5.2 Smernice glede odtočnih linij

#### ▲ OPOZORILO



Nevarnost požara. Kadar se oprema uporablja za metode, ki vključujejo vnetljive tekočine, mora uporabnik poskrbeti za ustrezne previdnostne ukrepe. Upoštevajte primerne uporabniške previdnostne ukrepe in varnostne protokole. Sem med drugim sodijo ukrepi za nadzor politij in puščanja, primerno prezračevanje, vedno nadzorovana uporaba in pravilo, da instrument, kadar je pod napajanjem, nikoli ne ostane brez nadzora.

#### ▲ PREVIDNO



Nevarnost izpostavljenosti kemikalijam. Kemikalije in odpadke zavržite v skladu z lokalnimi, regionalnimi in nacionalnimi predpisi.

## OPOMBA

Odtočnih linij ne priključite na druge linije, sicer lahko pride do nastanka povratnega tlaka in poškodb analizatorja. V odtočnih linijah mora biti omogočen dostop zraka.

## OPOMBA

Da preprečite nastanek povratnega tlaka in poškodbe analizatorja, mora biti analizator višje od odtočnih cevi objekta, odtočna linija pa mora imeti stalen padec. Odtočne linije namestite z navpični padcem 2,54 cm (1 palec) ali več na vsake 0,3 m (1 čevlji) dolžine cevi.

Analizator uporablja odtočno linijo za odvod vzorca in reagentov po analizi. Pravilna namestitvev odtočnih linij je pomembna, saj zagotavlja pravilno odvajanje vseh tekočin iz instrumenta. Če namestitvev ni pravilna se lahko tekočine vračajo v instrument in ga poškodujejo. Za odtočno linijo zadostuje talni sifon ali sifon umivalnika. Priporočeni zunanji premer odtočne cevi je 32 mm. Glejte [Slika 12](#) na strani 471.

- Odtočni vodi naj bodo čim krajši.
- Zagotovite, da je odtok nižje kot analizator.
- Odtočni vodi morajo imeti stalen padec.
- Odtočni vodi ne smejo imeti ostrih zavojev in ne smejo biti preščipnjeni.
- Odtočne cevi se morajo odpirati na zrak in ne smejo biti pod tlakom.
- Odtočne cevi morajo biti zaprte do prostora, v kateri je nameščen analizator.
- Odtočne linije ne zamašite in je ne potopite v vodo.

Priporočena je tudi uporaba priključka za vodo blizu analizatorja, ki omogoča redno izpiranje odtočnega korita in odtočne cevi s čisto vodo, kar prepreči zamašenost zaradi kristalizacije.

Za več informacij o reagentih, ki se uporabljajo v analizatorju, si oglejte list Metode in reagenti za ustrezen model serije EZ. Če se v analizatorju uporabljajo vnetljivi reagenti, upoštevajte naslednje previdnostne ukrepe:

- Odtočna cev ne sme biti speljana v talni sifon.
- Odpadke zavržite v skladu z lokalnimi, regionalnimi in državnimi predpisi.

### 5.5.3 Smernice glede odzračevalnih linij

#### ▲ OPOZORILO



Nevarnost požara. Kadar se oprema uporablja za metode, ki vključujejo vnetljive tekočine, mora uporabnik poskrbeti za ustrezne previdnostne ukrepe. Upoštevajte primerne uporabniške previdnostne ukrepe in varnostne protokole. Sem med drugim sodijo ukrepi za nadzor politij in puščanja, primerno prezračevanje, vedno nadzorovana uporaba in pravilo, da instrument, kadar je pod napajanjem, nikoli ne ostane brez nadzora.

#### ▲ PREVIDNO



Nevarnost izpostavljenosti kemikalijam. Kemikalije in odpadke zavržite v skladu z lokalnimi, regionalnimi in nacionalnimi predpisi.

## OPOMBA

Odzračevalne linije (izhoda izpušnih plinov) ne priključite na druge linije, sicer lahko pride do nastanka povratnega tlaka in poškodb analizatorja. Prepričajte se, da odzračevalna linija izhaja na zrak zunaj stavbe.

## OPOMBA

Da preprečite nastanek povratnega tlaka in poškodbe analizatorja, mora biti analizator višje od odzračevalnih cevi objekta, odzračevalna linija pa mora imeti stalen padec. Odzračevalne linije namestite z navpični padcem 2,54 cm (1 palec) ali več na vsake 0,3 m (1 čevlji) dolžine cevi.

Analizator ima odzračevalne linije, ki ohranjajo atmosferski tlak posode za analizo. Pravilna namestitvev odzračevalne linije je pomembna, saj zagotavlja, da med delovanjem črpalke tekočina iz odzračevalne linije ne vstopi v posodo za analizo. Če namestitvev ni pravilna, se lahko plini vračajo v analizator in ga poškodujejo. Priporočeni zunanji premer za zbiralno cev izpušne linije je 32 mm. Glejte [Slika 12](#) na strani 471.

- Odzračevalna linija naj bo čim krajša.
- Odzračevalne linije morajo imeti stalen padec.

- Odzračevalna linija ne sme imeti ostrih zavojev in ne sme biti preščajpjena.
- Odzračevalna linija mora biti zaprta do prostora, v kateri je nameščen analizator, in ne sme biti pod tlakom.
- Prepričajte se, da je odzračevalna linija vedno višje od odtoka.
- Odzračevalne linije ne zamašite in je ne potopite v vodo.

Če se v analizatorju uporabljajo vnetljivi reagenti, upoštevajte naslednje previdnostne ukrepe:

- Odzračevalna cev ne sme biti speljana v talni sifon.
- Odpadke zavržite v skladu z lokalnimi, regionalnimi in državnimi predpisi.

## 5.5.4 Napeljava analizatorja za preizkus komponent


### ▲ PREVIDNO




Nevarnost požara. Ta izdelek ni namenjen za uporabo z vnetljivimi tekočinami.

Pred začetkom delovanja analizatorja z vsemi reagenti je treba opraviti preizkus komponent z deionizirano vodo. Glejte ilustracije korakov in [Preizkus sestavnih delov](#) na strani 376.

1. Namestite štiri cevi stisnih ventilov, kot je prikazano v naslednjem 1. koraku ilustriranih navodil.
  - a. Pritisnite črni gumb, nato pa potisnite cev v ventil.
  - b. Gumb spustite, ko je cev pravilno nameščena.
2. Prepričajte se, da je odtočna cev pravilno nameščena v posodo za vzorec. Oglejte si ponazorjeni korak 2, ki sledi.
3. Prepričajte se, da je cev posode za razkroj pravilno nameščena v posodo za razkroj. Oglejte si ponazorjeni korak 3, ki sledi.
4. Vse cevi za tekočino analizatorja napeljite do velike steklenice deionizirane vode, da preizkusite sestavne dele. Oglejte si ponazorjeni korak 3, ki sledi. Cev je tovarniško nameščena.



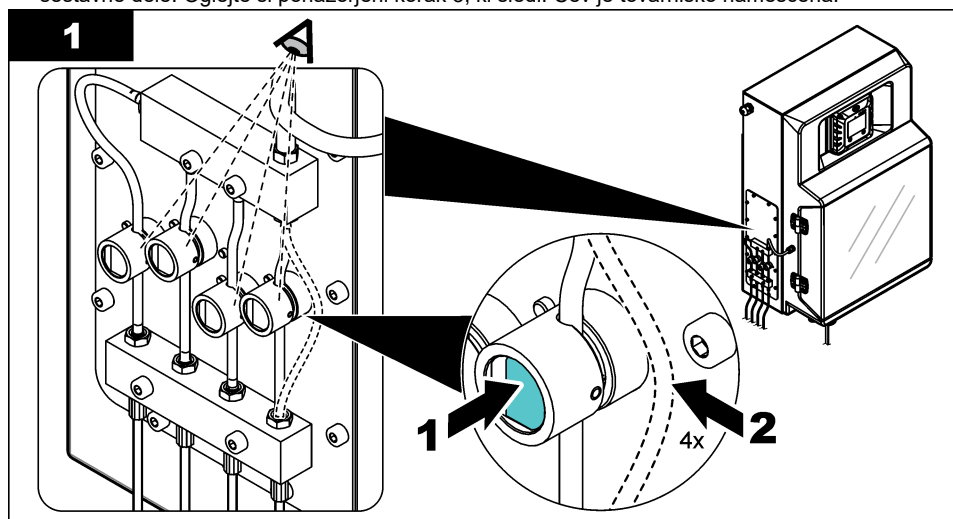


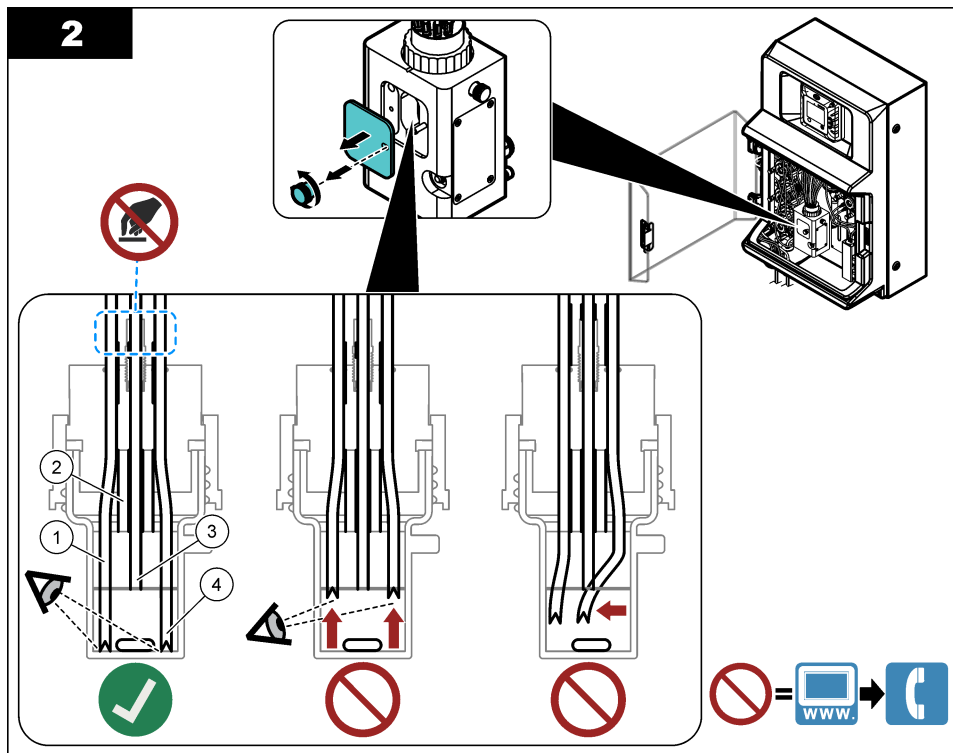**2**

1 Odtočna cev	3 Cev za vzorec
2 Cevi za reagente in zračnik (vrhnja cev)	4 Cevi posode za razkroj

SL


3

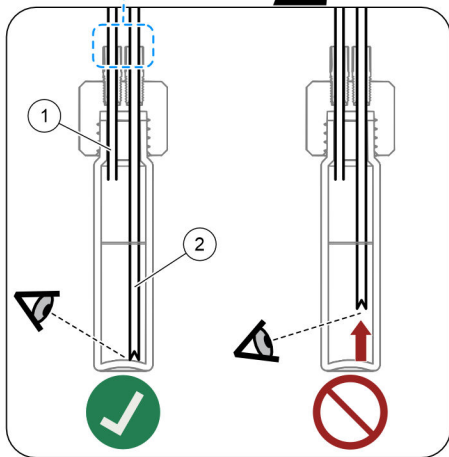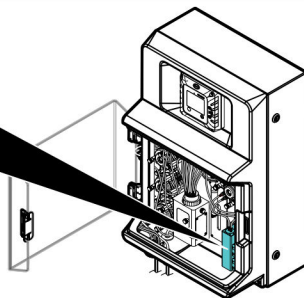

1 Oddušna cev

2 Cevi posode za razkroj

4

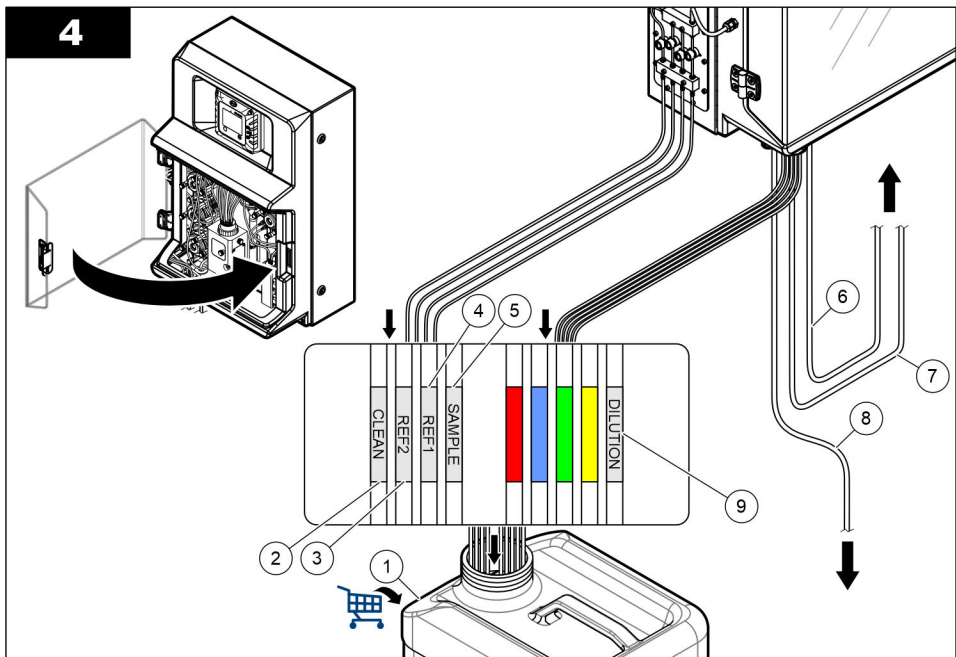

1 Deionizirana voda	4 Cev za raztopino Referenca 1 (REF1)	7 Zračenje posode za razkroj
2 Cev za čistilno raztopino	5 Cev za dovod vzorca	8 Odtočna cev
3 Cev za raztopino Referenca 2 (REF2)	6 Oddušna cev	9 Cevi za redčenje in reagent mikročrpalke

## Razdelek 6 Zagon

### 6.1 Prvi zagon

**Napotek:** Poskrbite, da je instrument pred zagonom dokončno montiran in da so priključene vse cevi ter električne napeljave. Glejte [Namestitev](#) na strani 366.

Ko analizator prvič vklopite, vam bo pomočnik za zagon pomagal pri prvih korakih za dokončanje nastavitve. Izvedite vse korake, ki sledijo, in se prepričajte, da analizator deluje pravilno.

**Napotek:** Prepričajte se, da ste uporabili pravilne reagente za izbrano merilno območje. Za več informacij in slik glejte razširjeni uporabniški priročnik na spletu.

1. Odprite vrata analizatorja. Glejte [Odprite vrata analizatorja](#) na strani 367.
2. VKLOPITE stikalo za vklop/izklop. Glejte [Slika 9](#) na strani 461.
3. S priloženim ključem zaprite vrata analizatorja.
4. Počakajte, da se postopek inicializacije zaključi.
5. Odgovorite na pozive na zaslonu in izberite jezik, časovni pas, datum in čas.  
Za konfiguracijo drugih nastavitev kontrolne enote glejte dokumentacijo kontrolne enote SC4500.
6. Dotaknite se zaslona, da se prikaže meni **EZ2700sc**.
7. Izberite **Meni naprave**, da zaženete pomočnika za zagon.  
Prikaže se začetni zaslon.
8. Za izbiro ustreznega merilnega območja izvedite korake, prikazane na zaslonu. Pritisnite **OK**.

9. Če je nameščena enota za filtriranje, izberite **Vklop**. V nasprotnem primeru izberite **Izklop**.
10. Izberite število kanalov za analizator. Pritisnite **OK**.
11. Če je konfiguracija, prikazana na strani s povzetkom, pravilna, pritisnite **OK**.  
Prikaže se glavni meni **EZ2700sc**.
12. Nadaljujte s preizkusom komponent. Glejte [Preizkus sestavnih delov](#) na strani 376.

## 6.2 Preizkus sestavnih delov

### ▲ OPOZORILO



Nevarnost priščipanja Premikajoči se deli lahko povzročijo poškodbe zaradi priščipanja. Ne dotikajte se premikajočih se delov.

Pred začetkom delovanja analizatorja morate izvesti preizkus sestavnih delov. V meniju **Vzdrževanje** zaženite druge funkcije analizatorja, da preverite delovanje sestavnega dela.

#### Predpogoji:

- Če je analizator v načinu delovanja, izberite **Vzdrževanje > Začetek načina vzdrževanja**.
- Prepričajte se, da je cev z vzorcem, reagentom in raztopino v vsebniku deionizirane vode. Glejte [Napeljava analizatorja za preizkus komponent](#) na strani 372.

#### 6.2.1 Pregled mešala

1. Z enote fotometra odstranite svetlobni ščitnik. Glejte [Slika 13](#) na strani 472.
2. Prepričajte se, da je mešalo na dnu posode za vzorec.  
*Napotek:* Med postopkom vbrizgavanja pregledajte mešalo in se prepričajte, da se pravilno vrti. Postopek vbrizgavanja se začne v razdelku [Pregled črpalk in stisnih ventilov](#) na strani 376.
3. Namestite svetlobni ščitnik na fotometer.

#### 6.2.2 Pregled črpalk in stisnih ventilov

1. Pregledajte delovanje črpalk in stisnih ventilov ter se prepričate, da ne prihaja do puščanja.
2. Prepričajte se, da se posoda za analizo polni z deionizirano vodo. Glejte [Slika 14](#) na strani 475.
3. Prepričajte se, da deionizirana voda odteka skozi odtočno cev.
4. Izberite **Vzdrževanje > Začetek vbrizgavanja** ter vbrizgajte vse tekočine ločeno.  
Če pride do puščanja, pregledajte vse priključke in si oglejte razširjeno različico uporabniškega priročnika na spletu za več informacij.
  - a. Izberite **Prime reference 1** (Zapolnitev reference 1) in pritisnite **OK** (V redu).
  - b. Izberite **Prime reference 2** (Zapolnitev reference 2) in pritisnite **OK** (V redu).
  - c. Izberite **Prime cleaning solution** (Zapolnitev čistilne raztopine) in pritisnite **OK** (V redu).
  - d. Izberite **Prime rinsing** (Zapolnitev izpiranja) in pritisnite **OK** (V redu).
  - e. Izberite **Prime dispenser** (Zapolnitev dozirnika) in pritisnite **OK** (V redu).
  - f. Izberite **Prime channel** (Zapolnitev kanal) > **Prime all channels** (Zapolnitev vseh kanalov) in pritisnite **OK** (V redu).  
Vsak postopek zapolnitve se samodejno ustavi, ko je postopek končan.

#### 6.2.3 Pregled mikročrpalk

Preverite, ali mikročrpalke puščajo in ali so v njih zračni mehurčki.

1. S fotometra odstranite svetlobni ščitnik.
2. Izberite **Vzdrževanje > Začetek vbrizgavanja > Vbrizgavanje vseh reagentov**.

3. Prepričajte se, da deionizirana voda vstopa v mikročrpalko skozi posamezne cevi za (reagent) mikročrpalke. Nato pa nadaljuje neprekinjeno pot v posodo za analizo brez zračnih mehurčkov. Glejte [Slika 15](#) na strani 475.
4. Če mikročrpalke ne delujejo pravilno (mehurčki v ceveh), morate s pomočjo postopka z brizgalko deionizirano vodo potisniti v ustrezne cevi, da mehurčke odstranite. Glejte [Slika 16](#) na strani 476.
5. Namestite svetlobni ščitnik na fotometer.

#### 6.2.4 Izvedite preizkus s fotometrom

Pred preizkusom s fotometrom se prepričajte, da je zunanja stran posode za analizo čista, da se lahko preizkus uspešno zaključi. Če želite očistiti sestavne dele analizatorja, si več informacij oglejte v razširjenem uporabniškem priročniku na spletu.

1. Pritisnite ikono glavnega menija in izberite **Naprave**.
2. Izberite **EZ2700sc**.
3. Pomaknite se navzdol na dno zaslona in izberite **Meni naprave**.
4. Izberite **Vzdrževanje > Preverjanje fotometra**.
5. Pritisnite **OK** za začetek meritve.  
Ko je umerjanje temne vrednosti končano, se na zaslonu prikaže rezultat.
6. Pritisnite **OK**, da nadaljujete.
7. Prepričajte se, da je cev »REF1«  
priključena na posodo, napolnjeno z deionizirano vodo. Prepričajte se, da je svetlobni ščitnik nameščen. Glejte [Slika 18](#) na strani 479.
8. Pritisnite **OK**.  
Počakajte, da se posoda za analizo napolni.
9. S pomočjo izvijača prilagodite napetost izhoda senzorja na 9 V. Glejte [Slika 17](#) na strani 476.
10. Počakajte, da se na zaslonu prikaže vrednost 9 V. Nato pritisnite **OK** (V redu).
11. Pritisnite **OK**, da nadaljujete.

### 6.3 Izvedba preizkusa vhodnega signala

Pred začetkom delovanja analizatorja izvedite preizkus digitalnih vhodov.

**Predpogoji:** Digitalne vhode priključite na zunanje brezpotencialne kontakte (24 V DC).

Po naslednjem postopku izvedite preizkus digitalnega vhodnega signala in analognega izhodnega signala:

1. Pritisnite ikono glavnega menija in izberite **Devices (Naprave)**.
2. Izberite **EZ2700sc**.
3. Pomaknite se navzdol na dno zaslona in izberite **Meni naprave**.
4. Izberite **Diagnostika > Signali**.  
Prikažejo se signali pri digitalnih vhodih.
5. Stanje digitalnih vhodov na zaslonu primerjajte z napetostmi, ki se dovajajo digitalnim vhodom (24 V = Vkllop; 0 v = Izkllop).

### 6.4 Izvedba preizkusa izhodnega signala

Pred začetkom delovanja analizatorja izvedite preizkus analognih izhodov.

**Predpogoji:** Konfigurirajte analogne izhode (AO1–AO8, P101) za izbiro meritev kanala, ki jih predstavlja posamezni analogni izhod. Za več informacij in slik glejte razširjeni uporabniški priročnik na spletu.

Izvedite preizkus analognega izhoda kot sledi:

1. Pritisnite ikono glavnega menija.
2. Izberite **Outputs** (Izhodi) > **mA outputs AOC** (Izhodi mA AOCD) > **Test/Maintenance** (Test/vzdrževanje).

Možnost	Opis
<b>Function test (Preizkus delovanja)</b>	Izvede preizkus izhodov na izbranem modulu.
<b>Output status (Stanje izhoda)</b>	Prikaže stanje izhodov na izbranem modulu.

3. Za merjenje vrednosti mA pri posameznem analognem izhodu uporabite multimeter.
4. Izmerjeno vrednost mA pri analognih izhodih primerjajte s pričakovanim vrednostmi mA.

## 6.5 Nastavitev zaporedja kanalov

Izberite zaporedje, po katerem bo potekalo merjenje kanalov, kolikokrat bo posamezni kanal izmerjen in čas čakanja pred merjenjem kanala. Vnesite največ 16 linij z največ 16 cikli za vsako.

1. Pritisnite ikono glavnega menija in izberite **Naprave**.
2. Izberite **EZ2700sc**.
3. Pomaknite se navzdol na dno zaslona in izberite **Meni naprave**.
4. Če je analizator v načinu delovanja, izberite **Vzdrževanje** > **Začetek načina vzdrževanja**. Počakajte, da analizator preide v način vzdrževanja.
5. Izberite **Konfiguracija** > **Nastavitev zaporedja kanalov**.
6. S pomočjo puščic v stranski vrstici izberite položaj (številko v zaporedju) ter pritisnite **OK**, da konfigurirate ta položaj.
7. Izberite možnost.

Možnost	Opis
<b>Izberi</b>	Izberite ustrezen kanal ali čas čakanja.
<b>Število meritev</b>	Določa število meritev za kanal.
<b>Čas čakanja</b>	Določa čas čakanja za izbrani kanal.

8. Če želite shraniti spremembe, pritisnite **OK**.

## 6.6 Priključitev raztopin in vzorca

### ▲ PREVIDNO



Nevarnost izpostavljenosti kemikalijam. Upoštevajte varnostne predpise v laboratoriju in nosite vso osebno zaščitno opremo, primerno za delo s kemikalijami, ki jih trenutno uporabljate. Za varnostne protokole glejte veljaven varnostni list (MSDS/SDS).

### ▲ PREVIDNO



Nevarnost izpostavljenosti kemikalijam. Kemikalije in odpadke zavržite v skladu z lokalnimi, regionalnimi in nacionalnimi predpisi.

### ▲ PREVIDNO



Nevarnost požara. Ta izdelek ni namenjen za uporabo z vnetljivimi tekočinami.

Vsebniki z reagenti so priloženi analizatorju. Glejte [Slika 18](#) na strani 479. Vsebnike za raztopino Referenca 1 in raztopino Referenca 2 in deonizirano vodo mora zagotoviti uporabnik. Več vsebnikov lahko kupite pri proizvajalcu.

Vsebnike namestite

- čim bližje analizatorju
- 1 meter pod dnom analizatorja

Za namestitvev posode glejte [Slika 18](#) na strani 479.

Reagente in raztopine mora zagotoviti uporabnik. Uporabljajte samo reagente, ki jih zagotavlja certificirano podjetje ali pa uporabite namenske reagente proizvajalca. Reagente lahko uporabnik pripravi tudi sam. Upoštevajte navodila v listu z metodami in reagenti za ustrezen model, ki ga najdete na spletnem mestu proizvajalca.

Cev je tovarniško nameščena. Preberite nalepko na posamezni cevi, da prepoznate ustrezen priključek za vodo. Pravilne reagente, raztopine in standarde najdete v ustreznem listu z metodami in reagenti za model, ki ga najdete na spletnem mestu proizvajalca.

1. Po zaključenem preizkusu sestavnih delov, namestite cevi "CLEAN" (čistilna raztopina), "REF1" (raztopina Referenca 1) in "REF2" (raztopina Referenca 2) v ustrezne vsebnike. Glejte [Slika 18](#) na strani 479.
2. Posamezno barvno označeno cev reagenta namestite v posodo z reagenti z enako barvo na nalepki.
3. Vir vzorca (ali izpust vzorca panela Moduplex ali plošče filtra) priključite na dovodno cev za vzorec analizatorja. Glejte [Slika 18](#) na strani 479.
4. Pritisnite ikono glavnega menija in izberite **Naprave**.
5. Izberite **EZ2700sc**.
6. Pomaknite se navzdol na dno zaslona in izberite **Meni naprave**.
7. Izberite **Vzdrževanje > Začetek vbrizgavanja > Vbrizgavanje za vse**.

## 6.7 Preverjanje pred začetnim zagonom

Izvedite preverjanje za zagotavljanje, da so meritve znotraj dovoljenega območja. Za več informacij in slik glejte razširjeni uporabniški priročnik na spletu.

1. Pritisnite ikono glavnega menija in izberite **Naprave**.
2. Izberite **EZ2700sc**.
3. Pomaknite se navzdol na dno zaslona in izberite **Meni naprave**.
4. Za zagon preverjanja izberite **Umerjanje > Preverjanje > Začetek preverjanja**.  
Pri preverjanju se meri deionizirana voda v posodi Referenca 2.
5. Za prikaz rezultatov izberite možnost:
  - **Umerjanje > Preverjanje > Zgodovina preverjanja**
  - **Diagnostika > Podatki o zgodovini > Preverjanje**

## 6.8 Zagon analizatorja

Za zagon analizatorja:

1. Pritisnite ikono glavnega menija in izberite **Naprave**.
2. Izberite **EZ2700sc**.
3. Pomaknite se navzdol na dno zaslona in izberite **Meni naprave**.
4. Izberite **Vzdrževanje > Začetek načina delovanja**.

## Sadržaj

- |   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1 | <a href="#">Dodatne informacije</a> na stranici 380 | 4 | <a href="#">Opći podaci</a> na stranici 382 |
| 2 | <a href="#">Pregled proizvoda</a> na stranici 380   | 5 | <a href="#">Ugradnja</a> na stranici 384    |
| 3 | <a href="#">Specifikacije</a> na stranici 381       | 6 | <a href="#">Pokretanje</a> na stranici 393  |

## Odjeljak 1 Dodatne informacije

Osnovni korisnički priručnik sadrži informacije koje su dostupne za puštanje u pogon. Prošireni korisnički priručnik dostupan je na mreži i sadrži više informacija.

### ⚠ OPASNOST



Višestruka opasnost! Pojedini odjeljci proširenog korisničkog priručnika koji su prikazani u nastavku navode više informacija.

- Korisničko sučelje i navigacija
- Rad
- Održavanje
- Rješavanje problema
- Popisi zamjenskih dijelova

Skenirajte QR kodove koji slijede za pristup proširenom korisničkom priručniku.



Europski jezici



Američki i azijski jezici

## Odjeljak 2 Pregled proizvoda

Analizator Hach EZ2700sc procesni je analizator koji mjeri jedan parametar u uzorcima vode iz industrijske i okolišne primjene. Pogledajte [Slika 1](#) na stranici 438, [Slika 2](#) na stranici 442 i [Slika 3](#) na stranici 446.

Analizator EZ1000sc mrežni je kolorimetrijski analizator za opću analizu vode (npr. nitrat, fosfat). Analizator ima opcije daljinsko pokretanje, automatska provjera valjanosti, automatska kalibracija, automatsko čišćenje i Modbus.

Voda za uzorak ulazi u analizator kroz cijev za uzorak. Pumpe, ventili i štrcaljke u analizatoru dovode uzorak i reagense u ćeliju za mjerenje na ploči za analizu. Kada se izvrši postupak u posudi za analizu, analizator odbacuje uzorak kroz cijev za odvod. Rezultati analize prikazuju se na zaslonu kontrolera SC4500. Kontroler SC4500 sprema podatke analizatora (zapisnik podataka, zapisnik događaja, zapisnik postavki i servisni zapisnik). Uz pomoć kontrolera SC4500 upotrebjavajte i konfigurirajte analizator.

Da biste povećali broj tokova za uzorke (kanala) koje analizator može mjeriti (2, 4 ili 8), dostupna je ploča Moduplex s više tokova uz analizator.

Za pretkondicioniranje uzorka (filtracija, slijeganje) dostupna je ploča za filtraciju EZ9010, EZ9020, EZ9150, EZ9200 ili EZ9250 uz analizator.

## Odjeljak 3 Specifikacije

Specifikacije se mogu promijeniti bez prethodne najave.

Specifikacije	Pojedinosti
Dimenzije (Š x V x D)	460 x 688 x 340 mm (18,1 x 27,1 x 13,4 inča)
Kućište	IP44; ABS, PMMA i čelik s premazom
Zaslon	IP66, 3,5-inčni TFT zaslon u boji s kapacitivnom dodirnom pločicom
Težina	40 kg (88 lb)
Potrošnja struje	100 do 240 VAC ±10 %, 50/60 Hz
Potrošnja energije	Najviše 240 VA
Visina	Maksimalno 2000 m (6560 ft)
Kategorija prenapona	II
Uvjeti okoline	Samo za uporabu u zatvorenom prostoru
Razina zagađenja	2
Radna temperatura	10 do 30 °C (50 do 86 °F); 5 do 95 % relativne vlažnosti, bez kondenzacije, bez korozivnog djelovanja
Temperatura za pohranu	Maksimalno -20 do 60 °C (-4 do 140 °F); 95 % relativne vlažnosti, bez kondenzacije
Ulazi za uzorke	Jedan
Tlak uzorka	Po vanjskoj posudi za prelijevanje (otvoreno za atmosferski tlak)
Brzina protoka uzorka	100 do 300 ml/min
Temperatura uzorka	10 do 30 °C (50 do 86 °F)
Kvaliteta uzorka	Čestice < 100 µm, maksimalno < 0,1 g/l Mutnoća < 50 NTU
Pročišćavanje zraka za korozivna okruženja	0,2 bar (20 kPa ili 3 psi); suh i čist zrak
Odvod	Atmosferski tlak, s ventilom, min. Ø 32 mm
Uzemljenje	Suha i čista šipka za uzemljenje s niskom impedancijom (< 1 Ω) s kabelom za uzemljenje > 2,5 mm <sup>2</sup> (13 AWG)
Analogni izlazi	Maksimalno osam analognih izlaza od 0 – 20 mA (ili 4 – 20 mA) <b>Napomena:</b> Analogni izlazi napajaju petlju. Nije moguće napajati kontakte sustava SCADA ili PLC.
Digitalni ulazi	Sedam digitalnih ulaza: dva digitalna ulaza za daljinsko pokretanje. Preostali digitalni ulazi služe za buduću upotrebu.
Digitalni izlazi	Četiri digitalna izlaza pod naponom za ventile i pumpe ploče EZ9150; osam digitalnih izlaza pod naponom za ventile ploče Moduplex; 24 VDC, 500 mA.
Releji	Pet kontakata bez potencijala (FCT), maksimalno opterećenje 24 VDC, 0,5 A (otporno opterećenje)
Ethernet priključci	Ethernet veza za Claros i Ethernet priključak za Modbus TCP/IP; LAN verzija; 10/100 Mbps, ili Profinet ili Ethernet IP
RS485 komunikacije	Profibus DP ili Modbus RTU

<sup>2</sup> Informacije o konfiguraciji Ethernet veze i konfiguraciji za Modbus potražite u dokumentaciji za kontroler SC4500.

Specifikacije	Pojedinosti
Certifikati	Certifikati CE, ETL certificirani prema sigurnosnim standardima UL i CSA, UKCA
Jamstvo	1 godina (EU: 2 godine)

## Odjeljak 4 Opći podaci

Proizvođač ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za štetu koja proizlazi iz neispravne uporabe proizvoda ili nepridržavanja uputa u priručniku. Proizvođač zadržava pravo na izmjene u ovom priručniku te na opise proizvoda u bilo kojem trenutku, bez prethodne najave ili obaveze. Revizije priručnika mogu se pronaći na web-stranici proizvođača.

### 4.1 Sigurnosne informacije

Proizvođač nije odgovoran za štetu nastalu nepravilnom primjenom ili nepravilnom upotrebom ovog proizvoda, uključujući, bez ograničenja, izravnu, slučajnu i posljedičnu štetu, te se odriče odgovornosti za takvu štetu u punom opsegu, dopuštenom prema primjenjivim zakonima. Korisnik ima isključivu odgovornost za utvrđivanje kritičnih rizika primjene i za postavljanje odgovarajućih mehanizama za zaštitu postupaka tijekom mogućeg kvara opreme.

Prije raspakiravanja, postavljanja ili korištenja opreme pročitajte cijeli ovaj korisnički priručnik. Poštujte sva upozorenja na opasnost i oprez. Nepoštivanje ove upute može dovesti do tjelesnih ozljeda operatera ili oštećenja na opremi.

Ako se oprema koristi na način koji nije naveo proizvođač, zaštita koju pruža oprema može biti oslabljena. Nemojte koristiti ili instalirati ovu opremu na način koji nije naveden u ovom priručniku.

#### 4.1.1 Korištenje informacija opasnosti

##### ▲ OPASNOST

Označava potencijalno ili neposredno opasnu situaciju koja će, ako se ne izbjegne, dovesti do smrti ili ozbiljnih ozljeda.

##### ▲ UPOZORENJE

Označava potencijalno ili neposredno opasnu situaciju koja će, ako se ne izbjegne, dovesti do smrti ili ozbiljnih ozljeda.

##### ▲ OPREZ



Označava potencijalno opasnu situaciju koja će dovesti do manjih ili umjerenih ozljeda.





##### OBAVIJEST

Označava situaciju koja, ako se ne izbjegne će dovesti do oštećenja instrumenta. Informacije koje je potrebno posebno istaknuti.


#### 4.1.2 Oznake mjera predostrožnosti

Pročitajte sve naljepnice i oznake na instrumentu. Ako se ne poštuju, može doći do tjelesnih ozljeda ili oštećenja instrumenta. Simbol na instrumentu odgovara simbolu u priručniku uz navod o mjerama predostrožnosti.

	Ovo je sigurnosni simbol upozorenja. Kako biste izbjegli potencijalne ozljede poštujujte sve sigurnosne poruke koje slijede ovaj simbol. Ako se nalazi na uređaju, pogledajte korisnički priručnik za rad ili sigurnosne informacije.
	Ovaj simbol naznačuje opasnost od kemikalija i ukazuje da samo osobe koje su kvalificirane i obučene za rad s kemikalijama smiju rukovati kemikalijama ili izvoditi radove održavanja na sustavima za prijenos kemikalija koji su povezani s opremom.

	Ovaj simbol naznačuje da postoji opasnost od električnog i/ili strujnog udara.
	Ovaj simbol naznačuje prisutnost uređaja osjetljivih na električne izboje (ESD) te je potrebno poduzeti sve mjere kako bi se spriječilo oštećivanje opreme.
	Ovaj simbol naznačuje da označena stavka zahtijeva zaštitno uzemljenje. Ako kabel instrumenta nije isporučan s utikačem za uzemljenje, postavite zaštitno uzemljenje na kraj zaštitnog provodnika.
	Električna oprema označena ovim simbolom ne smije se odlagati u europskim domaćim ili javnim odlagalištima. Staru ili isteklu opremu vratite proizvođaču koji će je odložiti bez naknade.

### 4.1.3 Kemijska i biološka sigurnost

<b>⚠ OPASNOST</b>	
	Kemijska ili biološka opasnost. Koristi li se ovaj instrument za praćenje postupka liječenja i/ili sustava kemijskog punjenja za koji postoje zakonska ograničenja i zahtjevi nadzora povezani s javnim zdravstvom, javnom sigurnosti, proizvodnjom ili obradom hrane ili pića, odgovornost je korisnika ovog instrumenta da poznaje i pridržava se primjenjivih propisa i ima dovoljno odgovarajućih mehanizama za sukladnost s primjenjivim propisima u slučaju kvara instrumenta.

### 4.2 Ikone korištene na ilustracijama

			
Dijelovi koje isporučuje proizvođač	Dijelovi koje isporučuje korisnik	Pogledajte	Izvršite korake obrnutim redoslijedom

				
Potrebne su dvije osobe	Poslušajte	Koristite samo prste	Nemojte koristiti alate	Nemojte dodirivati

### 4.3 Namjena

Analizatori serije Hach EZ namijenjeni su osobama koje moraju stalno mjeriti parametre kakvoće vode u uzorcima iz industrijske i okolišne primjene. Analizatori serije Hach EZ ne tretiraju i ne mijenjaju vodu i ne koriste se za kontrolu postupaka.

### 4.4 Komponente proizvoda

Provjerite jeste li primili sve komponente. Pogledajte [Slika 4](#) na stranici 451. Ako neki od ovih elemenata nedostaje ili je oštećen, odmah se obratite proizvođaču ili prodajnom predstavniku.

## Odjeljak 5 Ugradnja

### ⚠ OPASNOST



Višestruka opasnost. Zadatke opisane u ovom odjeljku priručnika treba obavljati isključivo kvalificirano osoblje.

### 5.1 Smjernice za postavljanje

#### ⚠ UPOZORENJE



Opasnost od požara. Korisnik je odgovoran za poduzimanje odgovarajućih mjera opreza prilikom upotrebe opreme u kombinaciji s metodama u kojima se koriste zapaljive tekućine. Pridržavajte se primjenjivih mjera opreza i sigurnosnih protokola za korisnike. Te mjere i protokoli uključuju kontrolu proljevanja i curenja tekućina, ispravno prozračivanje, upotrebu instrumenta isključivo pod nadzorom i neprekidan nadzor instrumenta dok je priključen u napajanje, ali ne ograničavaju se na navedeno.

#### ⚠ OPREZ



Opasnost od izlaganja kemikalijama. Poštujte laboratorijske sigurnosne propise i opremite se svom odgovarajućom osobnom zaštitnom opremom s obzirom na kemikalije kojima ćete rukovati. Sigurnosne protokole potražite na trenutno važećim sigurnosno tehničkim listovima materijala (MSDS/SDS).

#### ⚠ OPREZ



Opasnost od izlaganja kemikalijama. Kemikalije i otpad odložite sukladno lokalnim, regionalnim i državnim propisima.

- Analizator postavite u zatvorenom prostoru u području bez opasnosti.
- Analizator postavite u okolišu zaštićenom od korozivnih tekućina.
- Analizator postavite na čistu i suhu lokaciju s dobrom ventilacijom i kontroliranom temperaturom.
- Analizator postavite što je moguće bliže točki za uzimanje uzorka.
- Nemojte postaviti analizator na mjesto gdje je na izravnoj sunčevoj svjetlosti ili u blizini izvora topline.
- Pazite da ima dovoljno prostora za povezivanje vodovodnih i električnih priključaka.
- Pazite da ima dovoljno prostora ispred analizatora za otvaranje vrata analizatora. Pogledajte [Dimenzije analizatora](#) na stranici 385.
- Vodite računa da su uvjeti okoline unutar specifikacija za rad. Pogledajte [Specifikacije](#) na stranici 381.

Iako analizator nije namijenjen za upotrebu sa zapaljivim uzorcima, neki analizatori EZ upotrebljavaju zapaljive reagense. Više informacija o reagensima koji se upotrebljavaju u analizatoru potražite u listu Method & Reagent (Metoda i reagens) primjenjivog modela serije EZ. Ako analizator upotrebljava zapaljive reagense, pridržavajte se sljedećih sigurnosnih mjera opreza:


- Držite analizator dalje od topline, iskri i otvorenog plamena.
- Ne jedite, ne pijte i ne pušite u blizini analizatora.
- Koristite lokalni ispušni ventilacijski sustav.
- Upotrijebite uređaje i sustave osvjjetljenja otporne na iskrnu i eksploziju.
- Spriječite elektrostatičko pražnjenje. Pogledajte [Mjere predostrožnosti za elektrostatičko pražnjenje \(ESD\)](#) na stranici 385.
- U potpunosti očistite i osušite instrument prije upotrebe.
- Operite ruke prije pauza i na kraju radnog vremena.
- Uklonite onečišćenu odjeću. Operite odjeću prije ponovne upotrebe.
- S tim se tekućinama mora rukovati u skladu sa zahtjevima lokalne regulatorne agencije o dopuštenim granicama izloženosti.

## 5.2 Dimenzije analizatora

Dimenzije analizatora potražite u [Slika 5](#) na stranici 454.

## 5.3 Mehaničko instaliranje

### 5.3.1 Pričvršćivanje instrumenta na zid

▲ UPOZORENJE	
	Opasnost od ozljede. Osigurajte da zidni nosač može držati 4 puta veću težinu od opreme.

▲ UPOZORENJE	
	Opasnost od ozljede. Instrumenti ili dijelovi su teški. Za postavljanje i pomicanje koristite pomoć.

▲ UPOZORENJE	
	Opasnost od ozljede. Objekt je težak. Za siguran rad instrument mora biti sigurno pričvršćen na zid, stol ili pod.

Isporučeni nosačima za montažu pričvrstite instrument u uspravnom i ravnom položaju na ravnu, okomitu zidnu površinu. Pogledajte [Slika 6](#) na stranici 456.

Postavite instrument na mjesto i položaj gdje ga korisnik može lako odspojiti od izvora napajanja.

Pazite da ima dovoljno prostora ispod analizatora radi postavljanja boca.

Elemente za montažu isporučuje korisnik. Provjerite ima li zidni pričvršćivač dovoljan kapacitet nosivosti (približno 160 kg ili 353 lb). Hardver za montažu mora biti odobren za svojstva zida.

### 5.3.2 Otvorite vrata analizatora

Koristite isporučeni ključ za otključavanje dvije brave na strani analizatora. Pogledajte [Slika 7](#) na stranici 456. Prije rukovanja zatvorite vrata kako biste održali ekološki razred kućišta i sigurnost.

## 5.4 Električna instalacija

▲ OPASNOST	
	Opasnost od strujnog udara. Prije priključivanja strujnih kabela uvijek isključite napajanje uređaja.

### 5.4.1 Mjere predostrožnosti za elektrostatičko pražnjenje (ESD)

OBAVIJEST	
	Potencijalna šteta na instrumentu. Statički elektricitet može oštetiti osjetljive unutrašnje elektroničke komponente, što može dovesti do lošeg rada i kvarova.

Pogledajte korake u ovom postupku za sprječavanje oštećenja od elektrostatičkog pražnjenja na instrumentu.

- Dotaknite metalnu uzemljenu površinu poput kućišta instrumenta, metalnu cijev ili cijev za pražnjenje statičkog elektriciteta iz tijela.
- Izbjegavajte prekomjerna pomicanja. Statički osjetljive komponente transportirajte u anti-statičkim spremnicima ili pakiranjima.
- Nosite traku na ručnom zglobu priključenu na žicu uzemljenja.
- Radite u statički sigurnom području s antistatičkim jastučićima na podu i radnom stolu.

## 5.4.2 Pristup električnoj struji

Provucite kabele vanjskih uređaja kroz ulaznice kabela. Pogledajte [Slika 8](#) na stranici 458. Utikače koji se ne upotrebljavaju čuvajte u ulaznicama kabela.

[Slika 9](#) na stranici 461 prikazuje komponente unutar analizatora. Prekidač napajanja je sklopka koja automatski prekida glavni izvor napajanja iz voda za izmjenično napajanje ako dođe do preopterećenja (npr. kratkog spoja) ili prenapona.

## 5.4.3 Priključivanje vanjskih uređaja

Priključite vanjske uređaje koji će se upotrebljavati s analizatorom na signalne i upravljačke terminale u analizatoru. Pogledajte [Slika 10](#) na stranici 464 i [Tablica 1](#) na stranici 386.

**Tablica 1 Signalni i upravljački terminali – opisi**

Pin	Opis
AO1 – AO8 (P101)	Osam analognih izlaza za upravljanje vanjskim uređajima. Verzija proširenog korisničkog priručnika na mreži navodi dodatne informacije.
FCT1 – FCT5 (P102)	Pet releja (kontakti bez potencijala). Maksimalno opterećenje iznosi 24 VDC, 0,5 A. <ul style="list-style-type: none"><li>• FCT1 — alarm za kvar</li><li>• FCT2 — alarm za održavanje</li><li>• FCT3 — analizator spreman</li><li>• FCT4 i FCT5 — za buduću upotrebu</li></ul>
DI1 – DI7 (P103)	Sedam digitalnih ulaza za daljinsko upravljanje analizatorom <sup>5</sup> Priključite digitalne ulaze na vanjski kontakt bez potencijala (24 VDC) da biste potaknuli analizator da započne mjerenje za kanal. <ul style="list-style-type: none"><li>• DI1 — daljinsko pokretanje za kanal 1</li><li>• DI2 — daljinsko pokretanje za kanal 2</li><li>• DI3 do DI7 — za buduću upotrebu</li></ul>
FB1 – FB4 (P104)	Priključite Profibus DP ili Modbus RTU (RS485) <b>Profibus DP:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• FB1 — A1 (ulaz)</li><li>• FB2 — A2 (izlaz)</li><li>• FB3 — B1 (ulaz)</li><li>• FB4 — B2 (izlaz)</li><li>• SHL — zaštita</li></ul> <b>Modbus RTU:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• FB1 — D (+)</li><li>• FB2 — D (-)</li><li>• FB3 — ne upotrebljava se</li><li>• FB4 — ne upotrebljava se</li><li>• SHL — zaštita</li></ul> Pogledajte dokumentaciju za kontroler SC4500 za upute za konfiguraciju Modbusa i oznake telegrama.
24 VDC / 1 A (P105)	Napajanje od 24 V DC za jedinice za filtraciju EZ9010 i EZ9020

<sup>5</sup> Ako je analizator u načinu održavanja, daljinsko upravljanje je onemogućeno.

**Tablica 1 Signalni i upravljački terminali – opisi (nastavak)**

Pin	Opis
STR1 – STR8 (P106)	Osam digitalnih izlaza za opcionalnu ploču Moduplex. Priključite ogoljene žice svakog ventila kanala na ploči Moduplex na pripadajuće priključke STR. <ul style="list-style-type: none"> <li>• STR1 — kanal 1</li> <li>• STR2 — kanal 2</li> <li>• ...</li> <li>• STR8 — kanal 8</li> </ul>
EXT9 – EXT12 (P107)	Četiri digitalna izlaza za opcionalnu ploču za filtraciju EZ9150. Priključite električne ventile i pumpu na ploči za filtraciju EZ9150 na priključke EXT. <ul style="list-style-type: none"> <li>• EXT9 — ventil za ispiranje</li> <li>• EXT10 — ventil za povratno ispiranje</li> <li>• EXT11 — ventil odvoda za prelijevanje</li> <li>• EXT12 — pumpa za filtraciju</li> </ul>
D01 – D06 (P108 i P109)	Šest izlaza pneumatskog ventila za ploču EZ9150. <ul style="list-style-type: none"> <li>• D01 — ulazni ventil uzorka</li> <li>• D02 — ventil odvoda preljeva</li> <li>• D03 — ventil kanala 1</li> <li>• D04 — ventil kanala 2</li> <li>• D05 — ventil kanala 3</li> <li>• D06 — ventil kanala 4</li> </ul>

HR

#### 5.4.4 Priključivanje izvora izmjeničnog napajanja

### ⚠ OPASNOST



Opasnost od udara električne struje i požara. Pobrinite se da su isporučeni kabel i utikač sukladni odgovarajućim državnim standardima.


- Provjerite je li sklopka s odgovarajućim kapacitetom električne struje instalirana na liniju napajanja.
- Pobrinite se da se osigurač ili prekidač u slučaju nužde instalira blizu analizatora kako bi se analizator mogao trenutno isključiti s napajanja u slučaju potrebe.
- Priključite opremu u skladu s lokalnim, državnim i nacionalnim pravilima za električnu struju.
- Provućite isporučeni kabel za napajanje kroz uvodnicu kabela koja se nalazi na bočnoj strani analizatora.
- Zategnite uvodnicu kabela kako bi čvrsto držala kabel za napajanje i kako bi se održao ekološki razred kućišta.

Priključite analizator na izmjenično napajanje s pomoću priloženog kabela za izmjenično napajanje. Pogledajte [Tablica 2](#) na stranici 388 i [Slika 11](#) na stranici 468.

## O B A V I J E S T

Nemojte uključivati prekidač napajanja. Spojite sve električne spojeve i spojeve cijevi prije pokretanja jer u suprotnom može doći do oštećenja analizatora.

**Tablica 2 Informacije o ožičenju – izmjenično napajanje**

Terminal	Opis	Boja kabela—Sjeverna Amerika i Kanada	Boja kabela—EU
L	Faza (L)	Crna (1)	Smeđa
N	Neutralna (N)	Bijela (2)	Plava
	Uzemljenje (PE)	Zelena sa žutom prugom	Zelena sa žutom prugom

## 5.5 Cijevi

### 5.5.1 Smjernice za korištenje cijevi za izuzimanje uzorka

#### ▲ OPREZ



Opasnost od požara. Proizvod nije namijenjen upotrebi sa zapaljivim uzorcima.

Za najbolju izvedbu instrumenta odaberite prikladnu, reprezentativnu točku uzorkovanja. Uzorak mora biti reprezentativan za cijeli sustav.

- Provjerite je li protok uzorka veći od protoka analizatora.
- Provjerite je li cijev uzorka na atmosferskom tlaku ako analizator upotrebljava peristaltičku pumpu za prijenos uzorka u posudu za analizu.
- Provjerite uzima li se uzorak u cijev uzorka iz male posude za prelijevanje u blizini analizatora.
- Upotrijebite priloženi vod za uzorak. Nemojte mijenjati duljinu voda za uzorak.

Uzorak u posudi za prelijevanje mora se kontinuirano dopunjavati. Ako je veličina krutih tvari u uzorku prevelika, također se preporučuje filtriranje uzorka.

### 5.5.2 Smjernice za vodove za odvod

#### ▲ UPOZORENJE



Opasnost od požara. Korisnik je odgovoran za poduzimanje odgovarajućih mjera opreza prilikom upotrebe opreme u kombinaciji s metodama u kojima se koriste zapaljive tekućine. Pridržavajte se primjenjivih mjera opreza i sigurnosnih protokola za korisnike. Te mjere i protokoli uključuju kontrolu prolijevanja i curenja tekućina, ispravno prozračivanje, upotrebu instrumenta isključivo pod nadzorom i neprekidan nadzor instrumenta dok je priključen u napajanje, ali ne ograničavaju se na navedeno.

#### ▲ OPREZ



Opasnost od izlaganja kemikalijama. Kemikalije i otpad odložite sukladno lokalnim, regionalnim i državnim propisima.

## O B A V I J E S T

Ne povežite vodove za odvod na druge vodove jer bi moglo doći do protutlaka ili oštećenja analizatora. Provjerite jesu li vodovi za odvod otvoreni prema zraku.

## OBAVIJEST

Kako biste spriječili protutlak i oštećenje analizatora, provjerite je li analizator na višem položaju od korištenog odvoda postrojenja te ima li vodovi za odvod stalan nagib prema dolje. Postavite vodove za odvod s 2,54 cm (1 inč) ili više vertikalnog pada na svakih 0,3 m (1 stopa) cijevi.

Analizator upotrebljava vod za odvod za otpuštanje uzorka i reagensa nakon analize. Ispravno postavljanje vodova za odvod važno je za potpuno uklanjanje tekućine iz instrumenta. Zbog neispravnog postavljanja tekućina se može vratiti u instrument i prouzročiti štetu. Podni ili umivaonički odvod dovoljan je za vod za odvod. Preporučeni vanjski promjer odvodne cijevi je 32 mm. Pogledajte [Slika 12](#) na stranici 470.

- Vodovi za odvod moraju biti što kraći.
- Pobrinite se da je odvod niže od analizatora.
- Vodovi za odvod moraju imati konstantan nagib prema dolje.
- Vodovi za odvod ne smiju biti oštro presavijeni niti stegnuti.
- Vodovi za odvod moraju biti otvoreni za zrak i imati nulti tlak.
- Vodovi za odvod moraju biti odvojeni od okoline u prostoriji za ugradnju.
- Nemojte blokirati ili potapati vod za odvod.

Preporučeno je i priključak na vodu blizu analizatora kako bi se odvod i vod za odvod mogli redovito ispirati čistom vodom čime se sprečava začepljenje zbog kristalizacije.

Više informacija o reagensima koji se upotrebljavaju u analizatoru potražite u listu Method & Reagent (Metoda i reagens) primjenjivog modela serije EZ. Ako analizator upotrebljava zapaljive reagense, pridržavajte se sljedećih sigurnosnih mjera opreza:

- Ne priključujte odvodnu liniju na podni odvod.
- Zbrinite otpad u skladu s lokalnim, državnim i nacionalnim propisima o okolišu.

### 5.5.3 Smjernice za ispušne vodove

#### ▲ UPOZORENJE



Opasnost od požara. Korisnik je odgovoran za poduzimanje odgovarajućih mjera opreza prilikom upotrebe opreme u kombinaciji s metodama u kojima se koriste zapaljive tekućine. Pridržavajte se primjenjivih mjera opreza i sigurnosnih protokola za korisnike. Te mjere i protokoli uključuju kontrolu proljevanja i curenja tekućina, ispravno prozračivanje, upotrebu instrumenta isključivo pod nadzorom i neprekidan nadzor instrumenta dok je priključen u napajanje, ali ne ograničavaju se na navedeno.

#### ▲ OPREZ



Opasnost od izlaganja kemikalijama. Kemikalije i otpad odložite sukladno lokalnim, regionalnim i državnim propisima.

## OBAVIJEST

Ne povezujte ispušni vod (otvor za ispušne plinove) na druge vodove jer bi moglo doći do protutlaka ili oštećenja analizatora. Ispušni vod mora biti otvoren prema zraku s vanjske strane zgrade.

## OBAVIJEST

Kako biste spriječili protutlak i oštećenje analizatora, provjerite je li analizator na višem položaju od korištenog ispušnog odvoda postrojenja te imaju li ispušni vodovi stalan nagib prema dolje. Postavite ispušni vod s 2,54 cm (1 inč) ili više vertikalnog pada na svakih 0,3 m (1 stopa) cijevi.

Analizator s pomoću ispušnog voda održava posudu za analizu pri atmosferskom tlaku. Pravilno postavljanje ispušnog voda važno je kako bi se osiguralo da tijekom rada pumpe tekućina ne ulazi u posudu za analizu iz ispušnog voda. Zbog neispravnog postavljanja plin se može vratiti u analizator i prouzročiti štetu. Preporučeni vanjski promjer glavne cijevi za ispušni vod je 32 mm. Pogledajte [Slika 12](#) na stranici 470.

- Ispušni vod mora biti što kraći.
- Ispušni vod mora imati konstantan nagib prema dolje.

- Ispušni vod ne smije biti oštro presavijen niti stegnut.
- Ispušni vod mora biti odvojen od okoline u prostoriji za ugradnju i ne smije biti pod tlakom.
- Pazite da je ispušni vod uvijek na višem položaju nego odvod.
- Nemojte blokirati ili potapati ispušni vod.

Ako analizator upotrebljava zapaljive reagense, pridržavajte se sljedećih sigurnosnih mjera opreza:

- Ne priključujte ispušni vod na podni odvod.
- Zbrinite otpad u skladu s lokalnim, državnim i nacionalnim propisima o okolišu.

## 5.5.4 Priklučivanje cijevi analizatora za test komponenti


### ⚠ OPREZ




Opasnost od požara. Proizvod nije namijenjen korištenju sa zapaljivim tekućinama.

Prije nego se analizator sa svim reagensima pusti u rad, mora se provesti test komponenti s deioniziranom vodom. Pogledajte ilustrirane korake do [Obavljanje testiranja komponenti](#) na stranici 394.

1. Montirajte četiri cijevi sa steznim ventilima kao što je prikazano na ilustriranom koraku 1 koji slijedi.
  - a. Pritisnite crni gumb, a zatim gurnite cijev u ventil.
  - b. Otпустite gumb kada je cijev pravilno montirana.
2. Uvjerite se da je odvodna cijev ispravno instalirana u posudi za uzorak. Pogledajte ilustrirani korak 2 u nastavku.
3. Uvjerite se da je cijev uređaja za razgradnju ispravno instalirana u posudi za uređaj za razgradnju. Pogledajte ilustrirani korak 3 u nastavku.
4. Priključite sve cijevi za tekućinu analizatora na veliku bocu deionizirane vode kako biste izvršili testiranje komponenti. Pogledajte ilustrirani korak 3 u nastavku. Cijevi su postavljene u tvornici.



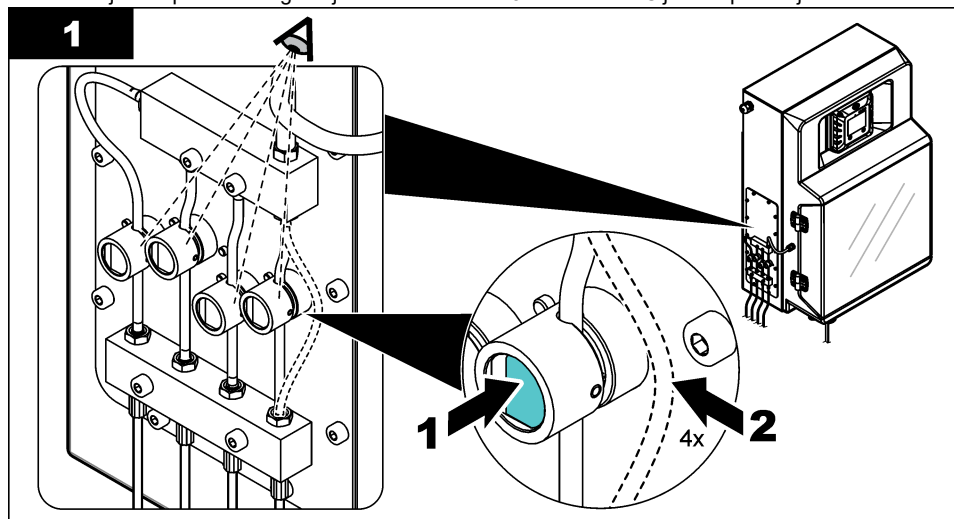


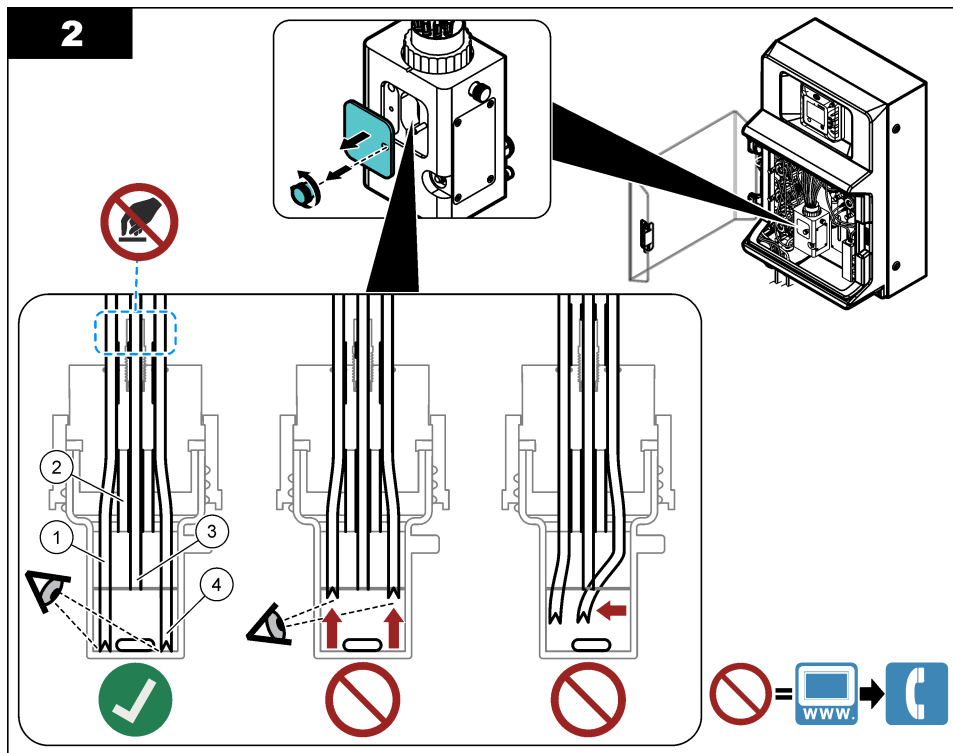**2**

HR

1 Odvodna cijev	3 Cijev za uzorak
2 Cijevi za reagense i odzračivanje (gornja cijev)	4 Cijev uređaja za razgradnju


3

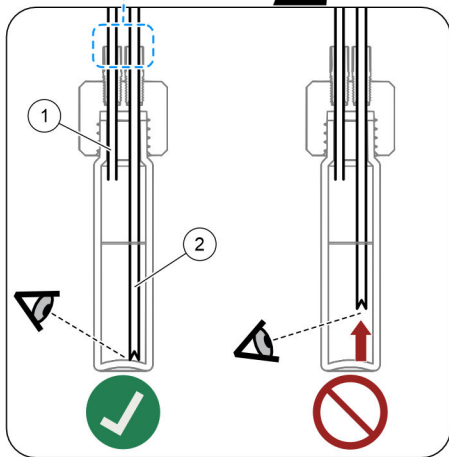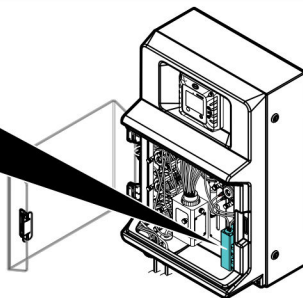

1 Cijev za odzračivanje

2 Cijev uređaja za razgradnju

4

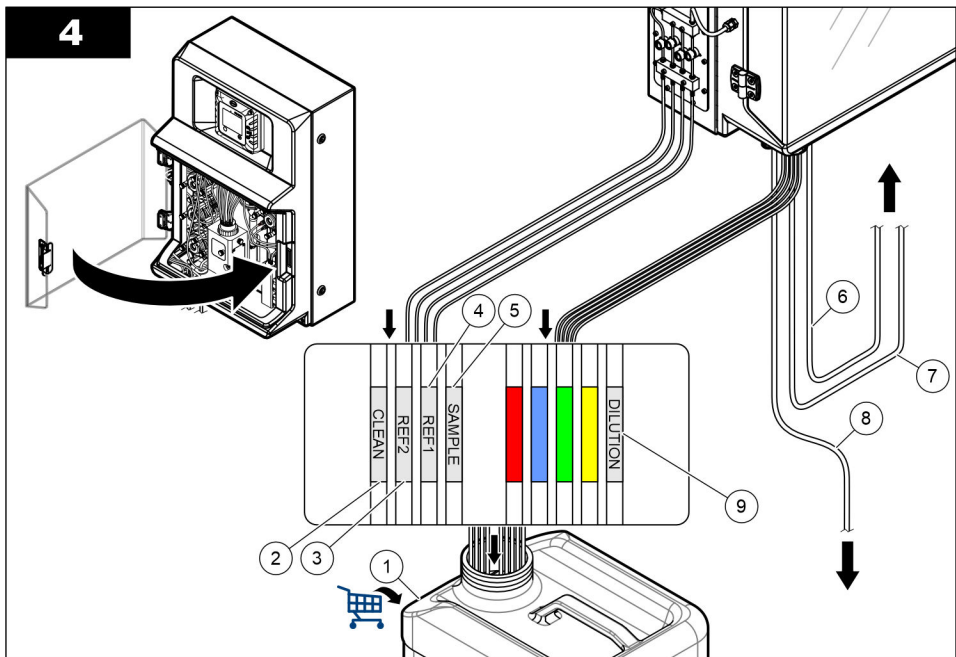

1 Deionizirana voda	4 Cijev za otopinu Referenca 1 (REF1)	7 Cijev za odzračivanje uređaja za razgradnju
2 Cijev za otopinu za čišćenje	5 Cijev ulaza za uzorak	8 Odvodna cijev
3 Cijev za otopinu Referenca 2 (REF2)	6 Cijev za odzračivanje	9 Cijev mikropumpe za razrjeđivanje i reagens

## Odjeljak 6 Pokretanje

### 6.1 Početno pokretanje

**Napomena:** Uvjerite se da su montaža, cijevi i električne instalacije u potpunosti dovršene prije pokretanja. Pogledajte [Ugradnja](#) na stranici 384.

Kad se analizator prvi put postavi na Uključeno, pomoćnik za pokretanje pomoći će prilikom prvih koraka za dovršavanje postavljanja. Dovožite sve korake u nastavku kako biste se uvjerali da analizator radi ispravno.

**Napomena:** Pazite da primijenite ispravne reagensne za odabrani raspon mjerenja. Verzija proširenog korisničkog priručnika na mreži navodi dodatne informacije.

1. Otvorite vrata analizatora. Pogledajte [Otvorite vrata analizatora](#) na stranici 385.
2. Postavite prekidač napajanja u položaj ON (Uključeno). Pogledajte [Slika 9](#) na stranici 461.
3. Zatvorite vrata analizatora priloženim ključem.
4. Pričekajte da se postupak inicijalizacije dovrši.
5. Odgovorite na upite na zaslonu da biste odabrali jezik, vremensku zonu, datum i vrijeme. Za konfiguriranje ostalih postavki kontrolera pogledajte dokumentaciju za kontroler SC4500.
6. Dodirnite zaslon za prikaz izbornika **EZ2700sc**.
7. Odaberite **Izbornik uređaja** kako biste pokrenuli pomoćnika za pokretanje. Prikazuje se početni zaslon.

8. Dovršite korake prikazane na zaslonu kako biste odabrali primjenjivi raspon mjerenja. Pritisnite **U redu**.
9. Ako je instalirana jedinica za filtraciju, odaberite **Uključeno**. Ako ne, odaberite **Isključeno**.
10. Odaberite broj kanala za analizator. Pritisnite **U redu**.
11. Ako je konfiguracija prikazana na stranici sa sažetkom točna, pritisnite **U redu**.  
Glavni izbornik **EZ2700sc** prikazuje.
12. Nastavite s testom komponenti. Pogledajte [Obavljanje testiranja komponenti](#) na stranici 394.

## 6.2 Obavljanje testiranja komponenti

### ▲ UPOZORENJE



Opasnost od uklještenja. Pomični dijelovi mogu uklještit i izazvati ozljede. Ne dirajte pomične dijelove.

Izvršite testiranja komponenti prije stavljanja analizatora u upotrebu. Uz pomoć izbornika **Održavanje** pokrenite različite funkcije analizatora za provjeru rada komponenti.

#### Preduvjeti:

- Ako je analizator u načinu rada, odaberite **Održavanje > Pokretanje načina održavanja**.
- Pobrinite se da su cijev za uzorak, reagens i otopinu unutar spremnika deionizirane vode. Pogledajte [Priključivanje cijevi analizatora za test komponenti](#) na stranici 390.

#### 6.2.1 Pregledavanje miješalice

1. Uklonite zaštitu od svjetla s jedinice fotometra. Pogledajte [Slika 13](#) na stranici 472.
2. Uvjerite se da je miješalica na dnu posude za uzorak.  
***Napomena:** Pregledajte miješalicu tijekom postupka pripreme kako biste se uvjerali da se miješalica pravilno okreće. Postupak pripreme započinje u [Pregledavanje pumpi i steznih ventila](#) na stranici 394.*
3. Postavite zaštitu od svjetla na fotometar.

#### 6.2.2 Pregledavanje pumpi i steznih ventila

1. Provjerite rad pumpi i steznih ventila kako biste osigurali da nema curenja.
2. Pobrinite se da se posuda za analizu puni deioniziranom vodom. Pogledajte [Slika 14](#) na stranici 474.
3. Pobrinite se da deionizirana voda izlazi kroz odvodnu cijev.
4. Odaberite **Održavanje > Početak pripreme** i pripremite sve tekućine zasebno.  
Ako se pojavi curenje, pregledajte sve priključke, a verzija proširenog korisničkog priručnika na mreži navodi dodatne informacije.
  - a. Odaberite **Priprema reference 1** i pritisnite **U redu**.
  - b. Odaberite **Priprema reference 2** i pritisnite **U redu**.
  - c. Odaberite **Priprema otopine za čišćenje** i pritisnite **U redu**.
  - d. Odaberite **Priprema ispiranja** i pritisnite **U redu**.
  - e. Odaberite **Priprema dozatora** i pritisnite **U redu**.
  - f. Odaberite **Priprema kanala > Priprema svih kanala** i pritisnite **U redu**.  
Svaki postupak pripreme automatski se zaustavlja pri završetku postupka.

### 6.2.3 Pregledavanje mikropumpi

Pregledajte ima li na mikropumpama curenja i mjehurića zraka.

1. Uklonite zaštitu od svjetla s fotometra.
2. Odaberite **Održavanje > Početak pripreme > Priprema svih reagensa**.
3. Pobrinite se da deionizirana voda ulazi u mikropumpu kroz svaku od cijevi za mikropumpu (reagens). Zatim treba neprekidno ulaziti u posudu za analizu bez mjehurića zraka. Pogledajte [Slika 15](#) na stranici 475.
4. Ako mikropumpe ne rade pravilno (mjehurići u cijevima), upotrijebite postupak sa štrcaljkom za potiskivanje deionizirane vode u odgovarajuće cijevi radi uklanjanja mjehurića. Pogledajte [Slika 16](#) na stranici 476.
5. Postavite zaštitu od svjetla na fotometar.

### 6.2.4 Izvršite provjeru fotometrom

Pobrinite se da je vanjska strana spremnika za analizu čista prije provjere fotometrom kako biste osigurali uspješnu provjeru. Više informacija o čišćenju komponenata analizatora potražite u mrežnoj proširenoj verziji korisničkog priručnika.

1. Pritisnite ikonu glavnog izbornika, zatim odaberite **Uređaji**.
2. Odaberite **EZ2700sc**.
3. Pomaknite se na dno zaslona i zatim odaberite **Izbornik uređaja**.
4. Odaberite **Održavanje > Provjera fotometra**.
5. Za pokretanje mjerenja pritisnite **U redu**.  
Kad se dovrši tamna kalibracija, rezultat se prikazuje na zaslonu.
6. Pritisnite **U redu** za nastavak.
7. Uvjerite se da je cijev "REF1" priključena na spremnik napunjen deioniziranom vodom. Pobrinite se da je zaštita od svjetla montirana. Pogledajte [Slika 18](#) na stranici 478.
8. Pritisnite **U redu**.  
Pričekajte da se posuda za analizu napuni.
9. Odvijačem prilagodite napon izlaza senzora na 9 V. Pogledajte [Slika 17](#) na stranici 476.
10. Pričekajte dok se na zaslonu ne pojavi vrijednost 9 V. Zatim pritisnite **U redu**.
11. Pritisnite **U redu** za nastavak.

## 6.3 Izvršite testiranje ulaznog signala

Izvršite testiranje digitalnih ulaza prije stavljanja analizatora u upotrebu.

**Preduvjeti:** Priključite digitalne ulaze na vanjski kontakt bez potencijala (24 VDC).

Izvršite testiranje signala digitalnog ulaza i signala analognog izlaza kako slijedi:

1. Pritisnite ikonu glavnog izbornika, zatim odaberite **Uređaji**.
2. Odaberite **EZ2700sc**.
3. Pomaknite se na dno zaslona i zatim odaberite **Izbornik uređaja**.
4. Odaberite **Dijagnostika > Signali**.  
Prikazuju se signali na digitalnim ulazima.
5. Usporedite status digitalnih ulaza na zaslonu s naponima koji se isporučuju na digitalnim ulazima (24 V = Uključeno; 0 V = Isključeno).

## 6.4 Izvršite testiranje izlaznog signala

Izvršite testiranje analognih izlaza prije stavljanja analizatora u upotrebu.

**Preduvjeti:** Konfigurirajte analogne izlaze (AO1 – AO8, P101) za odabir mjerenja kanala koji predstavlja svaki analogni izlaz. Verzija proširenog korisničkog priručnika na mreži navodi dodatne informacije.

Izvršite testiranje analognog izlaza na sljedeći način:

1. Pritisnite ikonu glavnog izbornika.
2. Odaberite **Izlazi > izlazi mA AOC > Testiranje/Održavanje**.

Opcija	Opis
<b>Test funkcija</b>	Izvršava testiranje na izlazima odabranog modula.
<b>Status izlaza</b>	Prikazuje stanje izlaza na odabranom modulu.

3. Upotrijebite multimetar za mjerenje vrijednosti mA na svakom analognom izlazu.
4. Usporedite vrijednost mA izmjerenu na analognim izlazima s očekivanim vrijednostima mA.

## 6.5 Postavljanje redoslijeda kanala

Odaberite redoslijed mjerenja kanala, broj mjerenja svakog kanala i vrijeme čekanja prije mjerenja kanala. Unesite najviše 16 vodova s po najviše 16 ciklusa.

1. Pritisnite ikonu glavnog izbornika, zatim odaberite **Uređaji**.
2. Odaberite **EZ2700sc**.
3. Pomaknite se na dno zaslona i zatim odaberite **Izbornik uređaja**.
4. Ako je analizator u načinu rada, odaberite **Održavanje > Pokretanje načina održavanja**. Pričekajte da analizator bude u načinu održavanja.
5. Odaberite **Konfiguracija > Postavljanje redoslijeda kanala**.
6. S pomoću strelica na bočnoj traci odaberite položaj (broj u redoslijedu), a zatim pritisnite **U redu** za konfiguriranje tog položaja.
7. Odaberite opciju.

Opcija	Opis
<b>Odaberi</b>	Odabire primjenjivi kanal ili vrijeme čekanja.
<b>Broj mjerenja</b>	Postavlja broj mjerenja za kanal.
<b>Vrijeme čekanja</b>	Postavlja vrijeme čekanja za odabrani kanal.

8. Za spremanje promjena pritisnite **U redu**.

## 6.6 Priključivanje otopina i uzorka

### ▲ OPREZ



Opasnost od izlaganja kemikalijama. Poštujte laboratorijske sigurnosne propise i opremite se svom odgovarajućom osobnom zaštitnom opremom s obzirom na kemikalije kojima ćete rukovati. Sigurnosne protokole potražite na trenutno važećim sigurnosno tehničkim listovima materijala (MSDS/SDS).

### ▲ OPREZ



Opasnost od izlaganja kemikalijama. Kemikalije i otpad odlažite sukladno lokalnim, regionalnim i državnim propisima.



Opasnost od požara. Proizvod nije namijenjen korištenju sa zapaljivim tekućinama.

Spremnici reagensa isporučuju se s analizatorom. Pogledajte [Slika 18](#) na stranici 478. Spremnike za otopinu Referenca 1, otopinu Referenca 2 i deioniziranu vodu nabavlja korisnik. Moguće je od proizvođača kupiti još spremnika.

Ugradite spremnike

- što je bliže moguće analizatoru
- 1 metar ispod dna analizatora

[Slika 18](#) na stranici 478 prikazuje instalaciju spremnika.

Reagense i otopine nabavlja korisnik. Upotrebljavajte isključivo reagense koje isporučuje certificirano društvo ili upotrijebite reagense koje odredi proizvođač. Alternativno, reagense može pripremiti korisnik. Slijedite upute u listu Method & Reagent (Metoda i reagens) za odgovarajući model koji se može pronaći na web-mjestu proizvođača.

Cijevi su postavljene u tvornici. Pročitajte naljepnicu na svakoj cijevi da biste identificirali ispravne vodovodne priključke. Pročitajte odgovarajući list Method & Reagent (Metoda i reagens) za model koji se može pronaći na web-mjestu proizvođača kako biste pronašli ispravne reagense, otopine i standarde.

1. Nakon dovršetka testiranja komponenti montirajte cijevi „CLEAN” (otopina za čišćenje), „REF1” (otopina Referenca 1) i „REF2” (otopina Referenca 2) u pripadajuće spremnike. Pogledajte [Slika 18](#) na stranici 478.
2. Montirajte svaku cijev reagensa označenu bojom u spremnik reagensa s istom bojom na naljepnici.
3. Priključite izvor uzorka (ili izlaz uzorka ploče Moduplex ili ploče filtra) na cijev za ulaz uzorka analizatora. Pogledajte [Slika 18](#) na stranici 478.
4. Pritisnite ikonu glavnog izbornika, zatim odaberite **Uređaji**.
5. Odaberite **EZ2700sc**.
6. Pomaknite se na dno zaslona i zatim odaberite **Izbornik uređaja**.
7. Odaberite **Održavanje > Početak pripreme > Priprema svih**.

## 6.7 Izvršite provjeru valjanosti prije početnog pokretanja

Izvršite provjeru valjanosti da biste provjerili jesu li mjerenja unutar raspona tolerancije. Verzija proširenog korisničkog priručnika na mreži navodi dodatne informacije.

1. Pritisnite ikonu glavnog izbornika, zatim odaberite **Uređaji**.
2. Odaberite **EZ2700sc**.
3. Pomaknite se na dno zaslona i zatim odaberite **Izbornik uređaja**.
4. Za pokretanje provjere valjanosti odaberite **Kalibracija > Provjera valjanosti > Pokretanje provjere valjanosti**.  
Provjerom valjanosti mjeri se deionizirana voda u boci Referenca 2.
5. Za prikaz rezultata odaberite opciju:
  - **Kalibracija > Provjera valjanosti > Povijest provjere valjanosti**
  - **Dijagnostika > Povijesni podaci > Provjera valjanosti**

## 6.8 Pokretanje analizatora

Za pokretanje analizatora:

1. Pritisnite ikonu glavnog izbornika, zatim odaberite **Uređaji**.
2. Odaberite **EZ2700sc**.
3. Pomaknite se na dno zaslona i zatim odaberite **Izbornik uređaja**.
4. Odaberite **Održavanje > Pokretanje načina rada**.

## Πίνακας περιεχομένων

- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| 1 Πρόσθετες πληροφορίες στη σελίδα 399 | 4 Γενικές πληροφορίες στη σελίδα 401 |
| 2 Επισκόπηση προϊόντος στη σελίδα 399  | 5 Εγκατάσταση στη σελίδα 403         |
| 3 Προδιαγραφές στη σελίδα 400          | 6 Εκκίνηση στη σελίδα 413            |

## Ενότητα 1 Πρόσθετες πληροφορίες

Το βασικό εγχειρίδιο χρήστη περιέχει πληροφορίες που είναι επαρκείς για θέση σε λειτουργία. Ένα εκτεταμένο εγχειρίδιο χρήστη είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο και περιέχει περισσότερες πληροφορίες.

EL

### ⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ



Πολλοί κίνδυνοι! Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στις επιμέρους ενότητες του εκτεταμένου εγχειριδίου χρήστη που εμφανίζονται παρακάτω.

- Περιβάλλον εργασίας χρήστη και πλοήγηση
- Λειτουργία
- Συντήρηση
- Αντιμετώπιση προβλημάτων
- Ανταλλακτικά

Σαρώστε τους κωδικούς QR που ακολουθούν για να μεταβείτε στο εκτεταμένο εγχειρίδιο χρήστη.



Ευρωπαϊκές γλώσσες



Αμερικανικές και ασιατικές γλώσσες

## Ενότητα 2 Επισκόπηση προϊόντος

Ο αναλυτής EZ2700sc της Hach είναι ένας online αναλυτής που μετρά μία παράμετρο σε δείγματα νερού από βιομηχανικές και περιβαλλοντικές εφαρμογές. Βλ. [Εικόνα 1](#) στη σελίδα 438, [Εικόνα 2](#) στη σελίδα 441 και [Εικόνα 3](#) στη σελίδα 446.

Ο αναλυτής είναι ένας online χρωματομετρικός αναλυτής για γενική ανάλυση νερού (π.χ., νιτρικά, φωσφορικά). Ο αναλυτής διαθέτει επιλογές για απομακρυσμένη εκκίνηση, αυτόματη επικύρωση, αυτόματη βαθμονόμηση, αυτόματο καθαρισμό και Modbus.

Το νερό δείγματος εισέρχεται στον αναλυτή μέσω του σωλήνα δείγματος. Οι αντλίες, οι βαλβίδες και οι σύριγγες στον αναλυτή μετακινούν το δείγμα και τα αντιδραστήρια στην κυψελίδα μέτρησης στον πίνακα τιμών ανάλυσης. Όταν ολοκληρωθεί η διεργασία στο δοχείο ανάλυσης, ο αναλυτής απορρίπτει το δείγμα μέσω του σωλήνα αποστράγγισης. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης εμφανίζονται στην οθόνη του Ελεγκτή SC4500. Ο Ελεγκτής SC4500 αποθηκεύει τα δεδομένα του αναλυτή (αρχείο καταγραφής δεδομένων, αρχείο καταγραφής συμβάντων, αρχείο καταγραφής ρυθμίσεων και αρχείο καταγραφής service). Χρησιμοποιήστε τον Ελεγκτή SC4500 για να χειριστείτε και να διαμορφώσετε τον αναλυτή.

Για να αυξήσετε τον αριθμό των ροών δειγμάτων (καναλιών) που μπορεί να μετρήσει ο αναλυτής (2, 4 ή 8), αγοράστε τον πίνακα πολλών ροών Modurplex με τον αναλυτή.

Για να προρρυθμίσετε το δείγμα (διήθηση, καθίζηση), αγοράστε τον πίνακα διήθησης EZ9010, EZ9020, EZ9150, EZ9200 ή EZ9250 με τον αναλυτή.

## Ενότητα 3 Προδιαγραφές

Οι προδιαγραφές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Προδιαγραφή	Λεπτομέρειες
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	460 x 688 x 340 mm (18,1 x 27,1 x 13,4 in)
Περιβλήμα	IP44, ABS, PMMA και επικαλυμμένος χάλυβας
Οθόνη	IP66, έγχρωμη οθόνη TFT 3,5" με χωρητικό touchpad
Βάρος	40 kg (88 lb)
Απαιτήσεις τροφοδοσίας	100 έως 240 VAC ±10%, 50/60 Hz
Κατανάλωση τροφοδοσίας	240 VA μέγιστο
Υψόμετρο	Έως 2000 m (6560 ft)
Κατηγορία υπέρτασης	II
Περιβαλλοντικές συνθήκες	Για χρήση αποκλειστικά σε εσωτερικούς χώρους
Βαθμός ρύπανσης	2
Θερμοκρασία λειτουργίας	10 έως 30 °C (50 έως 86 °F), 5 έως 95% σχετική υγρασία χωρίς συμπύκνωση υδρατμών, μη διαβρωτική
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 έως 60 °C (-4 έως 140 °F), σχετική υγρασία 95%, μέγιστη χωρίς συμπύκνωση
Είσοδοι δείγματος	Μία
Πίεση δείγματος	Μέσω εξωτερικού δοχείου υπερχειλίστης (ανοιχτό στην ατμοσφαιρική πίεση)
Ρυθμός ροής δείγματος	100 έως 300 mL/min
Θερμοκρασία δείγματος	10 έως 30 °C (50 έως 86 °F)
Ποιότητα δείγματος	< Σωματίδια 100 μm, έως < 0,1 g/L Θολότητα < 50 NTU
Καθαρισμός αέρα για διαβρωτικά περιβάλλοντα	0,2 bar (20 kPa ή 3 psi), ξηρός και καθαρός αέρας
Αποστράγγιση	Ατμοσφαιρική πίεση, με εξαιρεισμό, διάμετρος τουλάχιστον 32 mm
Γείωση	Στεγνώστε και καθαρίστε τον πόλο γείωσης με χαμηλή σύνθετη αντίσταση (< 1 Ω) με καλώδιο γείωσης > 2,5 mm <sup>2</sup> (13 AWG)
Αναλογικές έξοδοι	Έως οκτώ αναλογικές έξοδοι 0–20 mA (ή 4–20 mA) <b>Σημείωση:</b> Οι αναλογικές έξοδοι παρέχουν την τροφοδοσία βρόχου. Δεν μπορεί να παρασχεθεί τροφοδοσία στις επαφές των συστημάτων SCADA ή PLC.
Ψηφιακές εισοδοι	Επτά ψηφιακές εισοδοι: Δύο ψηφιακές εισοδοι για απομακρυσμένη εκκίνηση. Οι υπόλοιπες ψηφιακές εισοδοι προορίζονται για μελλοντική χρήση.
Ψηφιακές έξοδοι	Τέσσερις ενεργοποιημένες ψηφιακές έξοδοι για τις βαλβίδες και τις αντλίες του πίνακα EZ9150, οκτώ ενεργοποιημένες ψηφιακές έξοδοι για τις βαλβίδες του πίνακα Modurplex, 24 VDC, 500 mA.
Ρελέ	Πέντε επαφές χωρίς δυναμικό (FCT), μέγιστη φόρτιση 24 VDC, 0,5 A (φορτίο αντίστασης)
Συνδέσεις Ethernet	Σύνδεση Ethernet Claros και σύνδεσμος Ethernet TCP/IP Modbus, έκδοση LAN, 10/100 Mbps ή IP Profinet ή Ethernet

<sup>2</sup> Για πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση Ethernet και τη διαμόρφωση Modbus, ανατρέξτε στα έγγραφα του Ελεγκτή SC4500.

<b>Προδιαγραφή</b>	<b>Λεπτομέρειες</b>
Επικοινωνίες RS485	Profibus DP ή Modbus RTU
Πιστοποιήσεις	CE, Πιστοποίηση ETL σύμφωνα με τα πρότυπα ασφάλειας UL και CSA, UKCA
Εγγύηση	1 έτος (EE: 2 έτη)

## Ενότητα 4 Γενικές πληροφορίες

Σε καμία περίπτωση δεν θα είναι ο κατασκευαστής υπεύθυνος για ζημιές που προκύπτουν από οποιαδήποτε μη κατάλληλη χρήση του προϊόντος ή από αστοχία συμμόρφωσης με τις οδηγίες στο εγχειρίδιο. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει αλλαγές στο παρόν εγχειρίδιο και στα προϊόντα που περιγράφει ανά στιγμή, χωρίς ειδοποίηση ή υποχρέωση. Αναθεωρημένες εκδόσεις διατίθενται από τον ιστοχώρο του κατασκευαστή.

### 4.1 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια

Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιές που οφείλονται σε λανθασμένη εφαρμογή ή κακή χρήση αυτού του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των άμεσων, συμπτωματικών και παρεπόμενων ζημιών, και αποποιείται την ευθύνη για τέτοιες ζημιές στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπει το εφαρμοστέο δίκαιο. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αναγνώριση των σημαντικών κινδύνων εφαρμογής και την εγκατάσταση των κατάλληλων μηχανισμών με στόχο την προστασία των διεργασιών κατά τη διάρκεια μιας πιθανής δυσλειτουργίας του εξοπλισμού.

Παρακαλούμε διαβάστε ολόκληρο αυτό το εγχειρίδιο προτού αποσυσκευάσετε, ρυθμίσετε ή λειτουργήσετε αυτόν τον εξοπλισμό. Προσέξτε όλες τις υποδείξεις κινδύνου και προσοχής. Η παράλειψη μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς του χειριστή ή σε ζημιές της συσκευής.

Σε περίπτωση που ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν καθορίζεται από τον κατασκευαστή, η προστασία που παρέχεται από τον εξοπλισμό μπορεί να είναι μειωμένη. Μη χρησιμοποιείτε και να μην εγκαθιστάτε τον εξοπλισμό με κανέναν άλλον τρόπο, εκτός από αυτούς που προσδιορίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο.

#### 4.1.1 Χρήση των πληροφοριών προειδοποίησης κινδύνου

##### ▲ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Υποδεικνύει κάποια ενδεχόμενη ή επικείμενη επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποτραπεί, θα οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

##### ▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Υποδεικνύει μια ενδεχόμενη ή επικείμενη επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, αν δεν αποτραπεί, μπορεί να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

##### ▲ ΠΡΟΣΟΧΗ







Υποδεικνύει κάποια ενδεχόμενη επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να καταλήξει σε ελαφρό ή μέτριο τραυματισμό.

##### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Υποδεικνύει κατάσταση που, εάν δεν αποτραπεί, μπορεί να προκληθεί βλάβη στο όργανο. Πληροφορίες που απαιτούν ειδική έμφαση.


#### 4.1.2 Ετικέτες προφύλαξης

Διαβάστε όλες τις ετικέτες και τις πινακίδες που είναι επικολλημένες στο όργανο. Εάν δεν τηρήσετε τις οδηγίες, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά στο όργανο. Η ύπαρξη κάποιου συμβόλου επάνω στο όργανο παραπέμπει στο εγχειρίδιο με κάποια δήλωση προειδοποίησης.

	Αυτό είναι το σύμβολο προειδοποίησης ασφάλειας. Για την αποφυγή ενδεχόμενου τραυματισμού, τηρείτε όλα τα μηνύματα για την ασφάλεια που εμφανίζονται μετά από αυτό το σύμβολο. Εάν βρίσκεται επάνω στο όργανο, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας ή πληροφοριών ασφαλείας του οργάνου.
	Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης βλάβης από χημικά και ότι η διαχείριση των χημικών και η εκτέλεση εργασιών συντήρησης στα συστήματα παροχής χημικών θα πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά από καταρτισμένο προσωπικό που είναι εκπαιδευμένο για εργασίες με χρήση χημικών ουσιών.
	Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
	Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει την παρουσία συσκευών ευαίσθητων σε ηλεκτροστατική εκκένωση και επισημαίνει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να αποφευχθεί η πρόκληση βλάβης στον εξοπλισμό.
	Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το επισημασμένο αντικείμενο χρειάζεται προστατευτική σύνδεση γείωσης. Εάν το όργανο δεν παρέχεται με βύσμα γείωσης πάνω στο καλώδιο, πραγματοποιήστε την προστατευτική σύνδεση γείωσης στον προστατευτικό ακροδέκτη γείωσης.
	Αν ο ηλεκτρικός εξοπλισμός φέρει το σύμβολο αυτό, δεν επιτρέπεται η απόρριψή του σε ευρωπαϊκά οικιακά και δημόσια συστήματα συλλογής απορριμμάτων. Μπορείτε να επιστρέψετε παλαίο εξοπλισμό ή εξοπλισμό του οποίου η ωφέλιμη διάρκεια ζωής έχει παρέλθει στον κατασκευαστή για απόρριψη, χωρίς χρέωση για το χρήστη.

### 4.1.3 Χημική και βιολογική ασφάλεια

**⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ**

	Χημικοί ή βιολογικοί κίνδυνοι. Εάν το παρόν όργανο χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση μιας διαδικασίας επεξεργασίας ή/και χημικού συστήματος τροφοδοσίας, για τα οποία υπάρχουν ρυθμιστικά όρια και απαιτήσεις παρακολούθησης που αφορούν τη δημόσια υγεία και ασφάλεια, την παραγωγή ή επεξεργασία τροφίμων ή ποτών, αποτελεί ευθύνη του χρήστη του οργάνου να γνωρίζει και να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανονισμούς καθώς και να διαθέτει επαρκείς και κατάλληλους μηχανισμούς προκειμένου να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανονισμούς σε περίπτωση δυσλειτουργίας του οργάνου.
--	---

### 4.2 Εικονογραφήσεις εικονιδίων

			
Εξαρτήματα παρεχόμενα από τον κατασκευαστή	Εξαρτήματα παρεχόμενα από τον χρήστη	Κοιτάξτε	Εκτελέστε τα βήματα με αντίστροφη σειρά

				
Χρησιμοποιήστε δύο άτομα	Ακούστε	Χρησιμοποιήστε μόνο δάκτυλα	Μην χρησιμοποιείτε εργαλεία	Μην αγγίζετε

### 4.3 Προβλεπόμενη χρήση

Οι αναλυτές της σειράς EZ της Hach προορίζονται για χρήση από άτομα που πρέπει να μετρούν συνεχώς παραμέτρους ποιότητας νερού σε δείγματα από βιομηχανικές και περιβαλλοντικές

εφαρμογές. Οι αναλυτές σειράς EZ της Hach δεν επεξεργάζονται το νερό και δεν μεταβάλλουν τη σύστασή του, ενώ δεν χρησιμοποιούνται σε διαδικασίες ελέγχου.

## 4.4 Εξαρτήματα προϊόντος

Βεβαιωθείτε ότι έχετε λάβει όλα τα εξαρτήματα. Ανατρέξτε στην ενότητα **Εικόνα 4** στη σελίδα 450. Εάν κάποιο αντικείμενο λείπει ή έχει υποστεί ζημιά, επικοινωνήστε αμέσως με τον κατασκευαστή ή με έναν αντιπρόσωπο πωλήσεων.

## Ενότητα 5 Εγκατάσταση

### ▲ ΚΙΝΔΥΝΟΣ



Πολλαπλοί κίνδυνοι. Μόνο ειδικευμένο προσωπικό πρέπει να εκτελεί τις εργασίες που περιγράφονται σε αυτήν την ενότητα του χειριριδίου.

## 5.1 Οδηγίες εγκατάστασης

### ▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Κίνδυνος πυρκαγιάς. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τη λήψη επαρκών προφυλάξεων κατά τη χρήση του εξοπλισμού με μεθόδους που χρησιμοποιούν εύφλεκτα υγρά. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι σωστές προφυλάξεις χρήστη και τα σωστά πρωτόκολλα ασφαλείας. Σε αυτά περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, οι έλεγχοι εκχείλισης και διαρροής, ο σωστός εξαιρισμός, η επιτηρούμενη χρήση και η συνεχής επιτήρηση του οργάνου όταν τροφοδοτείται με ρεύμα.

### ▲ ΠΡΟΣΟΧΗ



Κίνδυνος έκθεσης σε χημικά. Τηρείτε τις εργαστηριακές διαδικασίες ασφαλείας και φοράτε όλα τα μέσα ατομικής προστασίας που είναι κατάλληλα για τα χημικά που χειρίζεστε. Ανατρέξτε στα υπάρχοντα φύλλα δεδομένων ασφαλείας υλικού (MSDS/SDS) για τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

### ▲ ΠΡΟΣΟΧΗ



Κίνδυνος έκθεσης σε χημικά. Απορρίπτετε τα χημικά και τα απόβλητα σύμφωνα με τους τοπικούς, περιφερειακούς και εθνικούς κανονισμούς.

- Εγκαταστήστε τον αναλυτή σε εσωτερικό χώρο, σε μη επικίνδυνο περιβάλλον.
- Εγκαταστήστε τον αναλυτή σε περιβάλλον που προστατεύεται από διαβρωτικά υλικά.
- Εγκαταστήστε τον αναλυτή σε καθαρό, στεγνό, καλά αεριζόμενο και ελεγχόμενης θερμοκρασίας σημείο.
- Εγκαταστήστε τον αναλυτή όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο σημείο δειγματοληψίας.
- Μην εγκαταστήσετε τον αναλυτή σε άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε πηγή θερμότητας.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής απόσταση για την πραγματοποίηση των υδραυλικών και ηλεκτρικών συνδέσεων.
- Φροντίστε να αφήσετε επαρκή κενό χώρο μπροστά από τον αναλυτή για το άνοιγμα της θύρας του αναλυτή. Ανατρέξτε στην ενότητα **Διαστάσεις αναλυτή** στη σελίδα 404.
- Βεβαιωθείτε ότι οι συνθήκες περιβάλλοντος είναι εντός των προδιαγραφών λειτουργίας. Ανατρέξτε στην ενότητα **Προδιαγραφές** στη σελίδα 400.

Παρόλο που ο αναλυτής δεν προορίζεται για χρήση με εύφλεκτα δείγματα, ορισμένοι αναλυτές EZ χρησιμοποιούν εύφλεκτα αντιδραστήρια. Ανατρέξτε στο Method & Reagent Sheet (Φύλλο Μεθόδου & Αντιδραστήριου) του ισχύοντος μοντέλου σειράς EZ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αντιδραστήρια που χρησιμοποιούνται στον αναλυτή. Εάν ο αναλυτής χρησιμοποιεί εύφλεκτα αντιδραστήρια, βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τις προφυλάξεις ασφαλείας που ακολουθούν:

- Διατηρείτε τον αναλυτή μακριά από θερμότητα, σπινθήρες και φλόγα.
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε κοντά στον αναλυτή.

- Χρησιμοποιήστε τοπικό σύστημα εξαερισμού.
- Χρησιμοποιήστε συσκευές και σύστημα φωτισμού με προστασία από πρόκληση σπινθήρων και έκρηξης.
- Αποτρέψτε τις ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις. Ανατρέξτε στην ενότητα [Θέματα που αφορούν την Ηλεκτροστατική Εκφόρτιση \(ESD\)](#) στη σελίδα 405.
- Καθαρίστε και στεγνώστε πλήρως το όργανο πριν από τη χρήση.
- Πριν από κάθε διάλειμμα και μετά την εργασία να πλένετε τα χέρια σας.
- Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα. Πλύνετε τα ρούχα πριν την εκ νέου χρήση.
- Ο χειρισμός αυτών των υγρών πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του τοπικού ρυθμιστικού φορέα σχετικά με τα επιτρεπόμενα όρια έκθεσης.

## 5.2 Διαστάσεις αναλυτή

Για τις διαστάσεις του αναλυτή ανατρέξτε στην [Εικόνα 5](#) στη σελίδα 454.

## 5.3 Μηχανολογική εγκατάσταση

### 5.3.1 Προσάρτηση του οργάνου στον τοίχο

#### ▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Κίνδυνος τραυματισμού. Βεβαιωθείτε ότι το στήριγμα τοίχου μπορεί να κρατήσει 4 φορές το βάρος του εξοπλισμού.

#### ▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Κίνδυνος τραυματισμού. Τα όργανα ή τα εξαρτήματα είναι βαριά. Για μετακίνηση ή εγκατάσταση, ζητήστε βοήθεια.

#### ▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Κίνδυνος τραυματισμού. Το αντικείμενο είναι βαρύ. Βεβαιωθείτε ότι το όργανο έχει συνδεθεί με ασφάλεια σε τοίχο, σε τραπέζι ή στο δάπεδο, για την ασφαλή λειτουργία του.

Χρησιμοποιήστε τα παρεχόμενα στηρίγματα τοποθέτησης για να στερεώσετε το όργανο σε όρθια και επίπεδη θέση σε μια επίπεδη, κάθετη επιφάνεια τοίχου. Ανατρέξτε στην ενότητα [Εικόνα 6](#) στη σελίδα 456.

Εγκαταστήστε το όργανο σε σημείο και θέση όπου ο χρήστης μπορεί εύκολα να αποσυνδέσει το όργανο από την πηγή τροφοδοσίας.

Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής απόσταση κάτω από τον αναλυτή για την τοποθέτηση των φιαλών.

Ο εξοπλισμός τοποθέτησης παρέχεται από τον χρήστη. Βεβαιωθείτε ότι το επιτοίχιο εξάρτημα συγκράτησης έχει επαρκή φέρουσα ικανότητα (περίπου 160 kg ή 353 lb). Ο εξοπλισμός τοποθέτησης πρέπει να είναι εγκεκριμένος για τις ιδιότητες του τοίχου.

### 5.3.2 Ανοίξτε την πόρτα του αναλυτή

Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο κλειδί για να ξεκλειδώσετε τις δύο κλειδαριές στο πλάι του αναλυτή. Ανατρέξτε στην ενότητα [Εικόνα 7](#) στη σελίδα 456. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει τη θύρα πριν από τη λειτουργία, για να διατηρήσετε την περιβαλλοντική αξιολόγηση του περιβλήματος και την αξιολόγηση ασφάλειας.

## 5.4 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση

### ▲ ΚΙΝΔΥΝΟΣ



Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Πριν πραγματοποιήσετε οποιοσδήποτε ηλεκτρικές συνδέσεις, να αποσυνδέετε πάντοτε το όργανο από την τροφοδοσία ρεύματος.

### 5.4.1 Θέματα που αφορούν την Ηλεκτροστατική Εκφόρτιση (ESD)

#### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Πιθανή βλάβη οργάνου. Τα ευαίσθητα εσωτερικά ηλεκτρονικά εξαρτήματα ενδέχεται να υποστούν βλάβη από το στατικό ηλεκτρισμό, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση της απόδοσης των οργάνων ή ενδεχόμενη αστοχία τους.

Ανατρέξτε στα βήματα αυτής της διαδικασίας για την αποφυγή πρόκλησης βλάβης ESD στο όργανο:

- Αγγίξτε μια γειωμένη μεταλλική επιφάνεια όπως το σώμα κάποιου οργάνου, έναν μεταλλικό αγωγό ή σωλήνα, για να εκφορτιστεί ο στατικός ηλεκτρισμός από το σώμα σας.
- Αποφύγετε τις υπερβολικές κινήσεις. Μεταφέρετε τα εξαρτήματα που είναι ευαίσθητα στο στατικό ηλεκτρισμό σε αντιστατικούς περιέκτες ή συσκευασίες.
- Φοράτε ένα περιβραχιόνιο συνδεδεμένο με καλώδιο στη γείωση.
- Εργαστείτε σε ασφαλή από το στατικό ηλεκτρισμό χώρο με αντιστατική επικάλυψη δαπέδου και επικαλύψεις των πάγκων εργασίας.

### 5.4.2 Πρόσβαση στα ηλεκτρικά μέρη

Τοποθετήστε τα καλώδια των εξωτερικών συσκευών μέσα από τους στυπιοθλίπτες καλωδίων. Ανατρέξτε στην ενότητα [Εικόνα 8](#) στη σελίδα 457. Διατηρήστε τις τάπες στους στυπιοθλίπτες καλωδίων που δεν χρησιμοποιούνται.

Η [Εικόνα 9](#) στη σελίδα 460 δείχνει τα εξαρτήματα μέσα στον αναλυτή. Ο διακόπτης τροφοδοσίας είναι ένας ασφαλειοδιακόπτης που διακόπτει αυτόματα την κύρια τροφοδοσία από τη γραμμή τροφοδοσίας AC, σε περίπτωση συνθηκών υπερτάσης (για παράδειγμα, βραχυκυκλώματος) ή υπέρτασης.

### 5.4.3 Σύνδεση των εξωτερικών συσκευών

Συνδέστε τις εξωτερικές συσκευές που θα χρησιμοποιηθούν με τον αναλυτή στους ακροδέκτες σήματος και ελέγχου στον αναλυτή. Ανατρέξτε στον [Εικόνα 10](#) στη σελίδα 463 και στην [Πίνακας 1](#) στη σελίδα 405.

**Πίνακας 1 Ακροδέκτες σήματος και ελέγχου—Περιγραφές**

Ακίδα	Περιγραφή
AO1–AO8 (P101)	Οκτώ αναλογικές έξοδοι για τον έλεγχο εξωτερικών συσκευών. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική έκδοση του εκτεταμένου χειριδίου χρήστη.
FCT1–FCT5 (P102)	Πέντε ρελέ (επαφές χωρίς δυναμικό). Η μέγιστη φόρτιση είναι 24 VDC, 0,5 A. <ul style="list-style-type: none"><li>• FCT1—Συναγερμός δυσλειτουργίας</li><li>• FCT2—Συναγερμός συντήρησης</li><li>• FCT3— Αναλυτής έτοιμος</li><li>• FCT4 και FCT5—Για μελλοντική χρήση</li></ul>

**Πίνακας 1 Ακροδέκτες σήματος και ελέγχου—Περιγραφές (συνέχεια)**

Ακίδα	Περιγραφή
DI1–DI7 (P103)	<p>Επτά ψηφιακές εισοδοί για τον τηλεχειρισμό του αναλυτή<sup>5</sup>. Συνδέστε τις ψηφιακές εισόδους σε μια εξωτερική επαφή χωρίς δυναμικό (24 VDC), για να ενεργοποιήσετε τον αναλυτή ώστε να ξεκινήσει μια μέτρηση για ένα κανάλι.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DI1—Απομακρυσμένη εκκίνηση για το κανάλι 1</li> <li>• DI2—Απομακρυσμένη εκκίνηση για το κανάλι 2</li> <li>• DI3 έως DI7—Για μελλοντική χρήση</li> </ul>
FB1–FB4 (P104)	<p>Σύνδεσμοι Profibus DP ή Modbus RTU (RS485)</p> <p><b>Profibus DP:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FB1—A1 (είσοδος)</li> <li>• FB2—A2 (έξοδος)</li> <li>• FB3—B1 (είσοδος)</li> <li>• FB4—B2 (έξοδος)</li> <li>• SHL—Θωράκιση</li> </ul> <p><b>Modbus RTU:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FB1—D (+)</li> <li>• FB2—D (-)</li> <li>• FB3—δεν χρησιμοποιείται</li> <li>• FB4—δεν χρησιμοποιείται</li> <li>• SHL—Θωράκιση</li> </ul> <p>Ανατρέξτε στα έγγραφα του Ελεγκτή SC4500 για τις οδηγίες διαμόρφωσης Modbus και τις ετικέτες τηλεγραφήματος.</p>
24 VDC/1 A (P105)	Τροφοδοσία ρεύματος 24 V DC για μονάδες διήθησης EZ9010 και EZ9020
STR1–STR8 (P106)	<p>Οκτώ ψηφιακές έξοδοι για τον προαιρετικό πίνακα Moduplex. Συνδέστε τα γυμνά καλώδια κάθε βαλβίδας καναλιού στον πίνακα Moduplex στους σχετικούς συνδέσμους STR.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• STR1—Κανάλι 1</li> <li>• STR2—Κανάλι 2</li> <li>• ...</li> <li>• STR8—Κανάλι 8</li> </ul>
EXT9–EXT12 (P107)	<p>Τέσσερις ψηφιακές έξοδοι για τον προαιρετικό πίνακα διήθησης EZ9150. Συνδέστε τις ηλεκτρικές βαλβίδες και την αντλία στον πίνακα διήθησης EZ9150 στους συνδέσμους EXT.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EXT9—Βαλβίδα έκπλυσης</li> <li>• EXT10—Βαλβίδα αντίστροφης έκπλυσης</li> <li>• EXT11—Βαλβίδα αποστράγγισης υπερχειλίσης</li> <li>• EXT12—Αντλία διήθησης</li> </ul>
D01–D06 (P108 και P109)	<p>Έξι έξοδοι πνευματικών βαλβίδων για τον πίνακα EZ9150.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• D01—Βαλβίδα εισόδου δείγματος</li> <li>• D02—Βαλβίδα αποστράγγισης υπερχειλίσης</li> <li>• D03—Βαλβίδα καναλιού 1</li> <li>• D04—Βαλβίδα καναλιού 2</li> <li>• D05—Βαλβίδα καναλιού 3</li> <li>• D06—Βαλβίδα καναλιού 4</li> </ul>

<sup>5</sup> Εάν ο αναλυτής βρίσκεται σε λειτουργία συντήρησης, ο τηλεχειρισμός είναι απενεργοποιημένος.

## 5.4.4 Σύνδεση σε τροφοδοσία AC

### ⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ



Κίνδυνοι ηλεκτροπληξίας και πυρκαγιάς. Βεβαιωθείτε ότι το παρεχόμενο καλώδιο και το βύσμα μη ασφάλισης πληρούν τις ισχύουσες απαιτήσεις του κώδικα της χώρας.

- Βεβαιωθείτε ότι ένας ασφαλειοδιακόπτης με επαρκή χωρητικότητα μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος είναι εγκατεστημένος στη γραμμή τροφοδοσίας.
- Βεβαιωθείτε ότι ο ασφαλειοδιακόπτης ή ένας διακόπτης έκτακτης ανάγκης είναι εγκατεστημένος κοντά στον αναλυτή, ώστε ο αναλυτής να μπορεί να αποσυνδεθεί αμέσως από την παροχή ρεύματος εάν είναι απαραίτητο.
- Συνδέστε τον εξοπλισμό σύμφωνα με τους τοπικούς, πολιτειακούς και εθνικούς κώδικες ηλεκτρικής ενέργειας.
- Τοποθετήστε το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας μέσω του στυπιοθλίπτη καλωδίου που βρίσκεται στο πλάι του αναλυτή.
- Σφίξτε τον στυπιοθλίπτη καλωδίου για να συγκρατήσετε το καλώδιο τροφοδοσίας με ασφάλεια και να διατηρήσετε την περιβαλλοντική αξιολόγηση του περιβλήματος.

Συνδέστε τον αναλυτή στην τροφοδοσία AC με το παρεχόμενο καλώδιο AC. Ανατρέξτε στον [Πίνακα 2](#) στη σελίδα 407 και στην [Εικόνα 11](#) στη σελίδα 468.

### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην θέτετε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση ενεργοποίησης. Ολοκληρώστε όλες τις ηλεκτρικές και υδραυλικές συνδέσεις πριν από την εκκίνηση, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά στον αναλυτή.

**Πίνακας 2 Πληροφορίες καλωδίωσης—Τροφοδοσία AC**

Ακροδέκτης	Περιγραφή	Έγχρωμο καλώδιο-Βόρεια Αμερική και Καναδάς	Χρώμα καλωδίου-ΕΕ
L	Φορτισμένο/Γραμμή (L)	Μαύρο (1)	Καφέ
N	Ουδέτερο (N)	Λευκό (2)	Μπλε
	Προστατευτική γείωση (PE)	Πράσινο με κίτρινη λωρίδα	Πράσινο με κίτρινη λωρίδα

## 5.5 Υδραυλική εγκατάσταση

### 5.5.1 Οδηγίες γραμμής δείγματος

#### ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ



Κίνδυνος πυρκαγιάς. Το προϊόν αυτό δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση με εύφλεκτα δείγματα.

Επιλέξτε ένα καλό, αντιπροσωπευτικό σημείο δειγματοληψίας για βέλτιστη απόδοση οργάνου. Το δείγμα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό ολόκληρου του συστήματος.

- Βεβαιωθείτε ότι η ροή δείγματος είναι υψηλότερη από τη ροή στον αναλυτή.
- Βεβαιωθείτε ότι η γραμμή δείγματος είναι σε ατμοσφαιρική πίεση, εάν ο αναλυτής χρησιμοποιεί μια περισταλτική αντλία για τη μετακίνηση του δείγματος στο δοχείο ανάλυσης.
- Βεβαιωθείτε ότι η γραμμή δείγματος συλλέγει το δείγμα από ένα μικρό δοχείο υπερχείλισης κοντά στον αναλυτή.
- Χρησιμοποιήστε τη γραμμή δειγματοληψίας που παρέχεται. Μην αλλάζετε το μήκος της γραμμής δειγματοληψίας.

Το δείγμα μέσα στο δοχείο υπερχειλίσας πρέπει να ανανεώνεται συνεχώς. Εάν το μέγεθος στερεών στο δείγμα είναι πολύ υψηλό, συνιστάται επίσης διήθηση του δείγματος.

## 5.5.2 Οδηγίες σωλήνα αποστράγγισης

### ▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Κίνδυνος πυρκαγιάς. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τη λήψη επαρκών προφυλάξεων κατά τη χρήση του εξοπλισμού με μεθόδους που χρησιμοποιούν εύφλεκτα υγρά. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι σωστές προφυλάξεις χρήστη και τα σωστά πρωτόκολλα ασφαλείας. Σε αυτά περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, οι έλεγχοι εκχείλισης και διαρροής, ο σωστός εξερισμός, η επιτηρούμενη χρήση και η συνεχής επιτήρηση του οργάνου όταν τροφοδοτείται με ρεύμα.

### ▲ ΠΡΟΣΟΧΗ



Κίνδυνος έκθεσης σε χημικά. Απορρίψτε τα χημικά και τα απόβλητα σύμφωνα με τους τοπικούς, περιφερειακούς και εθνικούς κανονισμούς.

### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην συνδέσετε τους σωλήνες αποστράγγισης σε άλλους σωλήνες, επειδή ενδέχεται να δημιουργηθεί αντίθλιψη ή να προκληθεί ζημιά στον αναλυτή. Βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες αποστράγγισης είναι ανοιχτοί στον αέρα.

### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να αποτρέψετε τη δημιουργία αντίθλιξης και την πρόκληση ζημιάς στον αναλυτή, βεβαιωθείτε ότι ο αναλυτής βρίσκεται υψηλότερα από τα σημεία αποστράγγισης του κτηρίου που χρησιμοποιούνται και ότι ο σωλήνας αποστράγγισης έχει σταθερή κλίση προς τα κάτω. Εγκαταστήστε τους σωλήνες αποστράγγισης με κατακόρυφη μείωση 2,54 cm (1 in) και άνω για κάθε 0,3 m (1 ft) μήκους σωλήνωσης.

Ο αναλυτής χρησιμοποιεί το σωλήνα αποστράγγισης για την απελευθέρωση του δείγματος και των αντιδραστηρίων μετά την ανάλυση. Η σωστή τοποθέτηση των σωλήνων αποστράγγισης είναι σημαντική, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλο το υγρό απομακρύνεται από το όργανο. Η ασφαλέννη τοποθέτηση μπορεί να προκαλέσει την επιστροφή του υγρού στο όργανο και να οδηγήσει σε ζημιά. Η αποστράγγιση νιπτήρα ή δαπέδου επαρκεί για τον σωλήνα αποστράγγισης. Η συνιστώμενο εξωτερική διάμετρος για τον σωλήνα αποστράγγισης είναι 32 mm. Ανατρέξτε στην ενότητα [Εικόνα 12](#) στη σελίδα 470.

- Το μήκος των σωλήνων αποστράγγισης πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μικρότερο.
- Βεβαιωθείτε ότι η αποστράγγιση βρίσκεται χαμηλότερα από τον αναλυτή.
- Βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες αποστράγγισης έχουν σταθερή κλίση προς τα κάτω.
- Βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες αποστράγγισης δεν έχουν απότομες γωνίες και ότι δεν είναι τσακισμένοι.
- Βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες αποστράγγισης είναι ανοιχτοί στον αέρα και ότι είναι σε μηδενική πίεση.
- Βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες αποστράγγισης είναι κλειστοί στο περιβάλλον της αίθουσας εγκατάστασης.
- Μην φράζετε και μην εμβυθίζετε το σωλήνα αποστράγγισης.

Συνιστάται επίσης μια σύνδεση νερού κοντά στον αναλυτή, έτσι ώστε ο νιπτήρας αποστράγγισης και η σωλήνωση αποστράγγισης να εκπλένονται τακτικά με καθαρό νερό, ώστε να αποτραπεί τυχόν έμφραξη μέσω κρυσταλλοποίησης.

Ανατρέξτε στο Method & Reagent Sheet (Φύλλο Μεθόδου & Αντιδραστηρίου) του ισχύοντος μοντέλου σειράς EZ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αντιδραστήρια που χρησιμοποιούνται στον αναλυτή. Εάν ο αναλυτής χρησιμοποιεί εύφλεκτα αντιδραστήρια, βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τις προφυλάξεις ασφαλείας που ακολουθούν:

- Μη συνδέετε τον σωλήνα αποστράγγισης σε αποστράγγιση δαπέδου.
- Απορρίψτε τα απόβλητα σύμφωνα με τους τοπικούς, πολιτειακούς και εθνικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς.

### 5.5.3 Οδηγίες γραμμής αερισμού

#### ▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Κίνδυνος πυρκαγιάς. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τη λήψη επαρκών προφυλάξεων κατά τη χρήση του εξοπλισμού με μεθόδους που χρησιμοποιούν εύφλεκτα υγρά. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι σωστές προφυλάξεις χρήστη και τα σωστά πρωτόκολλα ασφαλείας. Σε αυτά περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, οι ελεγχίσις εκχείλισης και διαρροής, ο σωστός εξαερισμός, η επιτηρούμενη χρήση και η συνεχής επιτήρηση του οργάνου όταν τροφοδοτείται με ρεύμα.

#### ▲ ΠΡΟΣΟΧΗ



Κίνδυνος έκθεσης σε χημικά. Απορρίψτε τα χημικά και τα απόβλητα σύμφωνα με τους τοπικούς, περιφερειακούς και εθνικούς κανονισμούς.

#### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην συνδέσετε τη γραμμή αερισμού (θύρα απαερίων) σε άλλους σωλήνες, επειδή ενδέχεται να δημιουργηθεί αντίθλιψη ή να προκληθεί ζημιά στον αναλυτή. Βεβαιωθείτε ότι η γραμμή αερισμού είναι ανοικτή σε αέρα στο εξωτερικό του κτιρίου.

#### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να αποτρέψετε τη δημιουργία αντίθλιψης και την πρόκληση ζημιάς στον αναλυτή, βεβαιωθείτε ότι ο αναλυτής βρίσκεται υψηλότερα από τα σημεία εξαερισμού του κτιρίου που χρησιμοποιούνται και ότι η γραμμή εξαερισμού έχει σταθερή κλίση προς τα κάτω. Εγκαταστήστε τη γραμμή εξαερισμού με κατακόρυφη μείωση 2,54 cm (1 in) και άνω για κάθε 0,3 m (1 ft) μήκους σωλήνα.

Ο αναλυτής χρησιμοποιεί τη γραμμή αερισμού για να διατηρεί το δοχείο ανάλυσης σε ατμοσφαιρική πίεση. Η σωστή εγκατάσταση της γραμμής αερισμού είναι σημαντική για να βεβαιωθείτε ότι κατά τη λειτουργία της αντλίας δεν εισέρχεται υγρό στο δοχείο ανάλυσης από τη γραμμή εξαερισμού. Η εσφαλμένη τοποθέτηση μπορεί να προκαλέσει την επιστροφή του αερίου στον αναλυτή και να προκαλέσει ζημιά. Η συνιστώμενη εξωτερική διάμετρος για τον σωλήνα εκτόνωσης της γραμμής αερισμού είναι 32 mm. Ανατρέξτε στην ενότητα [Εικόνα 12](#) στη σελίδα 470.

- Κάντε τη γραμμή εξαερισμού όσο το δυνατόν πιο βραχεία.
- Βεβαιωθείτε ότι η γραμμή αερισμού έχει σταθερή κλίση προς τα κάτω.
- Βεβαιωθείτε ότι η γραμμή αερισμού δεν έχει απότομη γωνία και ότι δεν είναι τσακισμένη.
- Βεβαιωθείτε ότι η γραμμή αερισμού είναι κλειστή στο περιβάλλον της αίθουσας εγκατάστασης και βρίσκεται σε μηδενική πίεση.
- Βεβαιωθείτε ότι η γραμμή αερισμού είναι πάντα ψηλότερα από την αποστράγγιση.
- Μην φράζετε και μην εμβυθίζετε τη γραμμή αερισμού.

Εάν ο αναλυτής χρησιμοποιεί εύφλεκτα αντιδραστήρια, βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τις προφυλάξεις ασφαλείας που ακολουθούν:

- Μην συνδέετε τη γραμμή αερισμού σε αποστράγγιση δαπέδου.
- Απορρίψτε τα απόβλητα σύμφωνα με τους τοπικούς, πολιτειακούς και εθνικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς.

### 5.5.4 Σύνδεση του αναλυτή για τη δοκιμή εξαρτημάτων


#### ▲ ΠΡΟΣΟΧΗ




Κίνδυνος πυρκαγιάς. Το προϊόν αυτό δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση με εύφλεκτα υγρά.

Πριν θεθεί σε λειτουργία ο αναλυτής με όλα τα αντιδραστήρια, πρέπει να πραγματοποιηθεί δοκιμή εξαρτημάτων με αποιονισμένο νερό. Ανατρέξτε στα εικονογραφημένα βήματα και στην ενότητα [Εκτέλεση των δοκιμών εξαρτημάτων](#) στη σελίδα 414.

1. Εγκαταστήστε τους τέσσερις σωλήνες βαλβίδας σύσφιγξης όπως φαίνεται στο εικονογραφημένο βήμα 1 που ακολουθεί.
  - a. Πιέστε το μαύρο κουμπί και κατόπιν ωθήστε τη σωλήνωση μέσα στη βαλβίδα.
  - b. Αφήστε το κουμπί όταν η σωλήνωση έχει εγκατασταθεί σωστά.
2. Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αποστράγγισης έχει τοποθετηθεί σωστά στο δοχείο δείγματος. Ανατρέξτε στην εικόνα βήματος 2 που ακολουθεί.
3. Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας συσκευής χώνευσης έχει τοποθετηθεί σωστά στο δοχείο συσκευής χώνευσης. Ανατρέξτε στην εικόνα βήματος 3 που ακολουθεί.
4. Συνδέστε υδραυλικά όλη τη σωλήνωση υγρού του αναλυτή σε μια μεγάλη φιάλη αποιονισμένου νερού, προκειμένου να πραγματοποιήσετε μια δοκιμή των εξαρτημάτων. Ανατρέξτε στην εικόνα βήματος 3 που ακολουθεί. Οι σωληνώσεις εγκαθιστώνται στο εργοστάσιο.

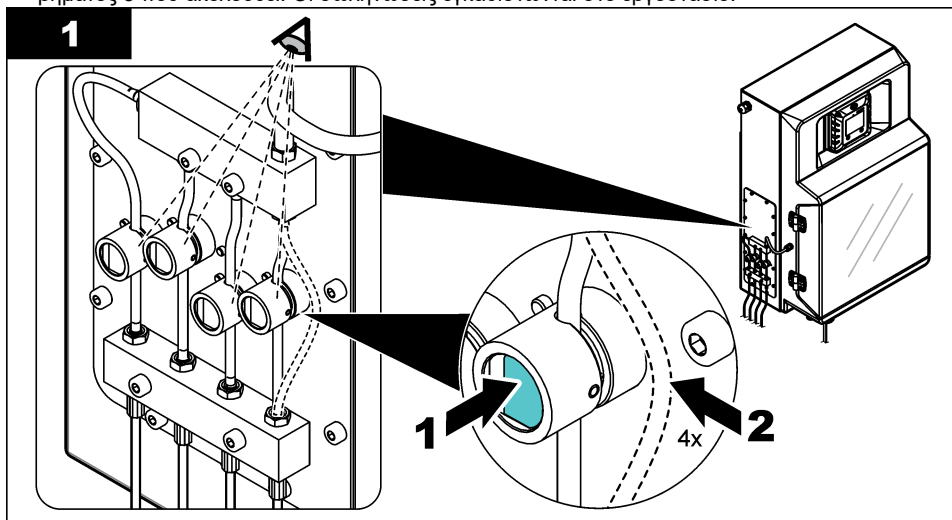




2

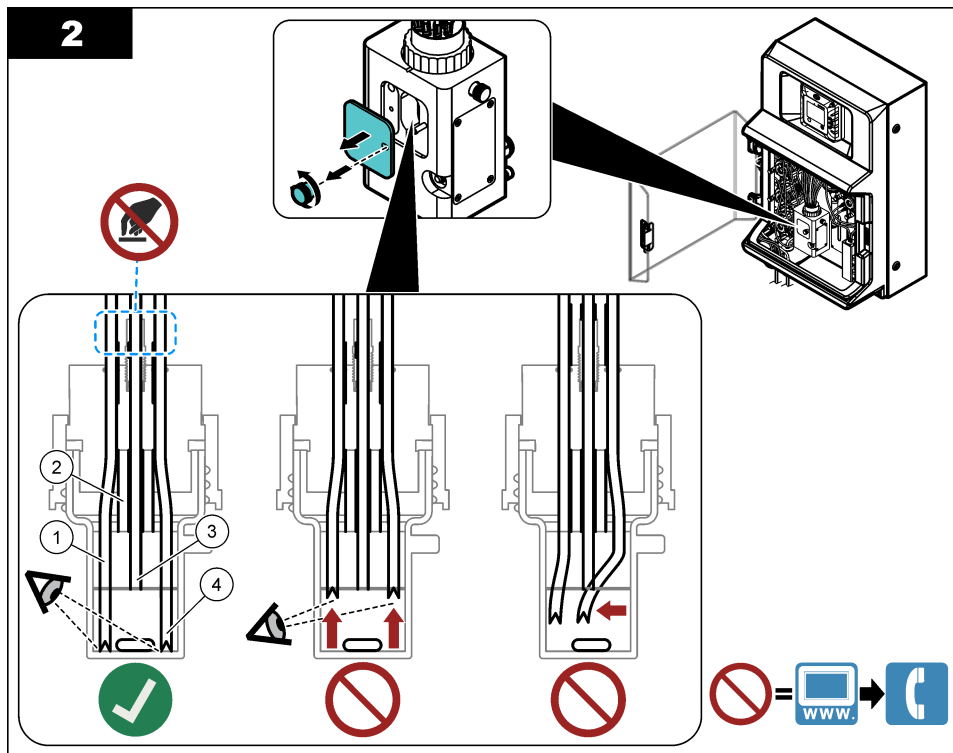

EL

<p>1 Σωλήνωση αποστράγγισης</p>	<p>3 Σωλήνωση δείγματος</p>
<p>2 Αντιδραστήρια και σωλήνωση αερισμού (επάνω σωλήνας)</p>	<p>4 Σωλήνωση συσκευής χώνευσης</p>


3

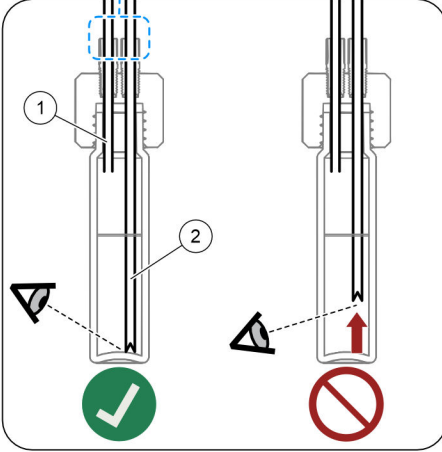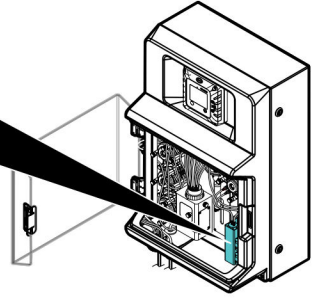

1 Σωλήνωση αερισμού

2 Σωλήνωση συσκευής χώνευσης

4

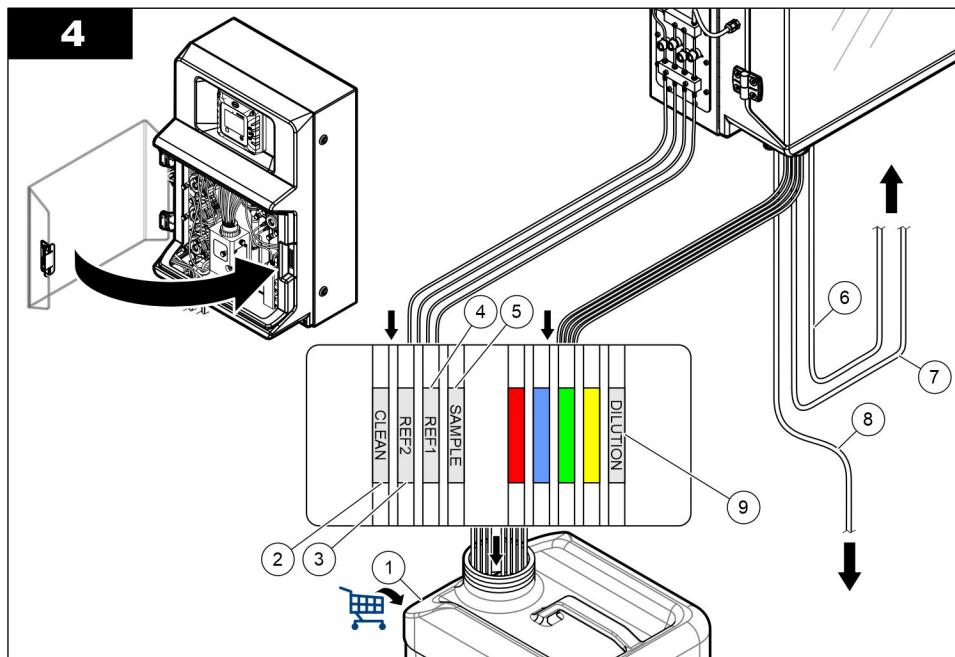

1 Αποιονισμένο νερό	4 Σωλήνας διαλύματος αναφοράς 1 (REF1)	7 Συσσκευή χώνευσης αερισμού
2 Σωλήνας διαλύματος καθαρισμού	5 Σωλήνας εισόδου δείγματος	8 Σωλήνωση αποστράγγισης
3 Σωλήνας διαλύματος αναφοράς 2 (REF2)	6 Σωλήνωση αερισμού	9 Σωλήνωση μικροαντλίας αντιδραστήριου και αραιώσης

## Ενότητα 6 Εκκίνηση

### 6.1 Αρχική εκκίνηση

**Σημείωση:** Βεβαιωθείτε ότι η στερέωση, η σωλήνωση και οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις έχουν ολοκληρωθεί πλήρως πριν από την εκκίνηση. Ανατρέξτε στην ενότητα [Εγκατάσταση](#) στη σελίδα 403.

Όταν ο αναλυτής ενεργοποιείται για πρώτη φορά, ένας βοηθός εκκίνησης θα σας βοηθήσει με τα πρώτα βήματα για την ολοκλήρωση της ρύθμισης. Ολοκληρώστε όλα τα βήματα που ακολουθούν, για να βεβαιωθείτε ότι ο αναλυτής λειτουργεί σωστά.

**Σημείωση:** Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τα σωστά αντιδραστήρια για το επιλεγμένο εύρος μέτρησης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική έκδοση του εκτεταμένου εγχειριδίου χρήστη.

1. Ανοίξτε την πόρτα του αναλυτή. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ανοίξτε την πόρτα του αναλυτή](#) στη σελίδα 404.
2. Θέστε τον διακόπτη τροφοδοσίας στη θέση ενεργοποίησης. Ανατρέξτε στην ενότητα [Εικόνα 9](#) στη σελίδα 460.
3. Κλείστε τη θύρα του αναλυτή με το παρεχόμενο κλειδί.
4. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία αρχικοποίησης.
5. Απαντήστε στις προτροπές στην οθόνη για να επιλέξετε τη γλώσσα, τη ζώνη ώρας, την ημερομηνία και την ώρα.

Για να διαμορφώσετε τις άλλες ρυθμίσεις του ελεγκτή, ανατρέξτε στα έγγραφα του Ελεγκτή SC4500.

6. Πατήστε την οθόνη για να εμφανιστεί το μενού **EZ2700sc**.
7. Επιλέξτε το **Μενού συσκευής**, για να ξεκινήσει ο βοηθός εκκίνησης. Εμφανίζεται η οθόνη καλωσορίσματος.
8. Ολοκληρώστε τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη, για να επιλέξετε το κατάλληλο εύρος μέτρησης. Πατήστε **OK**.
9. Εάν έχει εγκατασταθεί μονάδα διήθησης, επιλέξτε **Ενεργοποίηση**. Διαφορετικά, επιλέξτε **Απενεργοποίηση**.
10. Επιλέξτε τον αριθμό των καναλιών για τον αναλυτή. Πατήστε **OK**.
11. Εάν η διαμόρφωση που εμφανίζεται στη σελίδα σύνοψης είναι σωστή, πατήστε **OK**. Εμφανίζεται το κύριο μενού **EZ2700sc**.
12. Συνεχίστε με τη δοκιμή εξαρτημάτων. Ανατρέξτε στην ενότητα **Εκτέλεση των δοκιμών εξαρτημάτων** στη σελίδα 414.

## 6.2 Εκτέλεση των δοκιμών εξαρτημάτων

### ▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Κίνδυνος μαγκώματος. Τα κινούμενα εξαρτήματα μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμό. Μην αγγίζετε τα κινούμενα μέρη.

Πραγματοποιήστε τις δοκιμές εξαρτημάτων πριν τεθεί σε λειτουργία ο αναλυτής. Χρησιμοποιήστε το μενού **Συντήρηση** για να ξεκινήσετε τις διαφορετικές λειτουργίες του αναλυτή, προκειμένου να εξετάσετε τη λειτουργία του εξαρτήματος.

#### Προαπαιτούμενα:

- Εάν ο αναλυτής βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας, επιλέξτε **Συντήρηση > Έναρξη λειτουργίας συντήρησης**.
- Βεβαιωθείτε ότι το δείγμα, το αντιδραστήριο και η σωλήνωση διαλύματος βρίσκονται σε περιέκτη με αποιονισμένο νερό. Ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνδεση του αναλυτή για τη δοκιμή εξαρτημάτων** στη σελίδα 409.

#### 6.2.1 Εξέταση του αναδευτήρα

1. Αφαιρέστε την προστασία φωτός από τη μονάδα φωτόμετρου. Ανατρέξτε στην ενότητα **Εικόνα 13** στη σελίδα 472.
2. Βεβαιωθείτε ότι ο αναδευτήρας βρίσκεται στον πτυθμένα του δοχείου δείγματος.  
**Σημείωση:** Εξετάστε τον αναδευτήρα κατά τη διαδικασία της πλήρωσης, για να βεβαιωθείτε ότι ο αναδευτήρας περιστρέφεται σωστά. Η διαδικασία πλήρωσης ξεκινά σε **Εξέταση των αντλιών και των βαλβίδων σύσφιγξης** στη σελίδα 414.
3. Εγκαταστήστε την προστασία φωτός στο φωτόμετρο.

#### 6.2.2 Εξέταση των αντλιών και των βαλβίδων σύσφιγξης

1. Εξετάστε τη λειτουργία των αντλιών και των βαλβίδων σύσφιγξης, για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν διαρροές.
2. Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο ανάλυσης γεμίζει με αποιονισμένο νερό. Ανατρέξτε στην ενότητα **Εικόνα 14** στη σελίδα 473.
3. Βεβαιωθείτε ότι το αποιονισμένο νερό εξέρχεται από τη σωλήνωση αποστράγγισης.
4. Επιλέξτε **Συντήρηση > Έναρξη πλήρωσης** και πραγματοποιήστε πλήρωση όλων των υγρών ξεχωριστά.  
Εάν παρουσιαστεί διαρροή, εξετάστε όλες τις συνδέσεις και ανατρέξτε στην ηλεκτρονική έκδοση του εκτεταμένου εγχειριδίου χρήστη για περισσότερες πληροφορίες.
  - a. Επιλέξτε **Πλήρωση αναφοράς 1** και πατήστε **OK**.
  - b. Επιλέξτε **Πλήρωση αναφοράς 2** και πατήστε **OK**.

- c. Επιλέξτε **Πλήρωση διαλύματος καθαρισμού** και πατήστε **OK**.
- d. Επιλέξτε **Πλήρωση έκπλυσης** και πατήστε **OK**.
- e. Επιλέξτε **Πλήρωση διανομέα** και πατήστε **OK**.
- f. Επιλέξτε **Πλήρωση καναλιού > Πλήρωση όλων των καναλιών** και πατήστε **OK**. Κάθε διεργασία πλήρωσης διακόπτεται αυτόματα όταν ολοκληρωθεί η διεργασία.

### 6.2.3 Εξέταση των μικροαντλιών

Εξετάστε τις μικροαντλίες για διαρροές και φυσαλίδες αέρα.

1. Αφαιρέστε την προστασία φωτός από το φωτόμετρο.
2. Επιλέξτε **Συντήρηση > Έναρξη πλήρωσης > Πλήρωση όλων των αντιδραστηρίων**.
3. Βεβαιωθείτε ότι το αποιονισμένο νερό εισέρχεται στη μικροαντλία μέσω καθενός από τους σωλήνες της μικροαντλίας (αντιδραστηρίου). Στη συνέχεια, μέσα στο δοχείο ανάλυσης συνεχώς χωρίς φυσαλίδες αέρα. Ανατρέξτε στην ενότητα **Εικόνα 15** στη σελίδα 475.
4. Εάν οι μικροαντλίες δεν λειτουργούν σωστά (φυσαλίδες στη σωλήνωση), χρησιμοποιήστε τη διαδικασία σύριγγας για να ωθήσετε αποιονισμένο νερό στην κατάλληλη σωλήνωση, προκειμένου να αφαιρέσετε τις φυσαλίδες. Ανατρέξτε στην ενότητα **Εικόνα 16** στη σελίδα 476.
5. Εγκαταστήστε την προστασία φωτός στο φωτόμετρο.

### 6.2.4 Εκτελέστε έλεγχο φωτόμετρου

Βεβαιωθείτε ότι το εξωτερικό του δοχείου ανάλυσης είναι καθαρό πριν από τον έλεγχο φωτόμετρου έτσι ώστε ο έλεγχος να μπορεί να ολοκληρωθεί με επιτυχία. Για να καθαρίσετε τα εξαρτήματα του αναλυτή, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική έκδοση του εκτεταμένου εγχειριδίου χρήστη για περισσότερες πληροφορίες.

1. Πατήστε το εικονίδιο του κύριου μενού και κατόπιν επιλέξτε **Συσκευές**.
2. Επιλέξτε **EZ2700sc**.
3. Μετακινηθείτε με κύλιση στο κάτω μέρος της οθόνης και κατόπιν επιλέξτε **Μενού συσκευής**.
4. Επιλέξτε **Συντήρηση > Έλεγχος φωτόμετρου**.
5. Πατήστε **OK** για να ξεκινήσει η μέτρηση. Όταν ολοκληρωθεί η σκοτεινή βαθμονόμηση, το αποτέλεσμα εμφανίζεται στην οθόνη.
6. Πατήστε **OK** για να συνεχίσετε.
7. Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας "REF1" είναι συνδεδεμένος σε δοχείο γεμάτο με αποιονισμένο νερό. Βεβαιωθείτε ότι η προστασία φωτός είναι τοποθετημένη. Ανατρέξτε στην ενότητα **Εικόνα 18** στη σελίδα 478.
8. Πατήστε **OK**. Περιμένετε μέχρι να γεμίσει το δοχείο ανάλυσης.
9. Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να προσαρμόσετε την τάση της εξόδου του αισθητήρα στα 9 V. Βλ. **Εικόνα 17** στη σελίδα 476.
10. Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η τιμή των 9 V. Έπειτα πατήστε **OK**.
11. Πατήστε **OK** για να συνεχίσετε.

## 6.3 Εκτέλεση δοκιμής σήματος εισόδου

Πριν τεθεί ο αναλυτής σε λειτουργία, εκτελέστε δοκιμή των ψηφιακών εισόδων.

**Προαπαιτούμενα:** Συνδέστε τις ψηφιακές εισόδους σε μια εξωτερική επαφή χωρίς δυναμικό (24 VDC).

Πραγματοποιήστε μια δοκιμή σήματος ψηφιακής εισόδου και σήματος αναλογικής εξόδου ως εξής:

1. Πατήστε το εικονίδιο του κύριου μενού. Κατόπιν επιλέξτε **Συσκευές**.
2. Επιλέξτε **EZ2700sc**.
3. Μετακινηθείτε με κύλιση στο κάτω μέρος της οθόνης και κατόπιν επιλέξτε **Μενού συσκευής**.

#### 4. Επιλέξτε **Διαγνωστικά στοιχεία > Σήματα**.

Εμφανίζονται τα σήματα στις ψηφιακές εισόδους.

#### 5. Συγκρίνετε την κατάσταση των ψηφιακών εισόδων στην οθόνη με τις τάσεις που παρέχονται στις ψηφιακές εισόδους (24 V = Ενεργοποίηση, 0 V = Απενεργοποίηση).

### 6.4 Εκτέλεση δοκιμής σήματος εξόδου

Πριν τεθεί ο αναλυτής σε λειτουργία, εκτελέστε δοκιμή των αναλογικών εξόδων.

**Προαπαιτούμενα:** Διαμορφώστε τις αναλογικές εξόδους (AO1–AO8, P101) για να επιλέξετε τη μέτρηση καναλιού που αντιπροσωπεύεται από κάθε αναλογική έξοδο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική έκδοση του εκτεταμένου εγχειριδίου χρήστη.

Εκτελέστε δοκιμή σήματος αναλογικής εξόδου ως εξής:

1. Πατήστε το εικονίδιο του κύριου μενού.
2. Επιλέξτε **Έξοδοι > Έξοδοι mA AOC > Δοκιμή/Συντήρηση**.

Επιλογή	Περιγραφή
<b>Δοκιμή λειτουργίας</b>	Εκτελεί δοκιμή στις εξόδους της επιλεγμένης μονάδας.
<b>Κατάσταση εξόδου</b>	Εμφανίζει την κατάσταση των εξόδων στην επιλεγμένη μονάδα.

3. Χρησιμοποιήστε ένα πολύμετρο για να μετρήσετε την τιμή mA σε κάθε αναλογική έξοδο.
4. Συγκρίνετε την τιμή mA που μετράται στις αναλογικές εξόδους με τις αναμενόμενες τιμές mA.

### 6.5 Ορισμός της ακολουθίας καναλιών

Επιλέξτε την ακολουθία με την οποία μετρώνται τα κανάλια, πόσες φορές μετράται κάθε κανάλι και τον χρόνο αναμονής πριν από τη μέτρηση ενός καναλιού. Εισαγάγετε έως και 16 γραμμές με έως και 16 κύκλους έκαστη.

1. Πατήστε το εικονίδιο του κύριου μενού και κατόπιν επιλέξτε **Συσκευές**.
2. Επιλέξτε **EZ2700sc**.
3. Μετακινηθείτε με κύλιση στο κάτω μέρος της οθόνης και κατόπιν επιλέξτε **Μενού συσκευής**.
4. Εάν ο αναλυτής βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας, επιλέξτε **Συντήρηση > Έναρξη λειτουργίας συντήρησης**.  
Περιμένετε μέχρι ο αναλυτής να είναι σε λειτουργία συντήρησης.
5. Επιλέξτε **Διαμόρφωση > Ρύθμιση ακολουθίας καναλιών**.
6. Χρησιμοποιήστε τα βέλη στην πλαινή γραμμή για να επιλέξετε μια θέση (αριθμός στην ακολουθία) και κατόπιν πατήστε **OK** για να διαμορφώσετε αυτήν τη θέση.
7. Ορίστε μια επιλογή.

Επιλογή	Περιγραφή
<b>Επιλογή</b>	Επιλέγει το κατάλληλο κανάλι ή χρόνο αναμονής.
<b>Αριθμός μετρήσεων</b>	Ορίζει τον αριθμό των μετρήσεων για ένα κανάλι.
<b>Χρόνος αναμονής</b>	Ρυθμίζει τον χρόνο αναμονής για το επιλεγμένο κανάλι.

8. Πατήστε **OK** για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

### 6.6 Υδραυλική σύνδεση των διαλυμάτων και του δείγματος

#### ▲ ΠΡΟΣΟΧΗ



Κίνδυνος έκθεσης σε χημικά. Τηρείτε τις εργαστηριακές διαδικασίες ασφάλειας και φοράτε όλα τα μέσα ατομικής προστασίας που είναι κατάλληλα για τα χημικά που χειρίζεστε. Ανατρέξτε στα υπάρχοντα φύλλα δεδομένων ασφάλειας υλικού (MSDS/SDS) για τα πρωτόκολλα ασφάλειας.

## ▲ ΠΡΟΣΟΧΗ



Κίνδυνος έκθεσης σε χημικά. Απορρίψτε τα χημικά και τα απόβλητα σύμφωνα με τους τοπικούς, περιφερειακούς και εθνικούς κανονισμούς.

## ▲ ΠΡΟΣΟΧΗ



Κίνδυνος πυρκαγιάς. Το προϊόν αυτό δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση με εύφλεκτα υγρά.

EL

Τα δοχεία αντιδραστηρίων παρέχονται με τον αναλυτή. Ανατρέξτε στην ενότητα [Εικόνα 18](#) στη σελίδα 478. Τα δοχεία για το Διάλυμα αναφοράς 1 και το Διάλυμα αναφοράς 2 καθώς και το απιονισμένο νερό παρέχονται από τον χρήστη. Μπορείτε να αγοράσετε περισσότερα δοχεία από τον κατασκευαστή.

Εγκαταστήστε τα δοχεία

- όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον αναλυτή
- 1 μέτρο κάτω από το κάτω μέρος του αναλυτή

Ανατρέξτε στην ενότητα [Εικόνα 18](#) στη σελίδα 478 για την εγκατάσταση του δοχείου.

Τα αντιδραστήρια και τα διαλύματα παρέχονται από τον χρήστη. Χρησιμοποιήστε μόνο αντιδραστήρια που παρέχονται από πιστοποιημένη εταιρεία ή χρησιμοποιήστε αντιδραστήρια ειδικά για τον κατασκευαστή. Εναλλακτικά, τα αντιδραστήρια μπορούν να παρασκευαστούν από τον χρήστη. Ακολουθήστε τις οδηγίες στο Method & Reagent Sheet (Φύλλο Μεθόδου & Αντιδραστηρίου) για το κατάλληλο μοντέλο που βρίσκεται στον ιστότοπο του κατασκευαστή.

Οι σωληνώσεις εγκαθιστώνται στο εργοστάσιο. Διαβάστε την ετικέτα σε κάθε σωλήνα, για να εντοπίσετε τη σωστή υδραυλική σύνδεση. Για τα σωστά αντιδραστήρια, διαλύματα και πρότυπα, ανατρέξτε στο ισχύον Method & Reagent Sheet (Φύλλο Μεθόδου & Αντιδραστηρίου) για το μοντέλο που βρίσκεται στον ιστότοπο του κατασκευαστή.

1. Αφού ολοκληρωθούν οι δοκιμές εξαρτημάτων, εγκαταστήστε τη σωληνώση "CLEAN" (διάλυμα καθαρισμού), "REF1" (διάλυμα αναφοράς 1) και "REF2" (διάλυμα αναφοράς 2) στους σχετικούς περιέκτες. Ανατρέξτε στην ενότητα [Εικόνα 18](#) στη σελίδα 478.
2. Εγκαταστήστε κάθε σωλήνα αντιδραστηρίου με χρωματική κωδικοποίηση στον περιέκτη αντιδραστηρίου με το ίδιο χρώμα στην ετικέτα.
3. Ανοίξτε την πηγή δείγματος (ή την έξοδο δείγματος του πίνακα Modurplex ή του πίνακα φίλτρου) στο σωλήνα εισόδου δείγματος του αναλυτή. Ανατρέξτε στην [Εικόνα 18](#) στη σελίδα 478.
4. Πατήστε το εικονίδιο του κύριου μενού και κατόπιν επιλέξτε **Συσκευές**.
5. Επιλέξτε **EZ2700sc**.
6. Μετακινηθείτε με κύλιση στο κάτω μέρος της οθόνης και κατόπιν επιλέξτε **Μενού συσκευής**.
7. Επιλέξτε **Συντήρηση > Έναρξη πλήρωσης > Πλήρωση όλων**.

## 6.7 Πραγματοποίηση επικύρωσης πριν από την αρχική ρύθμιση

Πραγματοποιήστε μια επικύρωση, για να βεβαιωθείτε ότι οι μετρήσεις βρίσκονται εντός του εύρους ανοχής. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική έκδοση του εκτεταμένου εγχειριδίου χρήστη.

1. Πατήστε το εικονίδιο του κύριου μενού και κατόπιν επιλέξτε **Συσκευές**.
2. Επιλέξτε **EZ2700sc**.
3. Μετακινηθείτε με κύλιση στο κάτω μέρος της οθόνης και κατόπιν επιλέξτε **Μενού συσκευής**.
4. Για να ξεκινήσετε μια επικύρωση, επιλέξτε **Βαθμονόμηση > Επικύρωση > Έναρξη επικύρωσης**.

Η επικύρωση μετρά το απιονισμένο νερό στη φιάλη Αναφοράς 2.

5. Για να εμφανίσετε τα αποτελέσματα, ορίστε μια επιλογή:
- **Βαθμονόμηση > Επικύρωση > Ιστορικό επικύρωσης**
  - **Διαγνωστικά στοιχεία > Ιστορικά δεδομένα > Επικύρωση**

## 6.8 Έναρξη του αναλυτή

Για να ξεκινήσετε τον αναλυτή:

EL

1. Πατήστε το εικονίδιο του κύριου μενού και κατόπιν επιλέξτε **Συσκευές**.
2. Επιλέξτε **EZ2700sc**.
3. Μετακινηθείτε με κύλιση στο κάτω μέρος της οθόνης και κατόπιν επιλέξτε **Μενού συσκευής**.
4. Επιλέξτε **Συντήρηση > Έναρξη τρόπου λειτουργίας**.

## Sisukord

- |                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| 1 Lisateave leheküljel 419         | 4 Üldteave leheküljel 421     |
| 2 Toote ülevaade leheküljel 419    | 5 Paigaldamine leheküljel 422 |
| 3 Tehnilised andmed leheküljel 420 | 6 Käivitamine leheküljel 432  |

## Osa 1 Lisateave

Põhiline kasutusjuhend sisaldab teavet, mis on kasutuselevõtuks piisav. Laiendatud kasutusjuhend on saadaval internetis ja sisaldab rohkem teavet.

<b>⚠ OHT</b>	
	Erinevad ohud. Täiendavat teavet on esitatud allpool esitatud laiendatud kasutusjuhendi üksikutes osades.

- Kasutajaliides ja navigeerimine
- Kasutamine
- Maintenance (Hooldus)
- Tõrkeotsing
- Varuosad

Skaneerige järgnevat QR-koodi, et minna laiendatud kasutusjuhendisse.



Euroopa keeled



Ameerika ja Aasia keeled

## Osa 2 Toote ülevaade

Hach EZ2700sc analüsaator on veebipõhine analüsaator, mis mõõdab veeproovide üht parameetrit tööstuslikes või keskkonnalastes rakendustes. Vt [Joonis 1](#) leheküljel 438, [Joonis 2](#) leheküljel 441 ja [Joonis 3](#) leheküljel 446.

Analüsaator on veebipõhine kolorimeetriline analüsaator vee üldiseks analüüsiks (nt nitraadid, fosfaadid). Analüsaatoril on kaugkäivituse, automaatse kontrollimise, automaatse kalibreerimise, automaatse puhastuse ja Modbusi võimalus.

Proovivesi siseneb analüsaatorisse proovitoru kaudu. Analüsaatori pumpade, klappide ja süstalde abil teiseldatakse proov ja reagentid analüüsipaneeli mõõteküveti. Kui analüüsitoiming analüüsinoos on lõpule viidud, kõrvaldab analüsaator proovi äravoolutoru kaudu. Analüüsitulemused on näha kontrolleri SC4500 ekraanil. Kontrolleri SC4500 salvestab analüsaatori andmed (andmelogi, sündmuste logi, sätete logi ja hoolduslogi). Kontrolleri SC4500 abil saate analüsaatorit kasutada ja konfigurereida.

Ostke koos analüsaatoriga Moduplexi mitme voo paneel, et analüsaator saaks mõõta rohkem (2, 4 või 8) proovivooge (kanaleid).

Proovi ettevalmistamiseks (filtreerimine, settimine) ostke analüsaatoriga koos filtreerimispaneel EZ9010, EZ9020, EZ9150, EZ9200 või EZ9250.

## Osa 3 Tehnilised andmed

Tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.

Tehniline näitaja	Üksikasjad
Mõõtmed (L × K × S)	460 × 688 × 340 mm
Korpus	IP44; ABS, PMMA ja kaetud teras
Ekraan	IP66, 3,5-tolline TFT-värviekraan mahtuvusliku puuteplaadiga
Kaal	40 kg
Nõuded vooluvõrgule	100 kuni 240 V vahelduvvoolu ±10%, 50/60 Hz
Voolutarbimine	240 V A max
Kõrgus merepinnast	Kuni 2000 m
Ülepinge kategooria	II
Keskkonnatingimused	Kasutamiseks ainult sisetingimustes
Saasteaste	2
Töötemperatuur	10 kuni 30 °C (50 kuni 86 °F); 5%-95% suhteline õhuniiskus, mittekondenseeruv, mittekorrosiivne
Hoiustamistemperatuur	-20 kuni 60 °C; 95% suhtelist õhuniiskust, mittekondenseerumise maksimum
Proovi sisselaskeava	Üks
Proovi rõhk	Välise ülevoolunõuga (avatud atmosfäärsele rõhule)
Proovi voolukiirus	100 kuni 300 ml/min
Proovi temperatuur	10 kuni 30 °C
Proovi kvaliteet	< 100 µm osakesed, max < 0,1 g/l Hägusus < 50 NTU
Suruõhk korrosiivses keskkonnas	0,2 baari (20 kPa või 3 psi); kuiv ja puhas õhk
Dreen	Õhurõhuga, ventileeritud, minimaalne Ø 32 mm
Maandus	Kuiv ja puhas madalala takistusega (< 1 Ω) maanduspool koos 2,5 mm <sup>1</sup> (13 AWG) maanduskaabliga
Analoogväljundid	Kuni kaheksa 0–20 mA (või 4–20 mA) analoogväljundit <b>Märkus.</b> Analoogväljundid varustavad ahelat toitega. SCADA või PLC süsteemi kontakte ei saa toitega varustada.
Digitaalsisendid	Seitse digitaalsisendit: kaks digitaalsisendit kaugkäivituseks. Ülejäänud digitaalsisendid on hiljem kasutamiseks.
Digitaalsed väljundid	Paneeli EZ9150 klappide ja pumpade jaoks on ette nähtud neli pingestatud digitaalväljundit; Moduplex-paneeli klappide jaoks kaheksa pingestatud digitaalväljundit; 24 V alalisvoolu, 500 mA.
Releed	Viis potentsiaalivaba kontakti (FCT), maksimumkoormusega 24 V alalisvoolu, 0,5 A (takistuskoormus)
Etherneti ühendused	Clarose Etherneti ühendus ja Modbus TCP/IP Ethernet-konnektor; LAN-i versioon; 10/100 megabitti sekundis või Profinet või Ethernet IP
RS485 side	Profibus DP või Modbus RTU

<sup>2</sup> Etherneti ja Modbusi konfigureerimise kohta saate teavet kontrolleri SC4500 dokumentidest.

<b>Tehniline näitaja</b>	<b>Üksikasjad</b>
Vastavusdeklaratsioonid	CE ja ETL sertifikaadid vastavalt UL ja CSA ohutusstandarditele, UKCA
Garantii	1 aasta (EL: 2 aastat)

## Osa 4 Üldteave

Tootja ei vastuta mingil juhul toote väärkasutusest või juhendis olevate juhiste eiramisest tulenevate kahjustuste eest. Tootja jätab endale õiguse igal ajal teha käesolevas kasutusjuhendis ja tootes muudatusi, ilma neist teatamata või kohustusi võtmata. Uuendatud väljaanded on kättesaadavad tootja veebilehel.

### 4.1 Ohutusteave

Tootja ei vastuta mis tahes kahjude eest, mida põhjustab toote vale kasutamine, sealhulgas (kuid mitte ainult) otsesed, juhuslikud ja tegevuse tulemusest tingitud kahjud, ning ütleb sellistest kahjunõuetest lahti kohaldatava seadusega lubatud täielikul määral. Kasutaja vastutab ainuisikuliselt oluliste kasutusohutude tuvastamise ja sobivate kaitsemeetodite rakendamise eest protsesside kaitsmiseks seadme võimaliku rikke puhul.

Palun lugege enne lahtipakkimist, häälestamist või kasutamist läbi kogu käesolev juhend. Järgige kõiki ohutus- ja ettevaatusjuhiseid. Vastasel juhul võib kasutaja saada raskeid kehavigastusi või võib seade vigastada saada.




Kui seadet kasutatakse viisil, mida tootja ei ole ette näinud, võib seadme pakutav kaitse kahjustada. Ärge paigaldage seda seadet juhendis mittekirjeldatud viisil.




#### 4.1.1 Ohutusteabe kasutamine

<b>⚠ OHT</b>
Näitab võimalikku või vahetult ohtlikku olukorda, mis selle eiramisel põhjustab surma või raskeid vigastusi.
<b>⚠ HOIATUS</b>
Näitab võimalikku või vahetult ohtlikku olukorda, mis selle eiramisel võib põhjustada surma või raskeid vigastusi.
<b>⚠ ETTEVAATUST</b>
Näitab võimalikku ohtlikku olukorda, mis selle eiramisel võib põhjustada kergeid või keskmisi vigastusi.
<b>TEADE</b>
Tähistab olukorda, mis selle eiramisel võib seadet kahjustada. Eriti tähtis teave.


#### 4.1.2 Hoiatussildid

Lugege läbi kõik seadmele kinnitatud sildid ja märgised. Juhiste eiramise korral võite saada kehavigastusi või võib seade kahjustada saada. Mõõteriistal olevad sümbolid viitavad kasutusjuhendis esitatud ettevaatusabinõudele.










	See on ohutushäire sümbol. Võimalike kehavigastuste vältimiseks järgige kõiki ohutusjuhiseid, mis on selle sümboliga tähistatud. Kui see asub mõõteriista peal, siis juhinduge kasutusjuhendist või ohutuseeskirjadest.
	See sümbol viitab kemikaalidest tulenevatele ohtudele ja annab teada, et ainult need töötajad, kes on kemikaalidega töötamise osas väljaõppe saanud, tohivad kemikaale käsitleda ning selle seadmega seotud kemikaale väljastavaid süsteeme hooldada.
	See sümbol osutab elektrilõõgi ohule ja/või ohule elektrilõõgist surma saada.

	See sümbol näitab, et seadmed on tundlikud elektrostaatilise laengu (ESD) suhtes ja selle vastu tuleb seadmeid kaitsta.
	See sümbol näitab, et märgistatud seade vajab kaitsemaandusühendust. Kui seadme juhtmel tarnimisel maanduspistikut ei ole, looge kaitsemaandusühendus kaitse-elektrijuhi klemmiga.
	Selle sümboliga tähistatud elektriseadmeid ei tohi käidelda Euroopa kodustes või avalikes jäätmekäitlussüsteemides. Tagastage vanad ja kasutuskõlbatud seadmed tasuta utiliseerimiseks tootjale.

### 4.1.3 Keemiline ja bioloogiline ohutus

⚠ OHT	
	Keemiline ja bioloogiline oht. Kui seda seadet kasutatakse puhastusprotsessi ja/või keemilise puhastuse süsteemide jälgimiseks, mille kohta kehtivad regulatiivsed piirangud ning rahva tervise ja ohutuse ning toidu ja joogi tootmise või töötlemisega seotud jälgimise nõuded, on seadme kasutaja vastutus tunda kohaldatavaid õigusakte ja neid järgida ning kasutada piisavaid ja sobivaid meetodeid, et tagada vastavus kohaldatavatele õigusaktidele seadme rikke korral.

## 4.2 Illustratsioonidel kasutatud ikoonid

				
Tootja tarnitavad varuosad	Kasutaja tarnitavad varuosad	Vaata	Tee toimingud vastupidises järjekorras	
				
Kasuta kaht inimest	Kuula	Kasuta ainult sõrmede jõudu	Ära kasuta tööriistu	Ärge puudutage

### 4.3 Ettenähtud kasutusotstarve

Hach EZ-seeria analüsaatorid on mõeldud kasutamiseks neile, kes peavad pidevalt mõõtma veeproovide kvaliteediparameetreid tööstuslikes või keskkonnalastes rakendustes. Hach EZ-seeria analüsaatorid ei töötle ega teisenda vett ning neid ei kasutata juhtimisprotseduurides.

### 4.4 Toote osad

Veenduge, et olete kõik osad kätte saanud. Vt [Joonis 4](#) leheküljel 450. Kui mõned esemed puuduvad või on kahjustatud, siis pöörduge kohe tootja või müügiesindaja poole.

## Osa 5 Paigaldamine

⚠ OHT	
	Erinevad ohud. Selles dokumendi osas kirjeldatud toiminguid tohivad teha vaid pädevad töötajad.

## 5.1 Paigaldusjuhised

### ▲ HOIATUS



Tuleoht. Kui seadet kasutatakse süttivaid vedelikke kasutavate meetoditega, vastutab kõigi ohutusnõuete täitmise eest kasutaja. Järgige kõiki tööohutusnõudeid. Need hõlmavad ka lekete koristamist, korraliku ventilatsiooni tagamist ja seda, et sisse lülitatud seadet ei jäeta kunagi järelevalveta.

### ▲ ETTEVAATUST



Kemikaalidega kokkupuute oht. Järgige labori ohutusprotseduure ja kasutage käideldavatele kemikaalidele vastavat kaitsevarustust. Ohutuseeskirjad leiata käesolevatelt ohutuskaartidelt (MSDS/SDS).

### ▲ ETTEVAATUST



Kemikaalidega kokkupuute oht. Järgige kemikaalide ja jäätmete kõrvaldamisel kohalikke, piirkondlikke ja riiklikke õigusakte.

- Paigaldage analüsaator hoones ohutusse kohta.
- Paigaldage analüsaator kohta, mis on kaitstud korrodeerivate vedelike eest.
- Paigaldage analüsaator puhtasse, kuiva, hästi ventileeritud ja püsiva temperatuuriga kohta.
- Paigaldage analüsaator proovivõtu kohale võimalikult lähedale.
- Ärge paigaldage analüsaatorit otsese päikesevalguse kätte ega soojusallika lähedusse.
- Veenduge, et torustiku ja elektriliideste juures on piisavalt vaba ruumi.
- Jätke analüsaatori ette piisavalt vaba ruumi analüsaatori luugi avamiseks. Vt [Analüsaatori mõõdud](#) leheküljel 423.
- Veenduge, et töökeskkond vastab juhendis näidatud tingimustele. Vt [Tehnilised andmed](#) leheküljel 420.

Kuigi analüsaator pole mõeldud kasutamiseks süttivate proovidega, kasutavad mõned EZ-analüsaatorid süttivaid reagente. Lisateavet analüsaatoris kasutatava reagenti kohta vt asjakohase EZ-sarja mudeli lehelt Method & Reagent Sheet. Kui analüsaator kasutab süttivaid reagente, järgige kindlasti järgmisi ohutusnõudeid.

- Hoidke analüsaator eemal kuumusest, sädemetest ja lahtisest tules.
- Ärge sööge, jooge ega suitsetage analüsaatori läheduses.
- Kasutage kohalikku väljatõmbeventilatsiooni.
- Kasutage sädeme- ja plahvatuskindlaid seadmeid ja valgusteid.
- Vältige staatilisi elektrilahendusi. Vt [Elektrostaatilise lahenduse \(ESD\) märkused](#) leheküljel 424.
- Enne kasutamist puhastage ja kuivatage seade täielikult.
- Enne tööpause ja pärast tööd peske käsi.
- Kõrvaldage saastatud riietus. Enne uuesti kasutamist peske riietust.
- Neid vedelikke tuleb käsitseda vastavalt kohalikele nõudmistele lubatud kontakteerumiskiiride suhtes.


## 5.2 Analüsaatori mõõdud

Analüsaatori mõõtmeid vt [Joonis 5](#) leheküljel 454.

## 5.3 Mehaaniline paigaldamine

### 5.3.1 Kinnitage seade seinale

▲ HOIATUS	
	Kehavigastuse oht. Veenduge, et seinatoend taluks neljakordset seadme massi.

▲ HOIATUS	
	Kehavigastuse oht. Seadmed ja osad on rasked. Kasutage paigaldusel ja teisaldamisel abi.

▲ HOIATUS	
	Kehavigastuse oht. Seade on raske. Veenduge, et seade on ohutuks tööks kindlalt seinale, lauale või pörandale külge kinnitatud.

Kinnitage seade komplektis olevate kinnituskronsteinide abil püstises asendis ja sirgelt tasasele vertikaalsele seinale. Vt [Joonis 6](#) leheküljel 456.

Paigaldage seade sellisesse kohta ja asendisse, et kasutaja saaks seda hõlpsasti vooluvõrgust lahti ühendada.

Veenduge, et analüsaatori all on pudelite paigaldamiseks piisavalt vaba ruumi.

Paigaldamiseks vajalikud vahendid hangib kasutaja. Veenduge, et seinakinnitid on piisava kandevõimega (ligikaudu 160 kg). Paigaldustarvikud peavad olema seinale omaduste suhtes heaks kiidetud.


### 5.3.2 Avage analüsaatori luuk

Analüsaatori küljel olevate kahe lukustuse avamiseks kasuta kaasasolevat võtit. Vt [Joonis 7](#) leheküljel 456. Enne kasutamist sulgege kindlasti luuk, et korpuse keskkonna- ja ohutusnõuded oleksid täidetud.

## 5.4 Elektripaigaldis

▲ OHT	
	Elektriöögioht. Elektrihendusi tehes eemaldage seade alati vooluvõrgust.

### 5.4.1 Elektrostaatilise lahenduse (ESD) märgused

TEADE	
	Võimalik seadme kahjustamise oht. Tundlikud elektroonilised siseosad võivad staatilise elektrilaengu mõjul vigastada saada, mis põhjustab talitlushäireid või rikke.

Elektrostaatilisest lahendusest seadmele põhjustatud kahjustuste vältimiseks järgige järgmisi juhiseid:

- Puudutage oma keha staatilise elektri eemaldamiseks mõnd maandatud metallpinda, näiteks seadme kere, metallkarbikut või -toru.
- Vältige liigseid liigutusi. Transportige staatilise elektri suhtes tundlikke osi staatilise elektri vastastes mahutites või pakendites.
- Kandke randmepaela, mis on juhtme abil maaga ühendatud.
- Töötage vaid staatikavabas keskkonnas, kus on antistatilisest pörandale- ja tööpingimatid.

## 5.4.2 Elektriühendused

Pange välisseadmete kaablid läbi kaablite läbiviiktihendite. Vt [Joonis 8](#) leheküljel 458. Hoidke otsikuid kasutamata kaablite läbiviiktihendites.

[Joonis 9](#) leheküljel 461 näitab analüsaatori komponente. Toitelüliti on kaitselüliti, mis katkestab automaatselt vahelduvvoolu toiteliniilt tuleva põhitoite, kui tekib liigvool (nt lühiühendus) või liigpinge.

## 5.4.3 Välisseadmete ühendamine

Ühendage analüsaatori signaal- ja juhtklemmidega välisseadmed, mida koos analüsaatoriga kasutatakse. Vt [Joonis 10](#) leheküljel 464 ja [Tabel 1](#) leheküljel 425.

**Tabel 1 Signaal- ja juhtklemmid – kirjeldused**

Kontakt	Kirjeldus
AO1–AO8 (P101)	Välisseadmete juhtimiseks on kaheksa analoogväljundit. Lisateavet vaadake laiendatud kasutusjuhendi versioonist internetis.
FCT1–FCT5 (P102)	Releesid on viis (potentsiaalivabad kontaktid). Maksimaalne koormus on 24 volti alalisvoolu, 0,5 A. <ul style="list-style-type: none"><li>• FCT1 – rikkealarm</li><li>• FCT2 – hooldusalarm</li><li>• FCT3 – analüsaator on valmis</li><li>• FCT4 ja FCT5 – hiljem kasutamiseks</li></ul>
DI1–DI7 (P103)	Analüsaatori kaugjuhtimiseks on seitse digitaalsisendit <sup>5</sup> . Ühendage digitaalsisendid väise potentsiaalivaba kontaktiga (24 volti alalisvoolu), et analüsaator aktiveeruks ja alustaks kanali mõõtmist. <ul style="list-style-type: none"><li>• DI1 – kanali 1 kaugkäivitus</li><li>• DI2 – kanali 2 kaugkäivitus</li><li>• DI3 kuni DI7 – hiljem kasutamiseks</li></ul>
FB1–FB4 (P104)	Profibus DP või Modbus RTU (RS485) konnektorid <b>Profibus DP:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• FB1—A1 (sisend)</li><li>• FB2—A2 (väljund)</li><li>• FB3—B1 (sisend)</li><li>• FB4—B2 (väljund)</li><li>• SHL – varjestus</li></ul> <b>Modbus RTU:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• FB1—D (+)</li><li>• FB2—D (-)</li><li>• FB3 – ei kasutata</li><li>• FB4 – ei kasutata</li><li>• SHL – varjestus</li></ul> Modbusi konfigureerimise juhiseid ja sõnumisilte vaadake kontrolleri SC4500 dokumentidest.
24 volti alalisvoolu / 1 A (P105)	Filtreerimiseadme EZ9010 ja EZ9020 toide, 24 volti alalisvoolu

<sup>5</sup> Kaugjuhtimine keelatakse, kui analüsaator on hooldusrežiimis.

**Tabel 1 Signaal- ja juhtklemmid – kirjeldused (järgneb)**

Kontakt	Kirjeldus
STR1–STR8 (P106)	<p>Valikulise Moduplex-paneeli jaoks on kaheksa digitaalväljundit. Ühendage Moduplex-paneeli kanaliklappide isolatsioonita juhtmed seotud STR-konnektoritega.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• STR1— kanal 1</li> <li>• STR2— kanal 2</li> <li>• ...</li> <li>• STR8 — kanal 8</li> </ul>
EXT9–EXT12 (P107)	<p>Valikulise filtreerimispaneeli EZ9150 jaoks on neli digitaalväljundit. Ühendage filtreerimispaneeli EZ9150 elektrijuhtimisega klapp ja pump EXT-konnektoritega.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EXT9 – loputusklapp</li> <li>• EXT10 – tagasiuhteklapp</li> <li>• EXT11 – ülevoolutühjendusklapp</li> <li>• EXT12 – filtripump</li> </ul>
D01–D06 (P108 ja P109)	<p>Kuus pneumaatilise klapi väljundit EZ9150 paneeli jaoks.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• D01 — proovi sisselaskeklapp</li> <li>• D02 — ülevoolutühjendusklapp</li> <li>• D03 — kanali 1 klapp</li> <li>• D04 — kanali 2 klapp</li> <li>• D05 — kanali 3 klapp</li> <li>• D06 — kanali 4 klapp</li> </ul>

#### 5.4.4 Vahelduvvoolutoite ühendamine

### ⚠ OHT



Elektrilöögi- ja tuleoht. Veenduge, et kaasasolev juhe ja mittelukustuv pistik vastaksid riigihäise alusel kehtivatele nõuetele.


- Hoolitsege selle eest, et toiteliinile oleks paigaldatud piisava voolutugevusega kaitselüliti.
- Tagage, et analüsaatori lähedusse saaks paigaldatud kaitselüliti või avariilüliti, et analüsaatori toite saaks vajaduse korral kohe lahutada.
- Ühendage seade vastavalt kohalikule, piirkondlikule või riiklikule elektriseadusele.
- Paigaldage komplektis olev toitejuhe läbi analüsaatori küljel oleva juhtme läbiviikihendi.
- Pingutage kaabli läbiviikihendit, et toitekaabel oleks kindlalt paigal ja korpuse keskkonnanõuded oleksid täidetud.

Ühendage analüsaator komplektis oleva vahelduvvoolukaabli abil vahelduvvoolutoitega. Vt Tabel 2 leheküljel 427 ja Joonis 11 leheküljel 468.

## TEADE

Ärge lülitage toitelüliti sisse. Enne käivitamist ühendage kõik elektriosad ja torud, muidu võib analüsaator kahjustada saada.

**Tabel 2 Ühendused – vahelduvvool**

Klemm	Kirjeldus	Kaabli värv – Põhja-Ameerika ja Kanada	Kaabli värv – EL
L	Faas/liin (L)	Must (1)	Pruun
N	Neutraalne (N)	Valge (2)	Sinine
	Kaitsemaandus (PE)	Kollase triibuga roheline	Kollase triibuga roheline

ET

## 5.5 Veetorustikuga ühendamine

### 5.5.1 Proovivõtukanaliga seotud juhised

#### ▲ ETTEVAATUST



Tuleoht. Käesolev toode pole mõeldud kasutamiseks kergestisüttivate vedelikega.

Mõõtevahendi parima jõudluse saavutamiseks valige hea proovivõtupunkt. Proov peab kajastama kogu süsteemi tööd.

- Veenduge, et proovivool on tugevam kui analüsaatorisse suunduv vool.
- Kui analüsaator kasutab proovi analüüsinõusse transportimiseks peristaltilist pumpa, veenduge, et proovireale mõjub õhurõhk.
- Veenduge, et proovivõtuliin võtab proovianet analüsaatori läheduses olevast väikesest ülevoolunõust.
- Kasutage kaasas olevat proovivoolikut. Ärge muutke proovivooliku pikkust.

Ülevoolunõus olevat proovivedelikku tuleb pidevalt vahetada. Kui proovivedelikus on setete sisaldus liiga kõrge, on soovitatav proovikogust ka filtreerida.

### 5.5.2 Juhised äravoolutoru kohta

#### ▲ HOIATUS



Tuleoht. Kui seadet kasutatakse süttivaid vedelikke kasutavate meetoditega, vastutab kõigi ohutusnõuete täitmise eest kasutaja. Järgige kõiki tööohutusnõudeid. Need hõlmavad ka lekete koristamist, korraliku ventilatsiooni tagamist ja seda, et sisse lülitatud seadet ei jäeta kunagi järelevalveta.

#### ▲ ETTEVAATUST



Kemikaalidega kokkupuute oht. Järgige kemikaalide ja jäätmete kõrvaldamisel kohalikke, piirkondlikke ja riiklikke õigusakte.

## TEADE

Ärge ühendage äravooluliine muude liinidega, sest selle tagajärjeks võib olla vasturõhk või analüsaatori kahjustamine. Veenduge, et äravooluliinid on õhule avatud.

## TEADE

Vasturõhu ja analüsaatori kahjustamise vältimiseks veenduge, et analüsaator asub hoones kasutatavast äravoolust kõrgemal ning äravooluliini on suunaga allapoole. Installige äravooluliinid nii, et torude langusnurk on 2,54 cm (1 toll) 0,3 m (1 jala) torustiku kohta.

Analüsaator kasutab äravooluliini proovi ja reagentide väljastamiseks. Äravoolutorude õige paigaldamine on oluline selleks, et tagada mõõtevahendist kogu vedeliku eemaldamine. Ebaõige paigaldamine võib põhjustada vedeliku tagasivoolamist mõõtevahendisse ja kahjustusi. Põranda või kraanikausi dreene on dreniliini jaoks piisav. Äravoolutoru soovituslik välidiameter on 32 mm. Vt [Joonis 12](#) leheküljel 470.

- Äravoolutorud tuleb teha võimalikult lühikesed.
- Veenduge, et dreene on analüsaatorist madalamal.
- Veenduge, et äravoolutorudel oleks pidev kalle allapoole.
- Veenduge, et äravoolutorudel ei oleks järske keerukohti ja et torud ei oleks kokku pigistatud.
- Veenduge, et äravoolutorud oleksid õhule avatud ja nullrõhul.
- Veenduge, et äravoolutorud oleksid paigalduskohas keskkonna suhtes suletud.
- Ärge blokeerige äravooluliini ega paigutage seda täielikult vee sisse.

Samuti on soovitatav luua analüsaatori läheduses ühendus veevõrguga, et äravoolusüsteemi kraanikaussi ja torusid saaks regulaarselt puhta veega loputada ja vältida kristalliseerumisest tingitud takistusi.

Lisateavet analüsaatoris kasutatava reaktiivi kohta vt asjakohase EZ-sarja mudeli lehel Method & Reagent Sheet. Kui analüsaator kasutab süttivaid reagente, järgige kindlasti järgmisi ohutusnõudeid.

- Ärge juhtige äravoolutoru põranda äravoolu.
- Täitke patareide kasutuselt kõrvaldamisel kohalikke, piirkondlikke ja riiklikke eeskirju.

### 5.5.3 Juhised ventilatsioonitoru kohta

#### ▲ HOIATUS



Tuleoht. Kui seadet kasutatakse süttivaid vedelikke kasutavate meetoditega, vastutab kõigi ohutusnõuete täitmise eest kasutaja. Järgige kõiki tööohutusnõudeid. Need hõlmavad ka lekete koristamist, korraliku ventilatsiooni tagamist ja seda, et sisse lülitatud seadet ei jäeta kunagi järelevalveta.

#### ▲ ETTEVAATUST



Kemikaalidega kokkupuute oht. Järgige kemikaalide ja jäätmete kõrvaldamisel kohalikke, piirkondlikke ja riiklikke õigusakte.

## TEADE

Ärge ühendage ventilatsioonitoru (heitgaasitoru) muude torudega, sest selle tagajärjeks võib olla vasturõhk või analüsaatori kahjustamine. Veenduge, et ventilatsioonitoru oleks hoone välisseinas õhule avatud.

## TEADE

Vasturõhu ja analüsaatori kahjustamise vältimiseks veenduge, et analüsaator asub hoones kasutatavast ventilatsioonist kõrgemal ning ventilatsioonitoru on suunaga allapoole. Paigaldage ventilatsioonitorud nii, et torude langusnurk on 2,54 cm (1 toll) 0,3 m (1 jala) torustiku kohta.

Analüsaatori ventilatsioonitoru kasutatakse analüüsainõus atmosfäärirõhu säilitamiseks. Tähtis on ventilatsioonitoru õigesti paigaldada, et pumba töötamisel ei tuleks vett kindlasti ventilatsioonitoru kaudu analüüsainõusse. Ebaõige paigaldamine võib põhjustada gaasi tagasivoolamist analüsaatorisse ja kahjustusi. Soovitatav välisläbimõõt ventilatsioonitoru kollektori jaoks on 32 mm. Vt [Joonis 12](#) leheküljel 470.

- Ventilatsioonitorustik tuleb teha võimalikult lühike.
- Veenduge, et ventilatsioonitorul oleks pidev kalle allapoole.
- Veenduge, et ventilatsioonitorul ei oleks järske keerukohti ja et torud ei oleks kokku pigistatud.

- Veenduge, et ventilatsioonitoru oleks paigalduskohas keskkonna suhtes suletud ja nullrõhul.
- Veenduge, et ventilatsioonitoru oleks alati äravoolutorust kõrgemal.
- Ärge blokeeri ventilatsioonitoru ega paigutage seda täielikult vee sisse.

Kui analüsaator kasutab süttivaid reagente, järgige kindlasti järgmisi ohutusnõudeid.

- Ärge juhtige ventilatsioonitoru põranda äravoolu.
- Täitke patareide kasutusel kõrvaldamisel kohalikke, piirkondlikke ja riiklikke eeskirju.

#### 5.5.4 Analüsaatori torustikuga ühendamine komponentide testiks


### ▲ ETTEVAATUST





Tuleoht. Käesolev toode pole mõeldud kasutamiseks kergestsüttivate vedelikega.

Enne seda, kui analüsaator võetakse koos kõikide reaktiividega kasutusele, tuleb teha komponentide test deioniseeritud veega. Vt illustreeritud juhiseid ja [Komponentide kontrollimine](#) leheküljel 433.

1. Paigaldage neli sulgurklapi toru allpool illustreeritud etapi 1 kohaselt.
  - a. Vajutage musta nuppu ja siis vajutage toru klappi.
  - b. Vabastage nupp, kui toru on õigesti paigaldatud.
2. Veenduge, et tühjendusvoolikud oleksid proovinõusse õigesti paigaldatud. Järgige alltoodud illustreeritud juhist 2.
3. Veenduge, et töötlusvoolikud oleksid töötlusnõusse õigesti paigaldatud. Järgige alltoodud illustreeritud juhist 3.
4. Komponentide testimiseks ühendage analüsaatori vedelikutorud suure pudeliga, kus on deioniseeritud vesi. Järgige alltoodud illustreeritud juhist 3. Voolikud paigaldatakse tehases.

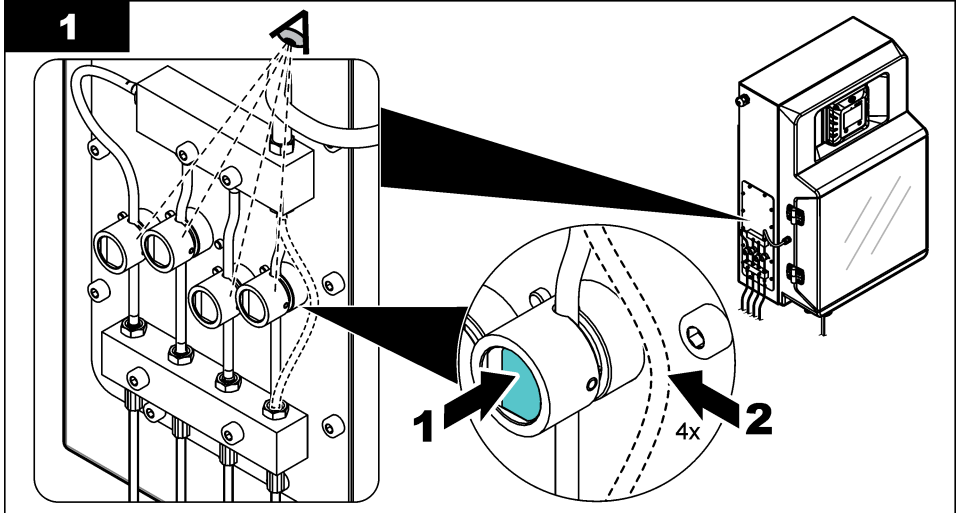


2

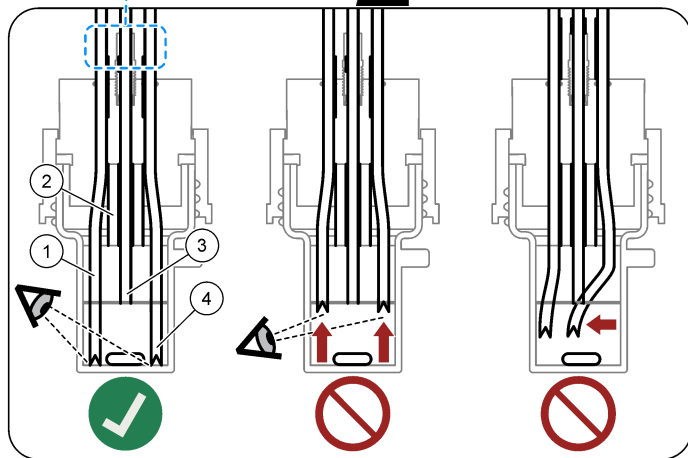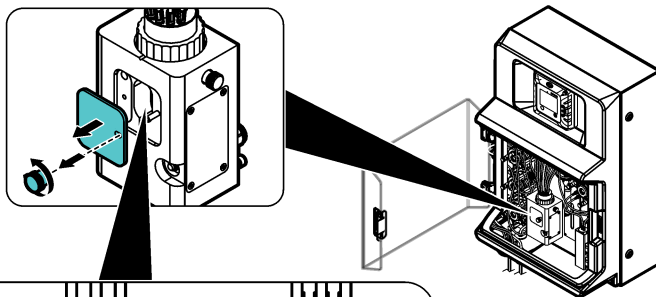

1 Äravooluvoolikud	3 Proovivoolikud
2 Reagentide ja ventilatsioonivoolikud (ülemised voolikud)	4 Töötlusvoolikud

3

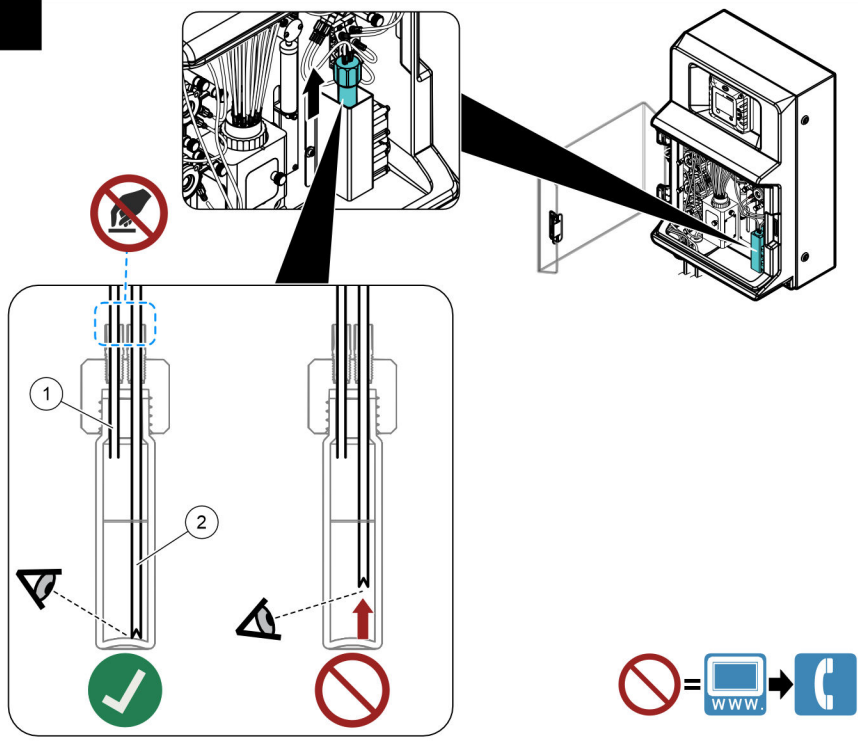


ET

1 Ventilatsioonivoolikud

2 Töötusvoolikud

4

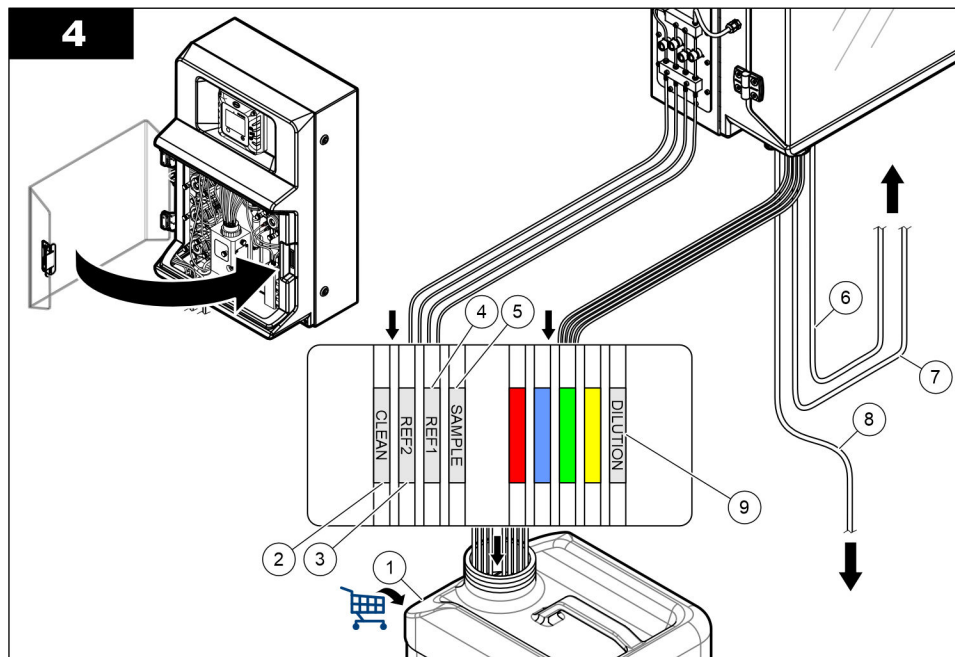

1 Deioniseeritud vesi	4 Etalonalhuse 1 (REF1) toru	7 Ventilatsiooni töötus
2 Pesulahuse toru	5 Proovi sissevõtutoru	8 Äravooluvoolikud
3 Etalonalhuse 2 (REF2) toru	6 Ventilatsioonivoolikud	9 Lahjendus- ja reagendi mikropumba toru

## Osa 6 Käivitamine

### 6.1 Esialgne käivitus

**Märkus.** Enne käivitamist kontrollige, et monteerimine ning toru- ja elektriühendused oleksid lõpule viidud. Vt [Paigaldamine](#) leheküljel 422.

Kui analüsaator käivitatakse esimest korda, aitab käivitamise abiline seadistamise esimeste toimingutega. Tehke kõik järgnevad toimingud, et tagada analüsaatori nõuetekohane töö.

**Märkus.** Veenduge, et kasutusel oleks valitud mõõtevahemiku jaoks õiged reaktiivid. Lisateavet vaadake laiendatud kasutusjuhendi versioonist internetis.

1. Avage analüsaatori luuk. Vt [Avage analüsaatori luuk](#) leheküljel 424.
2. Viige toitelüliti aktiivsesse asendisse. Vt [Joonis 9](#) leheküljel 461.
3. Sulgege analüsaatori luuk kaasasoleva võtmega.
4. Oodake kuni lähtestustoimingute lõpetamiseni.
5. Järgige ekraanil kuvatavaid viipasid ning valige keel, ajavöönd, kuupäev ja kellaaeg. Vaadake kontrolleri SC4500 dokumente, et konfigurereida kontrolleri muid sätteid.
6. Puudutage ekraani, et kuvada **EZ2700sc** menüü.
7. Valige **Device menu (Seadme menüü)**, et käivitada käivitamise abiline. Avaneb tervitusküla.
8. Tehke ekraanil kuvatavad toimingud, et valida kohaldatav mõõtevahemik. Vajutage nuppu **OK**.
9. Kui paigaldatud on filtreerimisseade, valige **On (Sees)**. Kui ei ole, valige **Off (Väljas)**.

10. Valige analüsaatori kanalite arv. Vajutage nuppu **OK**.
11. Kui kokkuvõtte lehel kuvatav konfiguratsioon on õige, vajutage nuppu **OK**.  
Kuvatakse **EZ2700sc** peamenüü.
12. Jätkake komponentide testiga. Vt [Komponentide kontrollimine](#) leheküljel 433.

## 6.2 Komponentide kontrollimine

▲ HOIATUS	
	<p>Muljumisoht. Liikuvate osade läheduses valitseb muljumisoht ja need võivad põhjustada vigastusi. Ärge liikuvaid osi puutuge.</p>

ET

Enne analüsaatori kasutamist testige komponente. Komponentide töö kontrollimiseks erinevate analüsaatori funktsioonide käivitamiseks kasutage menüüd **Maintenance (Hooldus)**.

### Eeltingimused.

- Kui analüsaator on töörežiimis, valige **Maintenance (Hooldus) > Start maintenance mode (Alusta hooldusrežiimi)**.
- Veenduge, et proovi, reagenti ja lahuse toru oleks deioniseeritud vee mahutis. [Analüsaatori torustikuga ühendamine komponentide testiks](#) leheküljel 429

### 6.2.1 Segaja kontrollimine

1. Eemaldage fotomeetrit valgustõke. Vt [Joonis 13](#) leheküljel 472.
2. Veenduge, et segaja oleks proovinõu põhjas.  
*Märkus.* Kontrollige segajat täitmise ajal ja veenduge, et segaja pöörleks õigesti. Täitmisprotsess käivitatakse toimingu [Pumpade ja sulgurklappide kontrollimine](#) leheküljel 433.
3. Paigaldage fotomeetritele valgustõke.

### 6.2.2 Pumpade ja sulgurklappide kontrollimine

1. Kontrollige pumpade ja sulgurklappide tööd, et veenduda, et lekkeid poleks.
2. Veenduge, et analüüsinõu täituks deioniseeritud veega. Vt [Joonis 14](#) leheküljel 474.
3. Veenduge, et deioniseeritud vesi lähteks äravoolutoru kaudu välja.
4. Valige **Maintenance (Hooldus) > Start priming (Alusta täitmist)** ja valmistage vedelikud eraldi ette.

Lekke korral kontrollige kõiki ühendusi ja vaadake lisateavet kasutusjuhendi laiendatud veebiversioonist.

- a. Valige **Prime reference 1 (Eeltäida etalon 1)** ja vajutage **OK**.
- b. Valige **Prime reference 2 (Eeltäida etalon 2)** ja vajutage **OK**.
- c. Valige **Prime cleaning solution (Eeltäida puhastuslahus)** ja vajutage **OK**.
- d. Valige **Prime rinsing (Eeltäida loputus)** ja vajutage **OK**.
- e. Valige **Prime dispenser (Eeltäida väljastusseade)** ja vajutage **OK**.
- f. Valige **Prime channel (Eeltäida kanal) > Prime all channels (Eeltäida kõik kanalid)** ja vajutage **OK**.  
Iga eeltäitmistoiming seiskub lõppemisel automaatselt.

### 6.2.3 Mikropumpade kontrollimine

Kontrollige mikropumpasid lekete ja õhumullide suhtes.

1. Eemaldage fotomeetrit valgustõke.
2. Valige **Maintenance (Hooldus) > Start priming (Alusta täitmist) > Prime all reagents (Täida kõik reagentid)**.

3. Veenduge, et deioniseeritud vesi läheks mikropumpa kõigi mikropumba (reagendi) torude kaudu. Seejärel peab see minema sujuvalt analüüsinõusse ilma õhumullideta. Vt [Joonis 15](#) leheküljel 475.
4. Mullide eemaldamiseks viige deioniseeritud vesi süstla abil õigesse torusse, kui mikropumbad ei tööta õigesti (torus on mullid). Vt [Joonis 16](#) leheküljel 476.
5. Paigaldage fotomeetrile valgustõke.

#### 6.2.4 Fotomeetrikontroll

Kontrolli korrektseks läbiviimiseks veenduge enne fotomeetrikontrolli, et analüüsinõu välispind oleks puhas. Täpsemat teavet analüsaatori komponentide puhastamise kohta vaadake kasutusjuhendi laiendatud veebiversioonist.

1. Vajutage peamenüü ikooni ja valige **Devices (Seadmed)**.
2. Valige **EZ2700sc**.
3. Liikuge kerides kuva allserva ja valige **Device menu (Seadme menüü)**.
4. Valige **Maintenance (Hooldus) > Photometer check (Fotometri kontroll)**.
5. Mõõtmise alustamiseks vajutage nuppu **OK**.  
Kui tumeda väärtuse kalibreerimine on lõppenud, kuvatakse tulemust ekraanil.
6. Jätkamiseks vajutage nuppu **OK**.
7. Veenduge, et toru „REF1“ oleks ühendatud deioniseeritud veega täidetud nõuga. Veenduge, et paigaldatakse valgustõke. Vt [Joonis 18](#) leheküljel 478.
8. Vajutage nuppu **OK**.  
Oodake kuni analüüsinõu täitumiseni.
9. Reguleerige anduri väljundpinge kruvikeeraja abil tasemeni 9 V. Vt [Joonis 17](#) leheküljel 476.
10. Oodake, kuni ekraanil kuvatakse väärtus 9 V. Seejärel vajutage **OK**.
11. Jätkamiseks vajutage nuppu **OK**.

### 6.3 Sisendi testimine

Enne analüsaatori kasutamist testige digitaalsisendeid.

**Eeltingimused:** ühendage digitaalväljundid välise potentsiaalivaba kontaktiga (24 V DC).

Testige digitaal- ja analoogsisendi signaali järgmisel viisil.

1. Vajutage peamenüü ikooni, seejärel valige **Devices (Seadmed)**.
2. Valige **EZ2700sc**.
3. Liikuge kerides kuva allserva ja valige **Device menu (Seadme menüü)**.
4. Valige **Diagnostics (Diagnostika) > Signals (Signaalid)**.  
Kuvatakse digitaalsisendite signaalid.
5. Võrrelge kuvatavate digitaalsisendite olekuid digitaalsisenditele antud pingega (24 V = On (Sees); 0 V = Off (Väljas)).

### 6.4 Väljundi testimine

Enne analüsaatori kasutamist testige analoogväljundeid.

**Eeltingimused:** konfigureerige analoogväljundid (AO1–AO8, P101), et valida kanali mõõtmised, mida analoogväljundid tähistavad. Lisateavet vaadake laiendatud kasutusjuhendi versioonist internetis.

Analoogväljundi testimiseks tehke järgmist.

1. Vajutage peamenüü ikooni.
2. Valige **Outputs (Väljundid) > mA outputs AOC (mA väljundid AOC) > Test/Maintenance (Testimine/Hooldus)**.

Valik	Kirjeldus
<b>Function test (Funktsiooni test)</b>	Teeb valitud mooduli väljundite testi.
<b>Output status (Väljundi olek)</b>	Näitab valitud mooduli väljundite seisundit.

3. Mõõtke iga analoogväljundi mA väärtus multimeetri abil.
4. Võrrelge analoogväljundite mõõdetud mA väärtust eeldatavate mA väärtustega.

## 6.5 Kanalite järjestuse määramine




Valige kanalite mõõtmise järjestus, iga kanali mõõtmiste arv ja ooteaeg enne kanali mõõtmist. Saate lisada maksimaalselt 16 rida ja maksimaalselt 16 tsükli iga rea kohta.

1. Vajutage peamenüü ikooni ja valige **Devices (Seadmed)**.
2. Valige **EZ2700sc**.
3. Liikuge kerides kuva allserva ja valige **Device menu (Seadme menüü)**.
4. Kui analüsaator on töörežiimis, valige **Maintenance (Hooldus) > Start maintenance mode (Alusta hooldusrežiimi)**.  
Oodake, kuni analüsaator on hooldusrežiimis.
5. Valige **Configuration (Konfigureerimine) > Channel sequence setup (Kanalite järjestuse häälestamine)**.
6. Valige külgriba noolte abil positsioon (number järjestuses) ja vajutage siis positsiooni konfigureerimiseks nuppu **OK**.
7. Tehke valik.

Valik	Kirjeldus
<b>Select (Vali)</b>	Valitakse asjakohane kanal või ooteaeg.
<b>Number of measurements (Mõõtmiste arv)</b>	Määratakse kanali mõõtmiste arv.
<b>Waiting time (Ooteaeg)</b>	Määratakse valitud kanali ooteaeg.

8. Vajutage nuppu **OK**, et muudatused salvestada.

## 6.6 Ühendage lahused ja proov

▲ ETTEVAATUST	
	Kemikaalidega kokkupuute oht. Järgige labori ohutusprotseduure ja kasutage käideldavatele kemikaalidele vastavat kaitsevarustust. Ohutuseeskirjad leiata käesolevatelt ohutuskartidelt (MSDS/SDS).
▲ ETTEVAATUST	
	Kemikaalidega kokkupuute oht. Järgige kemikaalide ja jäätmete kõrvaldamisel kohalikke, piirkondlikke ja riiklikke õigusakte.
▲ ETTEVAATUST	
	Tuleoht. Käesolev toode pole mõeldud kasutamiseks kergestisüttivate vedelikega.

Reagentimahutid kuuluvad analüsaatori komplekti. Vt **Joonis 18** leheküljel 478. Etalonlahuse 1 ja etalonlahuse 2 ning deioniseeritud vee mahutid hangib kasutaja. Tootjalt saab mahuteid juurde osta.

## Paigaldage mahutid

- analüsaatorile võimalikult lähedale
- 1 m analüsaatori põhjast allapoole

Mahuti paigaldamise kohta vt [Joonis 18](#) leheküljel 478.

Reagendi ja lahuse hangib kasutaja. Kasutage ainult sertifitseeritud ettevõtte tarnitud reagenti või tootja eesmärgipärast reagenti. Alternatiivina saab kasutaja reagentid valmistada. Vaadake juhiseid tootja veebisaidil asjakohase mudeli lehel Method & Reagent Sheet.

Voolikud paigaldatakse tehases. Korrektsse ühenduse juhised leiata voolikutel olevatelt etiketidelt. Teavet õigete reagentide, lahuste ja standardite kohta vaadake tootja veebisaidil asjakohase mudeli lehel Method & Reagent Sheet.

1. Komponentide testimise järel paigaldage seotud mahutitesse toru „CLEAN“ (pesulahus), „REF1“ (etalonlahus 1) ja „REF2“ (etalonlahus 2). Vt [Joonis 18](#) leheküljel 478.
2. Paigaldage reagenti mahutisse värvikoodiga reagenti toru, mille sildil on sama värv.
3. Ühendage proovi allikas (või Moduplex-paneeli või filtripaneeli prooviväljund) analüsaatori proovi sissevõtutoruga. Vt [Joonis 18](#) leheküljel 478.
4. Vajutage peamenüü ikooni ja valige **Devices (Seadmed)**.
5. Valige **EZ2700sc**.
6. Liikuge kerides kuva allserva ja valige **Device menu (Seadme menüü)**.
7. Valige **Maintenance (Hooldus) > Start priming (Alusta täitmist) > Prime all (Täida kõik)**.

## 6.7 Kontrollimine enne esialgset käivitust

Kontrollige, kas mõõtmistulemused on kindlasti lubatud vahemikus. Lisateavet vaadake laiendatud kasutusjuhendi versioonist internetis.

1. Vajutage peamenüü ikooni ja valige **Devices (Seadmed)**.
2. Valige **EZ2700sc**.
3. Liikuge kerides kuva allserva ja valige **Device menu (Seadme menüü)**.
4. Kontrollimise alustamiseks valige **Calibration (Kalibreerimine) > Validation (Kontrollimine) > Start validation (Alusta kontrolli)**.  
Kontrollimiseks mõõdetakse deioniseeritud vett pudelis Reference 2 (Etalon 2).
5. Tulemuste kuvamiseks tehke valik.
  - **Calibration (Kalibreerimine) > Validation (Kontrollimine) > Validation history (Kontrollimise ajalugu)**
  - **Diagnostics (Diagnostika) > Historical data (Andmeajalugu) > Validation (Kontrollimine)**


## 6.8 Analüsaatori käivitamine

Analüsaatori käivitamiseks tehke järgmist.

1. Vajutage peamenüü ikooni ja valige **Devices (Seadmed)**.
2. Valige **EZ2700sc**.
3. Liikuge kerides kuva allserva ja valige **Device menu (Seadme menüü)**.
4. Valige **Maintenance (Hooldus) > Start operational mode (Alusta töörežiimi)**.

Figures ■ Abbildungen ■ Figure ■ Figures ■ Figuras ■ Figuras  
 ■ Obrázky ■ Afbeeldingen ■ Figurer ■ Rysunki ■ Figurer ■ Kuviot  
 ■ Фигури ■ Ábrák ■ Figuri ■ Skaičiai ■ Рисунки ■ Şekil ■ Obrázky  
 ■ Slike ■ Slika ■ Εικόνες ■ Joonised


1

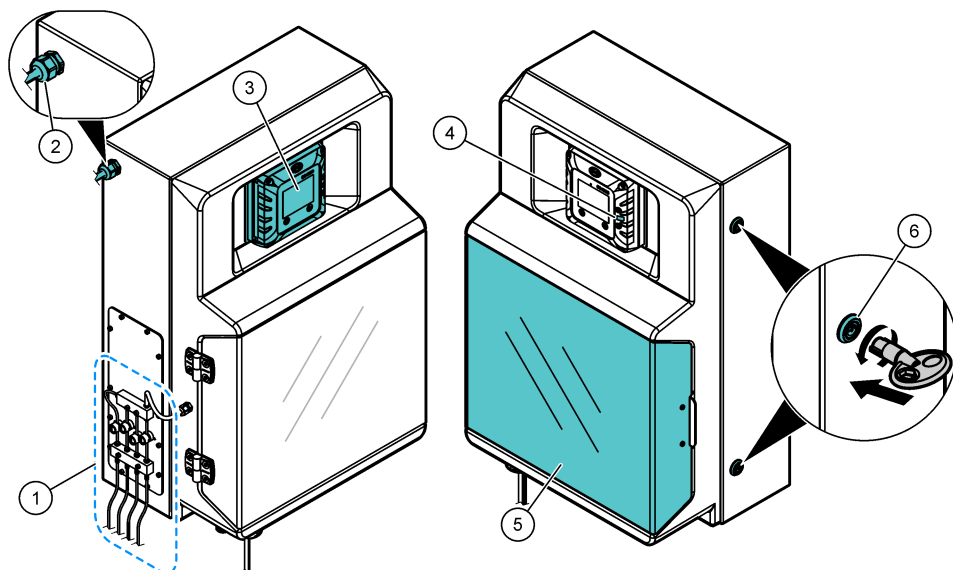

BG	1 Тръбички за почистващ разтвор, референтен разтвор и проба	3 Контролер SC4500	5 Вратичка на анализатора
	2 Кабелен салник M20 за хранващия кабел	4 USB порт за трансфер на данни	6 Ключалки на вратите
CS	1 Hadičky pro čistící roztok, referenční roztok a vzorek	3 Kontrolér SC4500	5 Dveře analyzátoru
	2 Kabelová průchodka M20 pro napájecí kabel	4 Port USB pro přenos údajů	6 Zámky dveří
DA	1 Slinger til rensningsopløsning, referenceopløsning og prøve	3 SC4500-kontrolenhed	5 Analysatordør
	2 M20-kabelforskrunding til netledningen	4 USB-port til dataoverførsel	6 Dørlåse

DE	1 Schläuche für Reinigungslösung, Referenzlösung und Probe	3 SC4500 Controller	5 Zugangstür
	2 Kabelverschraubung M20 für das Netzkabel	4 USB-Anschluss für Datenübertragung	6 Türschlösser
EL	1 Σωλήνωση για διάλυμα καθαρισμού, διάλυμα αναφοράς και δείγμα	3 Ελεγκτής SC4500	5 Θύρα αναλυτή
	2 Στυπιοθλίπτρας καλωδίου M20 για το καλώδιο τροφοδοσίας	4 Θύρα USB για μεταφορά δεδομένων	6 Κλειδαριές θυρών
EN	1 Tubing for cleaning solution, reference solution and sample	3 SC4500 Controller	5 Analyzer door
	2 M20 cable gland for the power cord	4 USB port for data transfer	6 Door locks
ES	1 Tubos para solución de limpieza, solución de referencia y muestra	3 Controlador SC4500	5 Puerta del analizador
	2 Prensaestopas M20 para cable de alimentación	4 Puerto USB para transferencia de datos	6 Cerraduras de la puerta
ET	1 Pesulahuse, etalonlahuse ja proovitoru	3 Kontrollor SC4500	5 Analüsaatori luuk
	2 M20 toitejuhtme läbiviikihend	4 Andmeedastuse USB-port	6 Ukselukud
FI	1 Puhdistusliuoksen, vertailuliuoksen ja näytteen letku	3 SC4500-ohjain	5 Analysaattorin luukku
	2 Virtajohdon M20-läpivientiholkki	4 USB-liitäntä tiedonsiirtoa varten	6 Luukun lukot
FR	1 Tuyaux pour la solution de nettoyage, la solution de référence et l'échantillon	3 Transmetteur SC4500	5 Porte de l'analyseur
	2 Passe-câble M20 pour le cordon d'alimentation	4 Port USB pour le transfert de données	6 Verrous de porte
HR	1 Cijevi za otopinu za čišćenje, referentnu otopinu i uzorak	3 Kontroler SC4500	5 Vrata analizatora
	2 Uvodnica M20 za kabel za napajanje	4 USB priključak za prijenos podataka	6 Brave za vrata
HU	1 Csővezetékek a tisztítóoldat, a referenciaoldat és a minta számára	3 SC4500 vezérlő	5 Analizátor ajtaja
	2 M20 tömszelence a tápkábel számára	4 USB-port az adatok átviteléhez	6 Ajtózárok
IT	1 Tubo per la soluzione di lavaggio, la soluzione di riferimento e il campione	3 Controller SC4500	5 Sportello analizzatore
	2 Pressacavo M20 per cavo di alimentazione	4 Porta USB per il trasferimento dei dati	6 Blocchi dello sportello
LT	1 Vamzdėliai valymo tirpalui, etaloniniam tirpalui ir mėginiui	3 SC4500 valdiklis	5 Analizatoriaus durelės
	2 M20 kabelio riebokšlis, skirtas maitinimo laidui	4 USB prievadas duomenims perduoti	6 Durelių užraktai

NL	1 Slang voor reinigungsoplossing, referentieoplossing en monster	3 SC4500-controller	5 Deur van analyser
	2 M20-kabelwartel voor het netsnoer	4 USB-poort voor gegevensoverdracht	6 Deursloten
PL	1 Rurki roztworu czyszczącego, roztworu wzorcowego i próbki	3 Przetwornik SC4500	5 Drzwi analizatora
	2 Dławik kablowy M20 do przewodu zasilania	4 Port USB do przesyłania danych	6 Zamek drzwi
PT-PT	1 Tubos para solução de limpeza, solução de referência e amostra	3 Controlador SC4500	5 Porta do analisador
	2 Caixa de empanque para cabos M20 para o cabo de alimentação	4 Porta USB para transferência de dados	6 Fechaduras da porta
RO	1 Tubulatură pentru soluția de curățare, soluția de referință și probă	3 Controler SC4500	5 Ușa analizorului
	2 Protecție cablu M20 pentru cablul de alimentare	4 Port USB pentru transfer de date	6 Încuietori ușă
RU	1 Трубки для раствора для очистки, эталонного раствора и пробы	3 Контроллер SC4500	5 Дверца анализатора
	2 Кабельный сальник M20 для кабеля питания	4 USB-разъем для передачи данных	6 Замки дверцы
SK	1 Hadičky na čistiaci roztok, referenčný roztok a vzorku	3 Kontrolér SC4500	5 Dvierka analyzátoru
	2 Kábová priechodka M20 pre napájací kábel	4 Port USB na prenos údajov	6 Zámky dvierok
SL	1 Cevi za čistilno raztopino, referenčno raztopino in vzorec	3 Kontrolna enota SC4500	5 Vrata analizatorja
	2 Kabelska uvodnica M20 za napajalni kábel	4 Vrata USB za prenos podatkov	6 Ključavnice za vrata
SV-SE	1 Slang för rengöringslösning, referenslösning och prov	3 SC4500-styrenhet	5 Analysatorlucka
	2 M20-packbox för strömsladden	4 USB-port för dataöverföring	6 Lås för luckan
TR	1 Temizleme çözeltisi, referans çözeltisi ve numune hortumu	3 SC4500 Kontrol Ünitesi	5 Analiz cihazı kapısı
	2 Güç kablosu için M20 kablo rakoru	4 Veri aktarımı için USB bağlantı noktası	6 Kapı kilitleri

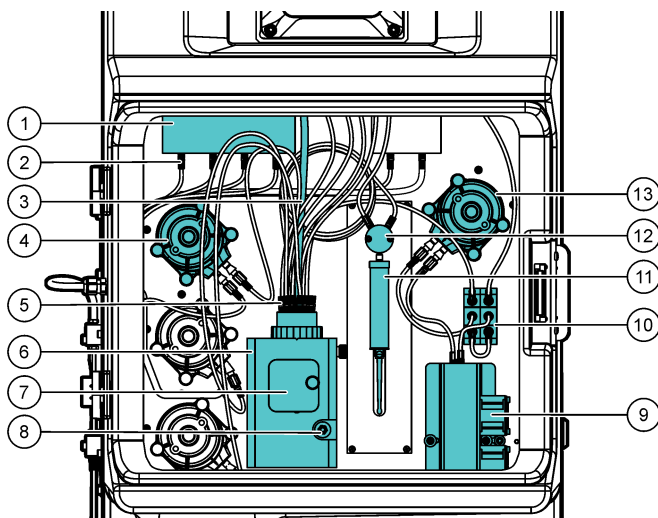

BG	1	Микропомпи (от 0 до 5x)	8	Регулиране на напрежението
	2	Входяща тръба	9	Съд на устройството за усвояване
	3	Тръби за отдушник	10	Панел на клапаните на устройството за усвояване
	4	Перисталтични помпи за източване и проба (опционално: помпа за изплакване)	11	Спринцовка (дозатор за разреждане) (опционално)
	5	Капак на съд за проба	12	Клапан (дозатор за разреждане) (опционално)
	6	Модул на фотометъра	13	Перисталтична помпа за устройството за усвояване
	7	Капак на фотометъра		
CS	1	Mikročerpadla (0 až 5x)	8	Nastavení napětí
	2	Vstupní hadička	9	Nádoba vyhřívací nádrže
	3	Odvětrávací hadička	10	Panel ventilů vyhřívací nádrže
	4	Peristaltická čerpadla pro vypouštění a odběr vzorků (volitelně: proplachovací čerpadlo)	11	Stříkačka (dávkovač ředění) (volitelně)
	5	Víko nádoby na vzorky	12	Ventil (dávkovač ředění) (volitelný)
	6	Jednotka fotometru	13	Peristaltické čerpadlo pro vyhřívací nádrž
	7	Kryt fotometru		

DA	1 Mikropumper (0 til 5x)	8 Justering af spænding
	2 Slange til indløb	9 Kar i rådnetank
	3 Udluftningslange	10 Panel for rådnetankventil
	4 Peristaltiske pumper til afløb og prøve (ekstraudstyr: skyllepumpe)	11 Sprøjte (fortyndingsdispenser) (ekstraudstyr)
	5 Prøvebeholderlåg	12 Ventil (fortyndingsdispenser) (ekstraudstyr)
	6 Fotometerenhed	13 Peristaltisk pumpe til rådnetank
	7 Dæksel til fotometer	
DE	1 Mikropumpen (0 bis 5x)	8 Spannungsanpassung
	2 Zulaufschlauch	9 Aufschlussgefäß
	3 Entlüftungsschlauch	10 Modul der Ventile des Aufschlussgefäßes
	4 Peristaltikpumpen für Abfluss und Probe (optional: Spülpumpe)	11 Spritze (Verdünnungs-Dispenser) (optional)
	5 Deckel des Probengefäßes	12 Ventil (Verdünnungs-Dispenser) (optional)
	6 Photometereinheit	13 Peristaltikpumpe für Aufschlussgefäß
	7 Abdeckung des Photometers	
EL	1 Μικροαντλίες (0 έως 5x)	8 Ρύθμιση τάσης
	2 Σωληνώσεις εισόδου	9 Δοχείο συσκευής χώνευσης
	3 Σωλήνωση αερισμού	10 Πίνακας βαλβίδας συσκευής χώνευσης
	4 Περισταλτικές αντλίες για αποστράγγιση και δείγμα (προαιρετικά: αντλία έκπλυσης)	11 Σύριγγα (διανομέας αραίωσης) (προαιρετικά)
	5 Καπάκι δοχείου δείγματος	12 Βαλβίδα (διανομέας αραίωσης) (προαιρετικά)
	6 Μονάδα φωτόμετρου	13 Περισταλτική αντλία για συσκευή χώνευσης
	7 Κάλυμμα φωτομέτρου	
EN	1 Micropumps (0 to 5x)	8 Voltage adjustment
	2 Inlet tubing	9 Digester vessel
	3 Vent tubing	10 Digester valve panel
	4 Peristaltic pumps for drain and sample (optional: rinse pump)	11 Syringe (dilution dispenser) (optional)
	5 Sample vessel lid	12 Valve (dilution dispenser) (optional)
	6 Photometer unit	13 Peristaltic pump for digester
	7 Photometer cover	
ES	1 Microbombas (0 a 5x)	8 Ajuste de tensión
	2 Tubo de entrada	9 Recipiente del digester
	3 Tubo de ventilación	10 Panel de la válvula del digester
	4 Bombas peristálticas para drenaje y muestra (opcional: bomba de enjuague)	11 Jeringa (dispensador de dilución) (opcional)
	5 Tapa del vaso de muestras	12 Válvula (dispensador de dilución) (opcional)
	6 Unidad fotométrica	13 Bomba peristáltica para el digester
	7 Cubierta del fotómetro	


ET	1 Mikropumbad (0–5x)	8 Pinge reguleerimine
	2 Sisselasketorud	9 Töötlusanum
	3 Ventilatsioonivoolikud	10 Töötlusventiilipaneel
	4 Peristaltilised pumbad tühjendamiseks ja proovi võtmiseks (valikuline: loputuspump)	11 Süstal (lahuse väljastusseade) (valikuline)
	5 Proovinõu kaas	12 Klapp (lahuse väljastusseade) (valikuline)
	6 Fotomeeter	13 Töötluise peristaltiline pump
	7 Fotomeetri kate	
FI	1 Mikropumput (0-5x)	8 Jännitteen säätö
	2 Sisäänmenoputki	9 Hajotusastia
	3 Ilmanpoistoletku	10 Hajotusventiilin paneeli
	4 Peristaltiset pumput tyhjennystä ja näyteenottoa varten (valinnainen: huuhtelupumppu)	11 Ruisku (annostelijan laimennus) (lisävaruste)
	5 Näyteastian kansi	12 Venttiili (annostelijan laimennus) (lisävaruste)
	6 Fotometriyksikkö	13 Hajotuksen peristaattinen pumppu
	7 Fotometrin kansi	
FR	1 Micropompes (0 à 5x)	8 Réglage de la tension
	2 Tuyau d'entrée	9 Cuve du digesteur
	3 Tuyau d'aération	10 Panneau de vannes du digesteur
	4 Pompes péristaltiques pour la vidange et l'échantillon (en option : pompe de rinçage)	11 Seringue (distributeur de dilution) (en option)
	5 Couverture de la cuve d'échantillon	12 Vanne (distributeur de dilution) (en option)
	6 Unité photométrique	13 Pompe péristaltique pour digesteur
	7 Couverture du photomètre	
HR	1 Mikropumpe (0 do 5x)	8 Podešavanje napona
	2 Ulazna cijev	9 Posuda uređaja za razgradnju
	3 Cijev za odzračivanje	10 Ploča ventila uređaja za razgradnju
	4 Peristaltičke pumpe za odvod i uzorak (opcionarno: pumpa za ispiranje)	11 Štrcaljka (dozator razrjeđivanja) (izborna)
	5 Poklopac posude za uzorak	12 Ventil (dozator razrjeđivanja) (izborna)
	6 Jedinica fotometra	13 Peristaltička pumpa uređaja za razgradnju
	7 Poklopac fotometra	
HU	1 Mikropumpák (0-5x)	8 Feszültség beállítása
	2 Bemeneti cső	9 Lebontótartály
	3 Szellőzőcső	10 Lebontószelep panele
	4 Perisztaltikus szivattyúk a leeresztéshez és a mintához (opcionális: öblítőszivattyú)	11 Fecskendő (hígítóadagoló) (opcionális)
	5 Mintatartály teteje	12 Szelep (hígítóadagoló) (opcionális)
	6 Fotométer egység	13 Lebontó perisztaltikus szivattyúja
	7 Fotométer fedele	

IT	1 Micropompe (da 0 a 5x)	8 Regolazione della tensione
	2 Tubo di ingresso	9 Contenitore del digestore
	3 Tubo di sfiato	10 Pannello per valvole del digestore
	4 Pompe peristaltiche per scarico e campione (opzionale: pompa di risciacquo)	11 Siringa (erogatore diluizione) (opzionale)
	5 Coperchio del contenitore del campione	12 Valvola (erogatore diluizione) (opzionale)
	6 Unità fotometro	13 Pompa peristaltica per digestore
	7 Coperchio del fotometro	
LT	1 Mikrosiurbliai (nuo 0 iki 5x)	8 Įtampos reguliavimas
	2 Įleidimo vamzdžiai	9 Skaidymo įrenginio talpykla
	3 Ventiliacinis vamzdelis	10 Skaidymo įrenginio vožtuvo pultas
	4 Peristaltiniai siurbliai išleidžiamajam vandeniui ir mėginiui (pasirinktinai: skalavimo siurblys)	11 Švirkštas (skiedimo dalytuvas) (pasirinktinai)
	5 Mėginio indo dangtis	12 Vožtuvas (skiedimo dalytuvas) (pasirinktinai)
	6 Fotometro blokas	13 Skaidymo renginio peristaltinis siurblys
	7 Fotometro dangtelis	
NL	1 Micropompen (0 tot 5x)	8 Spanningsaanpassing
	2 Inlaatleiding	9 Vergistervat
	3 Ontluchtingsslang	10 Vergisterventielenpaneel
	4 Slangenpompen voor afvoer en monster (optioneel: spoelpomp)	11 Spuit (verduunningsdispenser) (optioneel)
	5 Deksel monstervat	12 Klep (verduunningsdispenser) (optioneel)
	6 Fotometer	13 Peristaltische pomp voor vergister
	7 Afdekking fotometer	
PL	1 Mikropompy (od 0 do 5x)	8 Regulacja napięcia
	2 Przewód wlotowy	9 Naczynie fermentatora
	3 Przewód odpowietrzający	10 Panel zaworu fermentatora
	4 Pompy perystaltyczne do opróżniania i pobierania próbek (opcjonalnie: pompa płuczająca)	11 Strzykawka (dozownik do rozcieńczania) (opcjonalnie)
	5 Pokrywa naczynia na próbki	12 Zawór (dozownik do rozcieńczania, opcjonalnie)
	6 Moduł fotometru	13 Pompa perystaltyczna do fermentatora
	7 Pokrywa fotometru	
PT-PT	1 Microbombas (0 a 5x)	8 Ajuste da tensão
	2 Tubos de entrada	9 Recipiente do digestor
	3 Tubos de ventilação	10 Painel para válvulas do digestor
	4 Bombas peristálticas para drenagem e amostra (opcional: bomba de enxaguamento)	11 Seringa (dispensador de diluição) (opcional)
	5 Tampa do recipiente da amostra	12 Válvula (dispensador de diluição) (opcional)
	6 Unidade do fotómetro	13 Bomba peristáltica para o digestor
	7 Tampa do fotómetro	

RO	1 Micropompe (0 până la 5x)	8 Reglarea tensiunii
	2 Tubulatură de intrare	9 Vasul blocului de digestie
	3 Tubulatură de aerisire	10 Panoul de supape ale blocului de digestie
	4 Pompe peristaltice pentru drenaj și eșantion (opțional: pompă de clătire)	11 Seringă (dozator de diluție) (opțional)
	5 Capacul vasului cu proba	12 Supapă (dozator de diluție) (opțional)
	6 Unitate fotometru	13 Pompa peristaltică a blocului de digestie
	7 Capacul fotometrului	
RU	1 Микронасосы (от 0 до 5х)	8 Регулировка напряжения
	2 Входная трубка	9 Сосуд биореактора
	3 Вентиляционная трубка	10 Панель клапанов биореактора
	4 Перистальтические насосы для слива и отбора проб (дополнительно: промывочный насос)	11 Шприц (дозатор для разбавления) (дополнительно)
	5 Крышка сосуда для проб	12 Клапан (дозатор для разбавления) (дополнительно)
	6 Блок фотометра	13 Перистальтический насос для биореактора
	7 Крышка фотометра	
SK	1 Mikročerpadlá (0 až 5x)	8 Nastavenie napätia
	2 Vstupné potrubie	9 Nádoba mineralizátora
	3 Vetracie hadičky	10 Panel ventila mineralizátora
	4 Peristaltické čerpadlá na vypúšťanie a odber vzoriek (voliteľné: oplachovacie čerpadlo)	11 Striekačka (riedenie dávkovača) (voliteľné)
	5 Veko nádoby na vzorky	12 Ventil (riedenie dávkovača) (voliteľné)
	6 Jednotka fotometra	13 Peristaltické čerpadlo mineralizátora
	7 Kryt fotometra	
SL	1 Mikročrpalkе (0 do 5 x)	8 Prilagoditev napetosti
	2 Vstopna cev	9 Posodica digestorja
	3 Oddušna cev	10 Plošča ventila posode za razkroj
	4 Peristaltične črpalkе za izpust in vzorec (neobvezno: črpalkа za izpiranje)	11 Brizga (dozirnik za redčenje) (neobvezno)
	5 Pokrov posode za vzorec	12 Ventil (dozirnik za redčenje) (neobvezno)
	6 Enota fotometra	13 Peristaltična črpalkа za posodo za razkroj
	7 Pokrov fotometra	
SV-SE	1 Mikropumpar (0 till 5x)	8 Justering av spänning
	2 Inloppsslang	9 Nedbrytningskäril
	3 Ventilslang	10 Panel för nedbrytningsventil
	4 Peristaltiska pumpar för dränering och prov (tillval: skölj pump)	11 Spruta (spädningsdispenser) (valfritt)
	5 Lock till provkäril	12 Ventil (spädningsdispenser) (valfritt)
	6 Fotometerenhet	13 Peristaltisk pump för nedbrytning
	7 Fotometerhölje	

TR	1 Mikropompalar (0 ila 5x)	8 Gerilim ayarı
	2 Giriş hortumu	9 Sindirici kazanı
	3 Havalandırma hortumu	10 Sindirici valfi paneli
	4 Tahliye ve numune için peristaltik pompalar (isteğe bağlı: durulama pompası)	11 Şiringa (seyreltme dağıtıcı) (isteğe bağlı)
	5 Numune kabı kapağı	12 Valf (seyreltme dağıtıcı) (isteğe bağlı)
	6 Fotometre ünitesi	13 Sindirici için peristaltik pompa
	7 Fotometre kapağı	

3

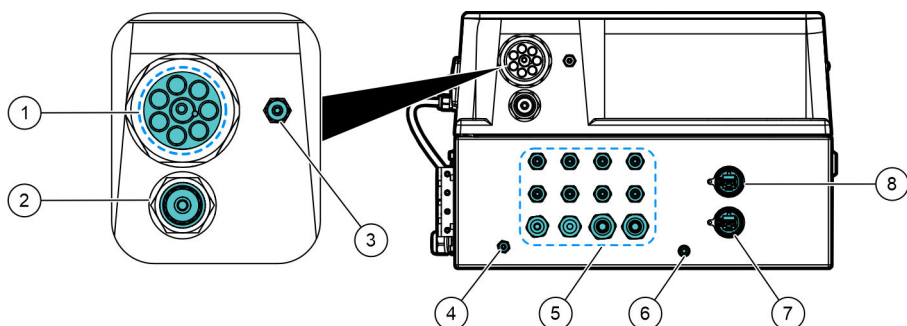

BG	1 Тръби за реактиви и тръба за отдушник	4 Фитинг за обезвъздушаване <sup>1</sup>	7 Ethernet конектор за Claros
	2 Фитинг за източване на корпуса ( <sup>3</sup> / <sub>8</sub> инча външ. диам.)	5 Кабелни салници (Фигура 8 на страница 457)	8 Modbus TCP/IP Ethernet конектор (или Profinet, или Ethernet IP)
	3 Дренажна тръба на съд за проба	6 Заземителна връзка	
CS	1 Reagenční hadičky a odvětrávací hadička	4 Armatura pro čištění vzduchem <sup>1</sup>	7 Ethernetový konektor systému Claros
	2 Armatura odtoku ze skříně (vnější průměr <sup>3</sup> / <sub>8</sub> palce)	5 Kabelové průchodky (Obr. 8 na straně 457)	8 Ethernetový konektor Modbus TCP/IP (nebo Profinet nebo Ethernet IP)
	3 Hadička odtoku nádoby na vzorky	6 Připojení uzemnění	
DA	1 Reagensslange og udluftningsslange	4 Fitting til luftrensning <sup>1</sup>	7 Claros Ethernet-stik
	2 Fitting til kabinetsdræn ( <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " udvendig diameter)	5 Kabelforskrninger (Figur 8 på side 457)	8 Modbus TCP/IP Ethernet-stik (eller Profinet eller Ethernet IP)
	3 Aftapningsslange til prøveholder	6 Jordforbindelse	

<sup>1</sup> Направете справка с онлайн версията на разширеното ръководство за потребителя за повече информация.

<sup>1</sup> Další informace a ilustrace naleznete online v rozšířeném návodu k použití.

<sup>1</sup> Du kan finde flere oplysninger i onlineversionen af den udvidede brugervejledning.

DE	1 Reagenzienschläuche und Entlüftungsschlauch	4 Luftspülungsanschluss <sup>1</sup>	7 Claros Ethernet-Anschluss
	2 Abflussanschluss des Gehäuses ( <sup>3</sup> / <sub>8</sub> Zoll AD)	5 Kabelverschraubungen (Abbildung 8 auf Seite 457)	8 Modbus TCP/IP Ethernet-Anschluss (oder Profinet oder Ethernet IP)
	3 Probengefäß-Ablaufschlauch	6 Erdungsanschluss	
EL	1 Σωλήνες αντιδραστηρίων και σωλήνας αερισμού	4 Σύνδεσμος για καθαρισμό με αέρα <sup>1</sup>	7 Σύνδεσμος Ethernet Claros
	2 Εξάρτημα αποστράγγισης περιβλήματος (εξωτερικής διαμέτρου <sup>3</sup> / <sub>8</sub> in)	5 Στυπιοθήλιπτες καλωδίων (Εικόνα 8 στη σελίδα 457)	8 Σύνδεσμος Modbus Ethernet TCP/IP (ή IP Profinet ή Ethernet)
	3 Σωλήνας αποστράγγισης δοχείου δείγματος	6 Σύνδεση γείωσης	
EN	1 Reagent tubes and vent tube	4 Air purge fitting <sup>1</sup>	7 Claros Ethernet connector
	2 Enclosure drain fitting ( <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -inch OD)	5 Cable glands (Figure 8 on page 457)	8 Modbus TCP/IP Ethernet connector (or Profinet or Ethernet IP)
	3 Sample vessel drain tube	6 Earth ground connection	
ES	1 Tubos de reactivo y tubo de ventilación	4 Conector para purga de aire <sup>1</sup>	7 Conector Ethernet Claros
	2 Conexión de drenaje de la carcasa ( <sup>3</sup> / <sub>8</sub> pulgadas de diámetro exterior)	5 Prensaestopas (Figura 8 en la página 457)	8 Conector Ethernet Modbus TCP/IP (o Profinet o Ethernet IP)
	3 Tubo de drenaje de vaso de muestra	6 Conexión a tierra	
ET	1 Reagendi torud ja ventilatsioonitoru	4 Suruõhuliitmik <sup>1</sup>	7 Clarose Ethernet-konnektor
	2 Korpuse tühendusliitmik (välisläbimõõt <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -tolli)	5 Kaabli läbiviitkühendid (Joonis 8 leheküljel 458)	8 Modbus TCP/IP Ethernet-konnektor (või Profinet või Ethernet IP)
	3 Proovindu tühendusvoolik	6 Maandusühendus	
FI	1 Reagenssiletkut ja ilmanpoistoletku	4 Ilmanpoistoliitin <sup>1</sup>	7 Ethernet-liitin, Claros
	2 Kotelon tyhjennysliitin ( <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -tuumainen ulkohalkaisija)	5 Kaapeliläpiviennit (Kuva 8 sivulla 458)	8 Modbus TCP/IP Ethernet -liitin (tai Profinet tai Ethernet IP)
	3 Näyteastian tyhjennysletku	6 Maaliitanta	
FR	1 Tuyaux de réactifs et tuyau d'aération	4 Raccord de la purge d'air <sup>1</sup>	7 Connecteur Ethernet Claros
	2 Raccord de vidange du boîtier ( <sup>3</sup> / <sub>8</sub> de pouce de diamètre extérieur)	5 Passe-câbles (Figure 8 à la page 458)	8 Connecteur Ethernet Modbus TCP/IP (ou Profinet ou IP Ethernet)
	3 Tuyau de vidange de la cuve d'échantillon	6 Prise de terre	

<sup>1</sup> Weitere Informationen finden Sie online in der erweiterten Version des Benutzerhandbuchs.

<sup>1</sup> Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική έκδοση του εκτεταμένου εγχειριδίου χρήστη.

<sup>1</sup> Refer to the expanded user manual version online for more information.

<sup>1</sup> Consulte la versión ampliada del manual del usuario disponible en línea para obtener más información.

<sup>1</sup> Lisateavet vaadake kasutusjuhendi laiendatud veebiversioonist.

<sup>1</sup> Katso lisätietoja laajennetun käyttöoppaan verkkoversiosta.

<sup>1</sup> Reportez-vous à la version détaillée du manuel d'utilisation en ligne pour en savoir plus.

HR	1 Cijevi za reagens i cijev za odzračivanje	4 Priključak za pročišćivač zraka <sup>1</sup>	7 Ethernet priključak za Claros
	2 Priključak za odvod iz kućišta ( <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -inčni OD)	5 Uvodnice kabela (Slika 8 na stranici 458)	8 Ethernet priključak za Modbus TCP/IP (ili Profinet ili Ethernet IP)
	3 Odvodna cijev posude za uzorak	6 Priključak za uzemljenje	
HU	1 Reagenscsövek és szellőzőcső	4 Tisztítólevegő szerelvénye <sup>1</sup>	7 Claros Ethernet-csatlakozó
	2 Ház ürítőszerelvénye ( <sup>3</sup> / <sub>8</sub> hüvelykes külső átmérő)	5 Tömszelencék (8. ábra oldalon 458)	8 Modbus TCP/IP Ethernet-csatlakozó (vagy Profinet vagy Ethernet IP)
	3 Mintatartály leeresztőcsöve	6 Földelés csatlakozása	
IT	1 Tubi dei reagenti e tubo di sfianto	4 Raccordo di scarico dell'aria <sup>1</sup>	7 Connettore Ethernet Claros
	2 Raccordo di scarico dell'alloggiamento (D.E. <sup>3</sup> / <sub>8</sub> pollici)	5 Pressacavi (Figura 8 a pagina 458)	8 Connettore Ethernet Modbus TCP/IP (o IP Ethernet o Profinet)
	3 Tubo di scarico del contenitore del campione	6 Collegamento per messa a terra	
LT	1 Reagentų vamzdeliai ir ventiliacinis vamzdelis	4 Oro prapūtimo jungiamasis elementas <sup>1</sup>	7 „Claros“ ethernet jungtis
	2 Ištuštinimo jungiamasis elementas ant gaubto ( <sup>3</sup> / <sub>8</sub> col. išor. skersmens)	5 Kabelių riebokšliai (Paveikslėlis 8 Puslapyje 458)	8 „Modbus TCP/IP“ ethernet jungtis (arba „Profinet“ ar „Ethernet IP“)
	3 Mėginio indo ištuštinimo vamzdelis	6 Įžeminimo jungtis	
NL	1 Reagensslangen en ontluchtingsslang	4 Fitting voor luchtzuivering <sup>1</sup>	7 Claros Ethernet-connector
	2 Afvoerfitting van de behuizing (buitendiameter van <sup>3</sup> / <sub>8</sub> inch)	5 Kabelwartels (Afbeelding 8 op pagina 458)	8 Modbus TCP/IP Ethernet-connector (of Profinet/Ethernet IP)
	3 Afvoerslang monstervat	6 Aardingsverbinding	
PL	1 Rurki odczynników i rurka odpowietrzająca	4 Łącznik do odpowietrzania <sup>1</sup>	7 Złącze Ethernet do Claros
	2 Złącze spustowe obudowy (średnica zewnętrzna <sup>3</sup> / <sub>8</sub> cala)	5 Dławiki kablowe (Rysunek 8 na stronie 458)	8 Złącze Modbus TCP/IP Ethernet (lub Profinet lub Ethernet IP)
	3 Przewód odpływowy naczynia na próbki	6 Przyłącze uziemienia	
PT-PT	1 Tubos de reagente e tubo de ventilação	4 Encaixe de purga de ar <sup>1</sup>	7 Conector Ethernet Claros
	2 Encaixe de drenagem da estrutura (DE de <sup>3</sup> / <sub>8</sub> polegadas)	5 Caixas de empanque (Figura 8 na página 458)	8 Conector Ethernet Modbus TCP/IP (ou Profinet ou Ethernet IP)
	3 Tubo de drenagem do recipiente da amostra	6 Ligação com proteção de terra	

<sup>1</sup> Verzija proširenog korisničkog priručnika na mreži navodi dodatne informacije.

<sup>1</sup> További információkért tekintse meg a bővített felhasználói kézikönyv online változatát.

<sup>1</sup> Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla versione online del manuale dell'utente completo.

<sup>1</sup> Daugiau informacijos žr. naudotojo vadovo išplėstinę versiją internete.

<sup>1</sup> Raadpleeg de uitgebreide online gebruikershandleiding voor meer informatie.

<sup>1</sup> Więcej informacji można znaleźć w rozszerzonej wersji instrukcji użytkownika online.

<sup>1</sup> Para obter mais informações, consulte a versão alargada do manual do utilizador online.

RO	1 Tuburi de reactiv și tub de ventilație	4 Racord purjare aer <sup>1</sup>	7 Conector Ethernet Claros
	2 Racord scurgere carcasă (D.E. 3/8 inch)	5 Protecții cabluri (Figura 8 de la pagina 458)	8 Conector Ethernet Modbus TCP/IP (sau Profinet sau Ethernet IP)
	3 Tubul de scurgere al vasului cu proba	6 Împământare	
RU	1 Трубки для реагентов и вентиляционная трубка	4 Фитинг для продувки воздухом <sup>1</sup>	7 Разъем Claros Ethernet
	2 Дренажный фитинг на корпусе (НД 3/8 дюйма)	5 Кабельные сальники (Рисунок 8 на стр. 458)	8 Разъем Modbus TCP/IP Ethernet (или Profinet, или Ethernet IP)
	3 Дренажная трубка сосуда для проб	6 Вывод для заземления	
SK	1 Hadičky na reagencie a vetracia hadička	4 Spojka na čistenie vzduchom <sup>1</sup>	7 Ethernetový konektor pre Claros
	2 Spojka odtoku zo skrine (vonkajší priemer 3/8 palca)	5 Káblové priechodky (Obrázok 8 na strane 459)	8 Ethernetový konektor pre Modbus TCP/IP (alebo Profinet, alebo Ethernet IP)
	3 Odtoková hadička nádoby na vzorky	6 Pripojenie uzemňovacích vodičov	
SL	1 Cevi za reagent in oddušna cevka	4 Priključek za čiščenje z zrakom <sup>1</sup>	7 Priključek za Ethernet za sistem Claros
	2 Spojka odtoka ohišja (3/8 palcev zun. premera)	5 Kableske uvodnice (Slika 8 na strani 459)	8 Priključek za Ethernet za Modbus TCP/IP (ali Profinet ali IP za Ethernet)
	3 Cev za odtok posode za vzorec	6 Ozemljitveni priključek	
SV-SE	1 Slangar för reagens och ventilerings	4 Luftspolningskoppling <sup>1</sup>	7 Claros Ethernet-anslutning
	2 Dräneringskoppling för höljet (YD 3/8 tum)	5 Packboxar (Figur 8 på sidan 459)	8 Modbus TCP/IP Ethernet-anslutning (eller Profinet, Ethernet IP)
	3 Dräneringsslang för provkäril	6 Jordanslutning	
TR	1 Reaktif hortumları ve havalandırma hortumu	4 Hava tahliyesi bağlantı parçası <sup>1</sup>	7 Claros Ethernet konnektörü
	2 Muhafaza tahliye bağlantı parçası (3/8 inç Dış Çap)	5 Kablo rakorları (Şekil 8 sayfa 459)	8 Modbus TCP/IP Ethernet konnektörü (veya Profinet veya Ethernet IP)
	3 Numune kabı tahliye hortumu	6 Topraklama bağlantısı	

<sup>1</sup> Consultați versiunea online a manualului extins de utilizare, pentru mai multe informații.


<sup>1</sup> Обратитесь к расширенной версии руководства пользователя в Интернете для получения дополнительной информации.

<sup>1</sup> Viac informácií nájdete v rozšírenej verzii používateľskej príručky online.

<sup>1</sup> Za več informacij in slik glejte razširjeni uporabniški priročnik na spletu.

<sup>1</sup> Se den utökade versionen av användarhandboken online för mer information.

<sup>1</sup> Daha fazla bilgi için çevrimiçi kapsamlı kullanım kılavuzuna bakın.

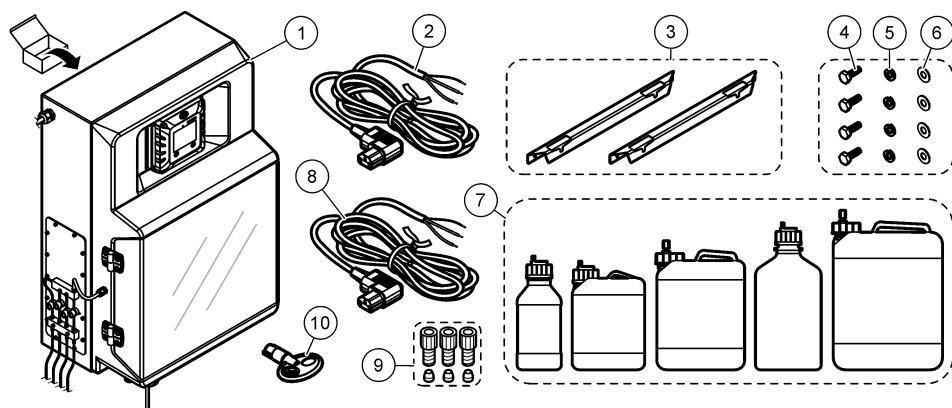

BG	1	Анализатор EZxxxxsc	5	Контрашайби, M8	9	Фитинги за тръбите и уплътнителни пръстени <sup>4</sup>
	2	Захранващ кабел (САЩ и Канада)	6	Плоски шайби, M8	10	Ключ на вратата
	3	Скоби за монтиране на стена	7	Бутилки с реактиви и разтвор <sup>3</sup>		
	4	Шестограмни болтове, M8 x 16	8	Захранващ кабел (EU)		
CS	1	Analyzátor EZxxxxsc	5	Pojistné podložky, M8	9	Hadicové tvarovky a objímky <sup>4</sup>
	2	Napájecí kabel (USA a Kanada)	6	Ploché podložky, M8	10	Klíč od dvířek
	3	Držáky pro montáž na zeď	7	Lahve na reagenty a roztoky <sup>3</sup>		
	4	Šestihřanné šrouby, M8 x 16	8	Napájecí kabel (EU)		
DA	1	EZxxxxsc-analysator	5	Låseskiver, M8	9	Slangefittings og ferruler <sup>4</sup>
	2	Netledning (USA og Canada)	6	Fladskiver, M8	10	Dørnøgle
	3	Vægmonteringsbeslag	7	Flasker med reagens og opløsningsmiddel <sup>3</sup>		
	4	Sekskantbolte, M8 x 16	8	Netledning (EU)		

<sup>3</sup> Количеството и типът на доставяните бутилки са различни за всеки модел анализатор.

<sup>4</sup> Количеството и типът на тръбните фитинги и крайници са различни за всеки модел анализатор.

<sup>3</sup> Množství a typ dodávaných lahví se pro každý model analyzátoru liší.

<sup>4</sup> Množství a typ hadičkových armatur a objímek se pro každý model analyzátoru liší.

<sup>3</sup> Antallet og typen af medfølgende flasker varierer for hver analysatormodel.

<sup>4</sup> Antallet og typen af slangefittings og klemringe varierer for hver analysatormodel.

DE	1 Analysator EZxxxxsc	5 Sicherungsscheiben, M8	9 Schlaucharmaturen und Klemmhülsen <sup>4</sup>
	2 Netzkabel (USA und Kanada)	6 Unterlegscheiben, M8	10 Türschlüssel
	3 Wandhalterungen	7 Flaschen für Reagenzien und Lösungen <sup>3</sup>	
	4 Sechskantschrauben, M8 x 16	8 Netzkabel (EU)	
EL	1 Αναλυτής EZxxxxsc	5 Ροδέλες ασφάλισης, M8	9 Δακτύλιοι και εξαρτήματα σωληνών <sup>4</sup>
	2 Καλώδιο τροφοδοσίας (ΗΠΑ και Καναδάς)	6 Επίπεδες ροδέλες, M8	10 Κλειδί θύρας
	3 Βραχίονες τοποθέτησης σε τοίχο	7 Φιάλες διαλυμάτων και αντιδραστηρίων <sup>3</sup>	
	4 Εξαγωνικά μπουλόνια, M8 x 16	8 Καλώδιο τροφοδοσίας (ΕΕ)	
EN	1 EZxxxxsc analyzer	5 Lock washers, M8	9 Tube fittings and ferrules <sup>4</sup>
	2 Power cord (USA and Canada)	6 Flat washers, M8	10 Door key
	3 Wall mounting brackets	7 Reagent and solution bottles <sup>3</sup>	
	4 Hex bolts, M8 x 16	8 Power cord (EU)	
ES	1 Analizador EZxxxxsc	5 Arandelas de bloqueo, M8	9 Racores y férulas para tubos <sup>4</sup>
	2 Cable de alimentación (EE.UU. y Canadá)	6 Arandelas planas, M8	10 Llave de la puerta
	3 Soportes para montaje en pared	7 Botellas de reactivos y soluciones <sup>3</sup>	
	4 Pernos de cabeza hexagonal, M8 x 16	8 Cable de alimentación (EU)	
ET	1 EZxxxxsc analüsaator	5 Lukustusseibid, M8	9 Voolikute liitmikud ja kaitserõngad <sup>4</sup>
	2 Toitejuhe (USA ja Kanada)	6 Lameseibid, M8	10 Luugi võti
	3 Seinakinnituskronsteinid	7 Reaktiivide ja lahuste pudelid <sup>3</sup>	
	4 Kuuskantpoldid, M8 x 16	8 Toitejuhe (EU)	

<sup>3</sup> Menge und Art der gelieferten Flaschen sind für jedes Analysatormodell unterschiedlich.

<sup>4</sup> Anzahl und Typ der Schlaucharmaturen und Klemmhülsen sind für jedes Analysatormodell unterschiedlich.

<sup>3</sup> Η ποσότητα και ο τύπος των φιαλών που παρέχονται διαφέρουν για κάθε μοντέλο αναλυτή.

<sup>4</sup> Η ποσότητα και ο τύπος των εξαρτημάτων σωληνών και των δακτυλίων διαφέρουν για κάθε μοντέλο αναλυτή.

<sup>3</sup> The quantity and type of bottles supplied are different for each analyzer model.

<sup>4</sup> The quantity and type of tube fittings and ferrules are different for each analyzer model.

<sup>3</sup> La cantidad y el tipo de botellas suministradas son diferentes para cada modelo de analizador.

<sup>4</sup> La cantidad y el tipo de conexiones y casquillos de tubo son diferentes para cada modelo de analizador.

<sup>3</sup> Analüsaatori mudelist sõltuvalt on komplektis eri arv ja eri liiki pudelid.

<sup>4</sup> Analüsaatori mudelist sõltuvalt on toruliitmike ja kaitserõngaste arv ja liik erinevad.

FI	1 EZxxxxsc-analysaattori	5 Lukkoaluslevyt, M8	9 Letkuliittimet ja holkit <sup>4</sup>
	2 Virtajohto (USA ja Kanada)	6 Litteät aluslevyt, M8	10 Luukun avain
	3 Seinäkiinnikkeet	7 Reagenssi- ja liuospullot <sup>3</sup>	
	4 Kuusioruuvit, M8 x 16	8 Virtajohto (EU)	
FR	1 Analyseur EZxxxxsc	5 Rondelles de blocage, M8	9 Raccords et bagues de tuyau <sup>4</sup>
	2 Cordon d'alimentation (USA et Canada)	6 Rondelles plates, M8	10 Clé de la porte
	3 Supports de montage mural	7 Flacons de réactif et de solution <sup>3</sup>	
	4 Boulons hexagonaux, M8 x 16	8 Cordon d'alimentation (UE)	
HR	1 Analizator EZxxxxsc	5 Zupčasti brtveni prsteni, M8	9 Priključci i metalni prsteni za cijevi <sup>4</sup>
	2 Kabel za napajanje (SAD i Kanada)	6 Plosnati brtveni prsteni, M8	10 Ključ za vrata
	3 Nosač za montiranje na zid	7 Boce s reagensom i otopinom <sup>3</sup>	
	4 Šesterokutni vijci, M8 x 16	8 Kabel za napajanje (EU)	
HU	1 EZxxxxsc analizátor	5 Záró alátétek, M8	9 Csőszerelvények és bilincsek <sup>4</sup>
	2 Tápkábel (USA és Kanada)	6 Lapos alátétek, M8	10 Ajtókulcs
	3 Fali rögzítőkonzolok	7 Reagens- és oldatpalackok <sup>3</sup>	
	4 Hatlapfejű csavarok, M8 x 16	8 Európai tápkábel	
IT	1 Analizzatore EZxxxxsc	5 Rondelle di bloccaggio, M8	9 Raccordi e ghiera per tubi <sup>4</sup>
	2 Cavo di alimentazione (USA e Canada)	6 Rondelle piatte, M8	10 Chiave dello sportello
	3 Staffa di montaggio a parete	7 Flaconi per reagenti e soluzioni <sup>3</sup>	
	4 Bulloni esagonali, M8 x 16	8 Cavo di alimentazione (UE)	

<sup>3</sup> Toimitukseen sisältyvien pullojen määrä ja tyyppi vaihtelee analysaattorimallin mukaan.

<sup>4</sup> Toimitukseen sisältyvien letkuliittimien ja holkkien määrä ja tyyppi vaihtelee analysaattorimallin mukaan.

<sup>3</sup> La quantité et le type de flacons fournis sont différents pour chaque modèle d'analyseur.

<sup>4</sup> La quantité et le type de raccords de tuyaux et de viroles sont différents pour chaque modèle d'analyseur.

<sup>3</sup> Količina i vrsta isporučenih boca razlikuje se za svaki model analizatora.

<sup>4</sup> Količina i vrsta isporučenih priključaka cijevi i metalnih prstena razlikuje se za svaki model analizatora.

<sup>3</sup> A biztosított palackok mennyisége és típusa az egyes analizátormodellek esetében eltérő.

<sup>4</sup> A biztosított csőszerelvények és bilincsek mennyisége és típusa az egyes analizátormodellek esetében eltérő.

<sup>3</sup> La quantità e il tipo di flaconi forniti sono diversi per ciascun modello di analizzatore.

<sup>4</sup> La quantità e il tipo di raccordi per tubi e ghiera sono diversi per ciascun modello di analizzatore.

LT	1 EZxxxxsc analizatorius	5 Fiksavimo poveržlės, M8	9 Vamzdžių jungiamieji elementai ir guminiai žiedai <sup>4</sup>
	2 Maitinimo laidas (JAV ir Kanadoje)	6 Plokščios poveržlės, M8	10 Durelių raktas
	3 Tvirtinimo prie sienos gembės	7 Reagentų ir tirpalų buteliai <sup>3</sup>	
	4 Šešiabriauniai varžtai, M8 x 16	8 Maitinimo laidas (ES)	
NL	1 EZxxxxsc-analyser	5 Borgringen, M8	9 Slangkoppelingen en knelringen <sup>4</sup>
	2 Netsnoer (VS en Canada)	6 Platte onderlegingen, M8	10 Deursleutel
	3 Wandmontagebeugels	7 Flessen voor reagens en oplossingen <sup>3</sup>	
	4 Zeskantbouten, M8 x 16	8 Stroomkabel (EU)	
PL	1 Analizator EZxxxxsc	5 Podkładki zabezpieczające, M8	9 Złączki i nasadki przewodów <sup>4</sup>
	2 Przewód zasilający (USA i Kanada)	6 Podkładki płaskie, M8	10 Klucz do drzwi
	3 Uchwyty do montażu na ścianie	7 Butelki na odczynniki i roztwory <sup>3</sup>	
	4 Śruby z łbem sześciokątnym, M8 x 16	8 Przewód zasilający (UE)	
PT-PT	1 Analizador EZxxxxsc	5 Arruelas de pressão, M8	9 Uniões para tubos e ferrulas <sup>4</sup>
	2 Cabo de alimentação (EUA e Canadá)	6 Arruelas chatas, M8	10 Chave da porta
	3 Suportes de montagem na parede	7 Frascos de reagente e solução <sup>3</sup>	
	4 Parafusos sextavados, M8 x 16	8 Cabo de alimentação (UE)	
RO	1 Analizor EZxxxxsc	5 Șaibe de blocare, M8	9 Garnituri și manșoane pentru tuburi <sup>4</sup>
	2 Cablu de alimentare (SUA și Canada)	6 Șaibe plate, M8	10 Cheie ușă
	3 Console de montare pe perete	7 Flacoane cu reactivi și soluții <sup>3</sup>	
	4 Șuruburi cu cap hexagonal, M8 x 16	8 Cablu electric (UE)	

<sup>3</sup> Kiekvienam analizatoriaus modeliui skirtų tiekiamų butelių kiekis ir tipas skiriasi.

<sup>4</sup> Kiekvienam analizatoriaus modeliui skirtų vamzdžių jungiamųjų elementų ir guminių žiedų kiekis ir tipas skiriasi.

<sup>3</sup> De hoeveelheid en het type geleverde flessen verschillen per analysermodel.

<sup>4</sup> De hoeveelheid en het type slangkoppelingen en knelringen verschillen per analysermodel.

<sup>3</sup> Liczba i typ dostarczanych butelek zależy od modelu analizatora.

<sup>4</sup> Liczba i typ dostarczanych złączy i nasadek zależy od modelu analizatora.

<sup>3</sup> A quantidade e o tipo de frascos fornecidos são diferentes para cada modelo de analisador.

<sup>4</sup> A quantidade e o tipo de encaixes para tubos e ferrulas são diferentes para cada modelo de analisador.

<sup>3</sup> Cantitatea și tipul de recipiente furnizate sunt diferite pentru fiecare model de analizor.

<sup>4</sup> Cantitatea și tipul de racorduri și inele de siguranță pentru tuburi sunt diferite pentru fiecare model de analizor.

RU	1	Анализатор EZxxxxsc	5	Стопорные шайбы, M8	9	Трубные фитинги и втулки <sup>4</sup>
	2	Шнур питания (США и Канада)	6	Плоские шайбы, M8	10	Ключ дверцы
	3	Кронштейны для монтажа на стену	7	Бутылки с реагентами и растворами <sup>3</sup>		
	4	Болт с шестигранной головкой, M8 x 16	8	Шнур питания (ЕС)		
SK	1	Analýzátor EZxxxxsc	5	Poistné podložky, M8	9	Upevnenie a ochranné krúžky hadičiek <sup>4</sup>
	2	Napájací kábel (USA a Kanada)	6	Ploché podložky, M8	10	Kľúč dverí
	3	Konzoly na upevnenie na stenu	7	Fľaše s reagentami a roztokmi <sup>3</sup>		
	4	Šesthranná skrutka, M8 x 16	8	Napájací kábel (EÚ)		
SL	1	Analizator EZxxxxsc	5	Blokirne podložke, M8	9	Nastavki in stisne puše za cevi <sup>4</sup>
	2	Napajalni kabel (ZDA in Kanada)	6	Ploščate podložke, M8	10	Ključ za vrata
	3	Nosilci za stensko montažo	7	Posode za reagente in raztopine <sup>3</sup>		
	4	Šestrobi vijaki, M8 x 16	8	Napajalni kabel (EU)		
SV-SE	1	EZxxxxsc-analysator	5	Låsbrickor, M8	9	Slangkopplingar och hylsor <sup>4</sup>
	2	Nätkabel (USA och Kanada)	6	Platta brickor, M8	10	Dörrnyckel
	3	Väggmonteringsfästen	7	Reagens- och lösningsflaskor <sup>3</sup>		
	4	Sexkantsbultar, M8 x 16	8	Strömkabel (EU)		
TR	1	EZxxxxsc analiz cihazı	5	Kilit pulları, M8	9	Boru bağlantıları ve demir halkalar <sup>4</sup>
	2	Güç kablosu (ABD ve Kanada)	6	Yassı pullar, M8	10	Kapı anahtarı
	3	Duvara montaj braketleri	7	Reaktif ve çözelti şişeleri <sup>3</sup>		
	4	Altıgen civatalar, M8 x 16	8	Güç kablosu (AB)		

<sup>3</sup> Количество и тип поставляемых бутылок различается в зависимости от модели анализатора.

<sup>4</sup> Количество и тип трубных фитингов и втулок различается в зависимости от модели анализатора.

<sup>3</sup> Množstvo a typ dodávaných fliaš sa líši pre každý model analyzátoru.

<sup>4</sup> Množstvo a typ tvaroviek a spojok hadičiek sa líši pre každý model analyzátoru.

<sup>3</sup> Količina in vrsta priloženih posod se razlikujejo pri posameznih modelih analizatorja.




<sup>4</sup> Količina in vrsta spojok za cevi in tulk se razlikujejo pri posameznih modelih analizatorja.


<sup>3</sup> Antal och typer av medföljande flaskor är olika för respektive analysatormodell.



<sup>4</sup> Antal och typer av slangkopplingar och hylsor är olika för respektive analysatormodell.

<sup>3</sup> Tedarik edilen şişelerin miktarı ve türü her analiz cihazı modeli için farklıdır.


<sup>4</sup> Hortum bağlantı parçaları ve demir halkaların miktarı ve türü her analiz cihazı modeli için farklıdır.

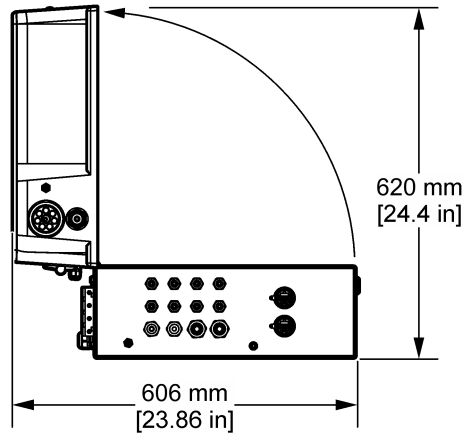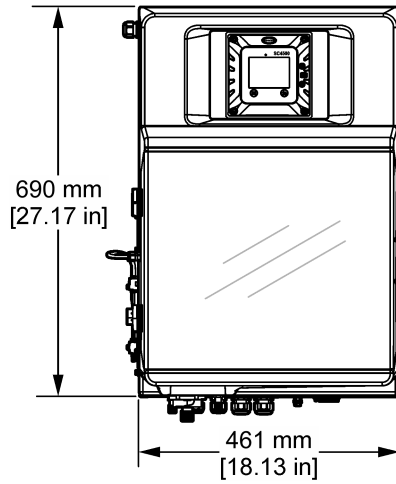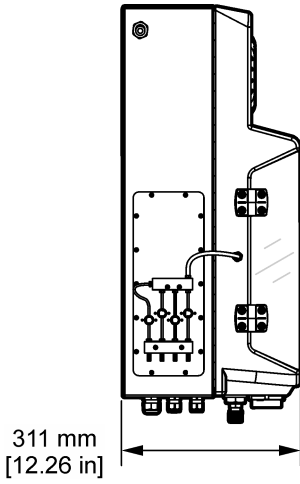


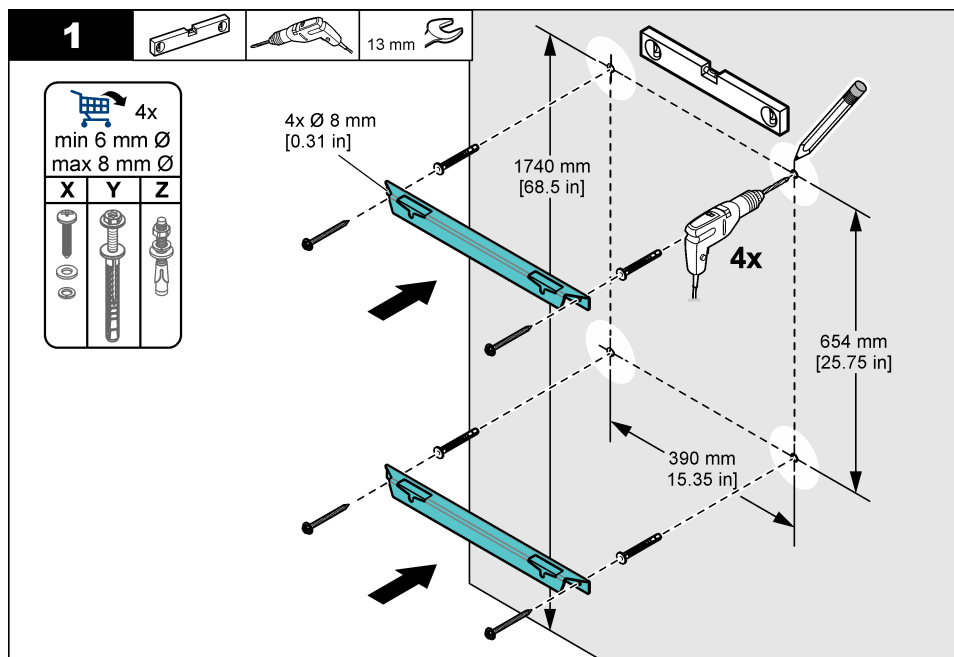

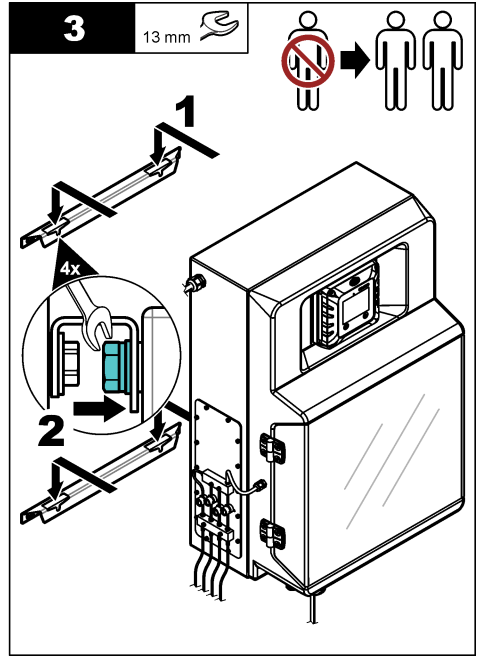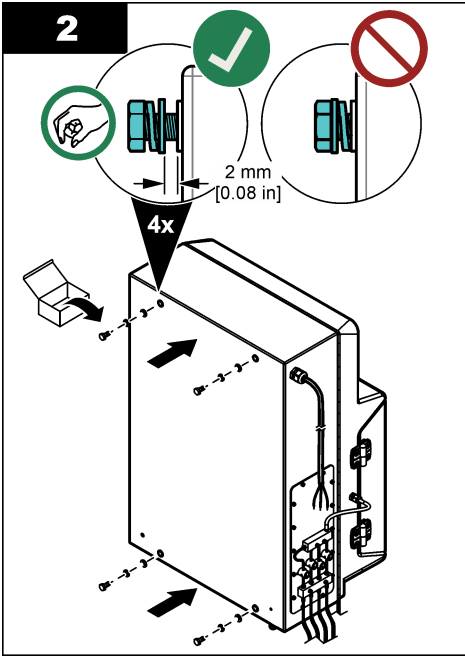

**7**

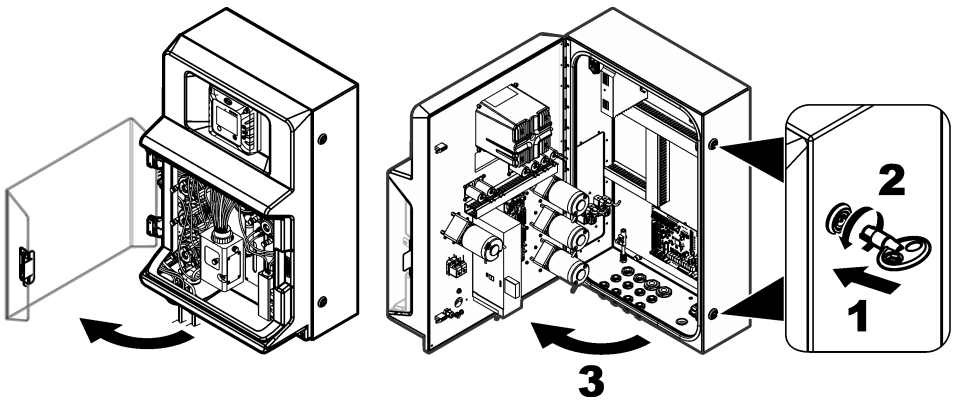


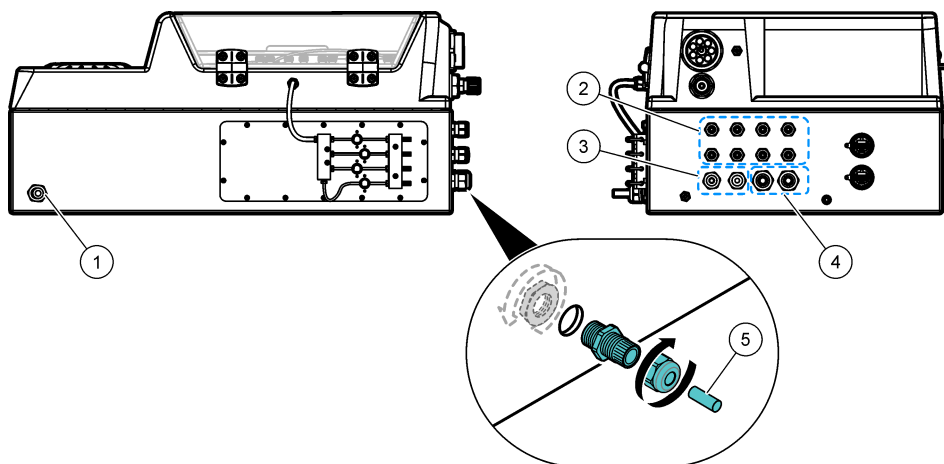

BG	1 Кабелен салник M20 за променливотоковия захранващ кабел	4 Кабелни салници M25
	2 Кабелни салници M20	5 Щепсел за кабелен салник
	3 Кабелни салници M16	
CS	1 Kablová průchodka M20 pro napájecí kabel střídavého proudu	4 Průchody pro kabel M25
	2 Průchody pro kabel M20	5 Zástrčka pro kabelovou průchodu
	3 Průchody pro kabel M16	
DA	1 M20-kabelforskruning til vekselstrømsledningen	4 M25-kabelforskruning
	2 M20-kabelforskruning	5 Prop til kabelforskruning
	3 M16-kabelforskruning	
DE	1 Kabelverschraubung M20 für das Netzkabel	4 Kabelverschraubungen M25
	2 Kabelverschraubungen M20	5 Stopfen für Kabelverschraubung
	3 Kabelverschraubungen M16	
EL	1 Στυπιοθλίπτης καλωδίου M20 για το καλώδιο τροφοδοσίας AC	4 Στυπιοθλίπτες καλωδίων M25
	2 Στυπιοθλίπτες καλωδίων M20	5 Τάπα για στυπιοθλίπτη καλωδίου
	3 Στυπιοθλίπτες καλωδίων M16	
EN	1 M20 cable gland for the AC power cord	4 M25 cable glands
	2 M20 cable glands	5 Plug for cable gland
	3 M16 cable glands	

ES	1 Prensaestopas de cable M20 para el cable de alimentación de CA	4 Prensaestopas de cable M25
	2 Prensaestopas de cable M20	5 Tapón para prensaestopas
	3 Prensaestopas de cable M16	
ET	1 M20 vahelduvvoolu-toitejuhtme läbiviikihend	4 M25 läbiviikihendid
	2 M20 läbiviikihendid	5 Kaabli läbiviikihendi otsik
	3 M16 läbiviikihendid	
FI	1 Verkkovirtajohdon M20-läpivientiholkki	4 M25-läpivientiholkit
	2 M20-läpivientiholkit	5 Läpivientiholkin tulppa
	3 M16-läpivientiholkit	
FR	1 Passe-câble M20 pour le cordon d'alimentation CA	4 Connexions M25
	2 Connexions M20	5 Prise pour passe-câble
	3 Connexions M16	
HR	1 Uvodnica M20 za kabel za napajanje izmjeničnom strujom	4 Uvodnice M25
	2 Uvodnice M20	5 Utikač za uvodnicu kabela
	3 Uvodnice M16	
HU	1 M20 tömszelence a váltóáramú tápkábel számára	4 M25 tömszelencék
	2 M20 tömszelencék	5 Dugó a tömszelencéhez
	3 M16 tömszelencék	
IT	1 Pressacavo M20 per cavo di alimentazione CA	4 Pressacavi M25
	2 Pressacavi M20	5 Spina per pressacavo
	3 Pressacavi M16	
LT	1 M20 kabelio riebokšlis, skirtas AC maitinimo laidui	4 M25 kabelių riebokšliai
	2 M20 kabelių riebokšliai	5 Kabelio riebokšlio kištukas
	3 M16 kabelių riebokšliai	
NL	1 M20-kabelwartel voor het netsnoer	4 M25-kabelwartels
	2 M20-kabelwartels	5 Plug voor kabelwartel
	3 M16-kabelwartels	
PL	1 Dławik kablowy M20 do przewodu zasilania prądem przemiennym	4 Dławiki kablowe M25
	2 Dławiki kablowe M20	5 Zaślepka dławika kablowego
	3 Dławiki kablowe M16	
PT-PT	1 Caixa de empanque para cabos M20 para o cabo de alimentação CA	4 Caixas de empanque para cabos M25
	2 Caixa de empanque para cabos M20	5 Ficha para caixa de empanque para cabos
	3 Caixas de empanque para cabos M16	
RO	1 Protecție cablu M20 pentru cablul de alimentare cu c.a.	4 Protecții cabluri M25
	2 Protecții cabluri M20	5 Dop pentru protecție de cablu
	3 Protecții cabluri M16	

<b>RU</b>	1 Кабельный сальник M20 для кабеля питания переменного тока	4 Кабельные сальники M25
	2 Кабельные сальники M20	5 Заглушка для кабельного сальника
	3 Кабельные сальники M16	
<b>SK</b>	1 Káblová priechodka M20 pre napájací kábel striedavého prúdu	4 Priechodka kábla M25
	2 Káblové priechodky M20	5 Kryt pre káblóvú priechodku
	3 Priechodka kábla M16	
<b>SL</b>	1 Kabelska uvodnica M20 za napajalni kabel AC	4 Kabelske uvodnice M25
	2 Kabelske uvodnice M20	5 Čep za kabelsko uvodnico
	3 Kabelske uvodnice M16	
<b>SV-SE</b>	1 M20-packbox för strömsladden	4 M25-packboxar
	2 M20-packboxar	5 Plugg till packbox
	3 M16-packboxar	
<b>TR</b>	1 AC güç kablosu için M20 kablo rakoru	4 M25 kablo rakorları
	2 M20 kablo rakorları	5 Kablo rakoru fişi
	3 M16 kablo rakorları	

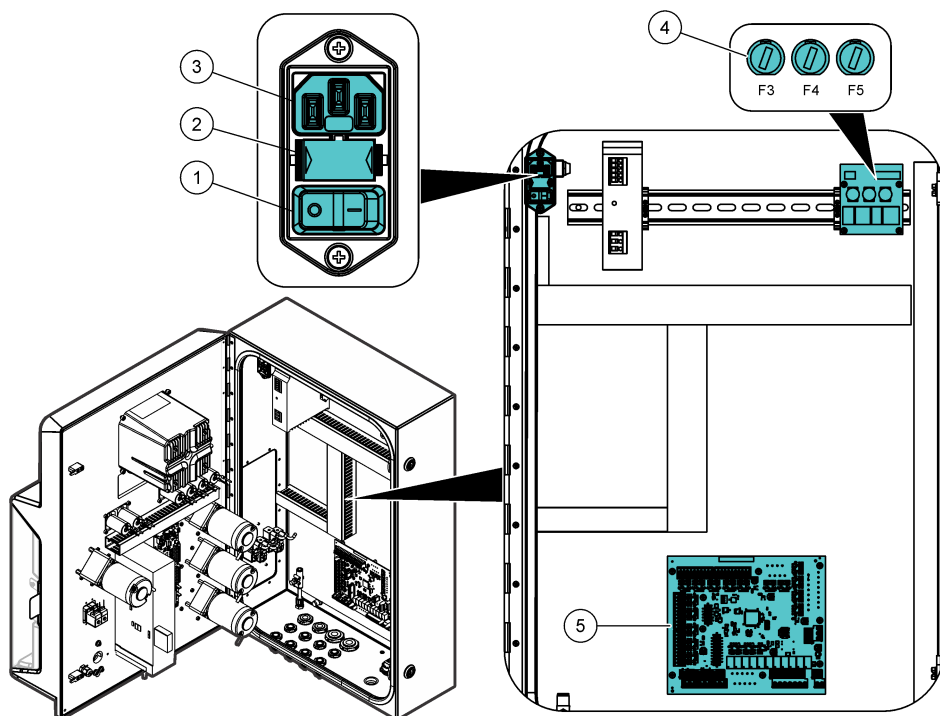


BG	1 Превключвател на захранването	3 Гнездо за захранващия кабел	5 Клеми за сигнал и управление (направете справка с <a href="#">Фигура 10</a> на страница 462)
	2 Предпазител за мрежовото захранване	4 Предпазители	
CS	1 Vypínač	3 Zásuvka pro napájecí šňůru	5 Signálové a řídicí svorky (viz <a href="#">Obr. 10</a> na straně 462)
	2 Pojistka pro hlavní napájení	4 Pojistky	
DA	1 Afbryder	3 Stikkontakt til netledningen	5 Signal- og styreklemmer (se <a href="#">Figur 10</a> på side 463)
	2 Sikring til primær strømkilde	4 Sikringer	
DE	1 Netzschalter	3 Anschluss für das Netzkabel	5 Signal- und Regelungsklemmen (siehe <a href="#">Abbildung 10</a> auf Seite 463)
	2 Sicherung für die Hauptstromversorgung	4 Sicherungen	
EL	1 Διακόπτης τροφοδοσίας	3 Υποδοχή για το καλώδιο τροφοδοσίας	5 Ακροδέκτες σήματος και ελέγχου (ανατρέξτε στην ενότητα <a href="#">Εικόνα 10</a> στη σελίδα 463)
	2 Ασφάλεια για την κεντρική τροφοδοσία	4 Ασφάλειες	

EN	1 Power switch	3 Receptacle for the power cord	5 Signal and control terminals (refer to <a href="#">Figure 10</a> on page 463)
	2 Fuse for the main power	4 Fuses	
ES	1 Interruptor de encendido	3 Receptáculo para el cable de alimentación	5 Terminales de señal y control (consulte <a href="#">Figura 10</a> en la página 463)
	2 Fusible para la alimentación principal	4 Fusibles	
ET	1 Toitelüliti	3 Toitejuhtme pistikupesa	5 Signaal- ja juhtklemmid (vt <a href="#">Joonis 10</a> leheküljel 464)
	2 Peatoitekaitse	4 Kaitsmed	
FI	1 Virtakytkin	3 Virtajohdon liitântä	5 Signaali- ja ohjausliitännät (katso <a href="#">Kuva 10</a> sivulla 464)
	2 Päävirtasulake	4 Sulakkeet	
FR	1 Interrupteur marche/arrêt	3 Prise pour le cordon d'alimentation	5 Terminaux de signal et de contrôle (référez-vous à la section <a href="#">Figure 10</a> à la page 464)
	2 Fusible pour l'alimentation principale	4 Fusibles	
HR	1 Prekidač napajanja	3 Utičnica za kabel za napajanje	5 Signalni i upravljački terminali (pogledajte <a href="#">Slika 10</a> na stranici 464)
	2 Osigurač za napajanje	4 Osigurači	
HU	1 Főkapcsoló	3 A tápvezeték aljzata	5 Jel- és vezérlőcsatlakozók (lásd: <a href="#">10. ábra</a> oldalon 464)
	2 A fő tápellátás biztosító	4 Biztosítékok	
IT	1 Interruttore di alimentazione	3 Presa per il cavo di alimentazione	5 Terminali di comando e di segnale (consultare la <a href="#">Figura 10</a> a pagina 465)
	2 Fusibile per l'alimentazione principale	4 Fusibili	
LT	1 Maitinimo jungiklis	3 Maitinimo laido šakutės lizdas	5 Signalų ir valdymo gnybtai (žr. <a href="#">Paveikslėlis 10</a> Puslapyje 465)
	2 Tinklo maitinimo saugiklis	4 Saugikliai	
NL	1 Aan/uit-schakelaar	3 Aansluiting voor het netsnoer	5 Signaal- en besturingsklemmen (zie <a href="#">Afbeelding 10</a> op pagina 465)
	2 Zekering voor de hoofdvoeding	4 Zekeringen	
PL	1 Włacznik zasilania	3 Gniazdu przewodu zasilania	5 Przyłącza sygnałowe i sterujące (patrz <a href="#">Rysunek 10</a> na stronie 465)
	2 Bezpiecznik zasilania sieciowego	4 Bezpieczniki	
PT-PT	1 Botão de alimentação	3 Tomada para o cabo de alimentação	5 Terminais de sinal e controlo (consulte s <a href="#">Figura 10</a> na página 465)
	2 Fusível para a alimentação principal	4 Fusíveis	
RO	1 Înterupător	3 Priză pentru cablul de alimentare	5 Borne de semnal și control (consultați <a href="#">Figura 10</a> de la pagina 466)
	2 Siguranță pentru sursa de alimentare principală	4 Siguranțe	
RU	1 Переключатель питания	3 Розетка для кабеля питания	5 Сигнальные и управляющие клеммы (см. <a href="#">Рисунок 10</a> на стр. 466)
	2 Предохранитель основного питания	4 Предохранители	
SK	1 Hlavný vypínač	3 Objímka pre napájací kábel	5 Signálne a ovládacie svorky (pozri <a href="#">Obrázok 10</a> na strane 466)
	2 Poistka hlavného napájania	4 Poistky	
SL	1 Stikalo za vklop/izklop	3 Vtičnica za napajalni kabel	5 Signalni in krmilni priključki (glejte <a href="#">Slika 10</a> na strani 466)
	2 Varovalka za glavno napajanje	4 Varovalke	

<b>SV-SE</b>	1 Strömbrytare	3 Uttag för nätsladden	5 Signal- och styruttag (se <a href="#">Figur 10</a> på sidan 466)
	2 Säkring för huvudströmmen	4 Säkringar	
<b>TR</b>	1 Güç düğmesi	3 Güç kablosu yuvası	5 Sinyal ve kontrol terminalleri (bkz. <a href="#">Şekil 10</a> sayfa 467)
	2 Ana güç sigortası	4 Sigortalar	

10

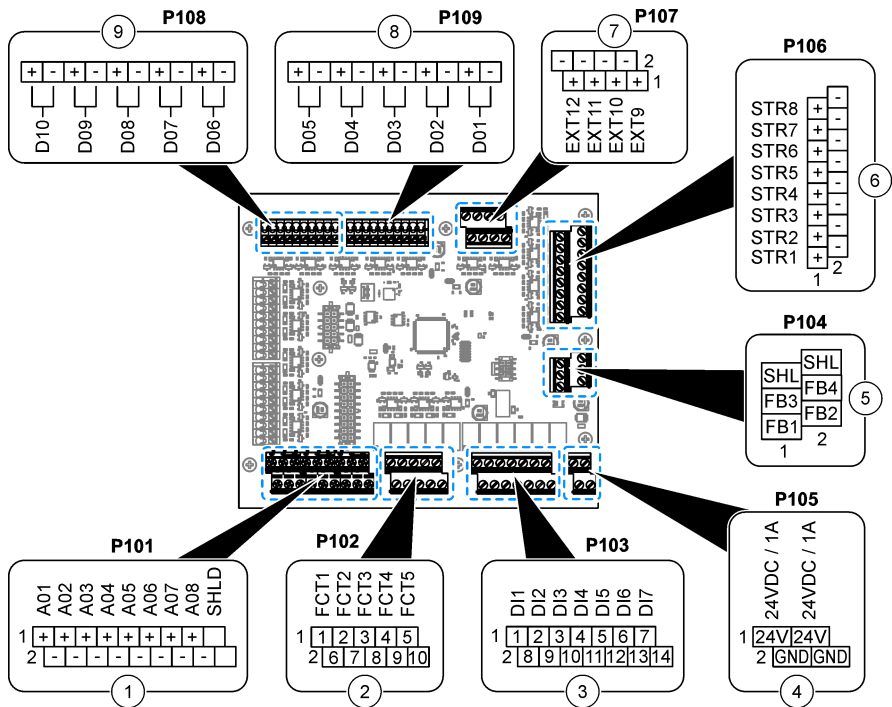

<b>BG</b>	1 Аналогови изходи (AO)	6 Конектори на панел Moduplex, дигитални изходи (STR)
	2 Релета за аларми (FCT)	7 Конектори на панел EZ9150, дигитални изходи (EXT)
	3 Цифрови входове, 24 VDC (DI)	8 Конектори на панел EZ9150, дигитални изходи (DO)
	4 Захранване за модулите за филтрация EZ9010 и EZ9020, 24 VDC/1A	9 Конектори на панел EZ9150, дигитални изходи (DO)
	5 Profibus DP или Modbus RTU (RS485) (FB, P104)	

<b>CS</b>	1 Analogové výstupy (AO)	6 Konektory panelu Moduplex, digitální výstupy (STR)
	2 Relé pro alarmy (FCT)	7 Konektory panelu EZ9150, digitální výstupy (EXT)
	3 Digitální vstupy, 24 VDC (DI)	8 Konektory panelu EZ9150, digitální výstupy (DO)
	4 Napájení pro filtrační jednotky EZ9010 a EZ9020, 24 V DC / 1 A	9 Konektory panelu EZ9150, digitální výstupy (DO)
	5 Profibus DP nebo Modbus RTU (RS485) (FB, P104)	
<b>DA</b>	1 Analoge udgange (AO)	6 Moduplex-panelstik, digitale udgange (STR)
	2 Relæer til alarmer (FCT)	7 EZ9150-panelstik, digitale udgange (EXT)
	3 Digitale indgange, 24 V DC (DI)	8 EZ9150-panelets stikforbindelser, digitale udgange (DO)
	4 Strømforsyning til filtreringsenhederne EZ9010 og EZ9020, 24 V DC / 1 A	9 EZ9150-panelets stikforbindelser, digitale udgange (DO)
	5 Profibus DP eller Modbus RTU (RS485) (FB, P104)	
<b>DE</b>	1 Analogausgänge (AO)	6 Moduplex Modulanschlüsse, Digitalausgänge (STR)
	2 Relais für Alarme (FCT)	7 EZ9150 Modulanschlüsse, Digitalausgänge (EXT)
	3 Digitaleingänge, 24 VDC (DI)	8 EZ9150 Modulanschlüsse, Digitalausgänge (DO)
	4 Stromversorgung für EZ9010 und EZ9020 Filtrationsmodule, 24 VDC / 1 A	9 EZ9150 Modulanschlüsse, Digitalausgänge (DO)
	5 Profibus DP oder Modbus RTU (RS485) (FB, P104)	
<b>EL</b>	1 Αναλογικές έξοδοι (AO)	6 Σύνδεσμοι πίνακα Moduplex, ψηφιακές έξοδοι (STR)
	2 Ρελέ για συναγερμούς (FCT)	7 Σύνδεσμοι πίνακα EZ9150, ψηφιακές έξοδοι (EXT)
	3 Ψηφιακές είσοδοι, 24 VDC (DI)	8 Σύνδεσμοι πίνακα EZ9150, ψηφιακές έξοδοι (DO)
	4 Τροφοδοσία ρεύματος για μονάδες διήθησης EZ9010 και EZ9020, 24 VDC / 1A	9 Σύνδεσμοι πίνακα EZ9150, ψηφιακές έξοδοι (DO)
	5 Profibus DP ή Modbus RTU (RS485) (FB, P104)	
<b>EN</b>	1 Analog outputs (AO)	6 Moduplex panel connectors, digital outputs (STR)
	2 Relays for alarms (FCT)	7 EZ9150 panel connectors, digital outputs (EXT)
	3 Digital inputs, 24 VDC (DI)	8 EZ9150 panel connectors, digital outputs (DO)
	4 Power supply for EZ9010 and EZ9020 filtration units, 24 VDC / 1A	9 EZ9150 panel connectors, digital outputs (DO)
	5 Profibus DP or Modbus RTU (RS485) (FB, P104)	



<b>ES</b>	1 Salidas analógicas (AO)	6 Conectores para panel Moduplex, salidas digitales (STR)
	2 Relés para alarmas (FCT)	7 Conectores para panel EZ9150, salidas digitales (EXT)
	3 Entradas digitales, 24 V CC (DI)	8 Conectores para panel EZ9150, salidas digitales (DO)
	4 Fuente de alimentación para las unidades de filtración EZ9010 y EZ9020, 24 V CC/1 A	9 Conectores para panel EZ9150, salidas digitales (DO)
	5 Profibus DP o Modbus RTU (RS485) (FB, P104)	
<b>ET</b>	1 Analogväljundid (AO)	6 Moduplex-paneelide konnektorid, digitaalväljundid (STR)
	2 Alarmseadmete releed (FCT)	7 EZ9150 paneeli konnektorid, digitaalväljundid (EXT)
	3 Digitaalsisendid, 24 volti alalisvoolu (DI)	8 EZ9150 paneeli konnektorid, digitaalväljundid (DO)
	4 Filtreerimiseadme EZ9010 ja EZ9020 toide, 24 volti alalisvoolu / 1 A	9 EZ9150 paneeli konnektorid, digitaalväljundid (DO)
	5 Profibus DP või Modbus RTU (RS485) (FB, P104)	
<b>FI</b>	1 Analogiset lähdöt (AO)	6 Moduplex-paneeliliittimet, digitaaliset lähdöt (STR)
	2 Hälytysreleed (FCT)	7 EZ9150-paneeliliittimet, digitaaliset lähdöt (EXT)
	3 Digitaaliset tulot, 24 VDC (DI)	8 EZ9150-paneeliliittimet, digitaaliset lähdöt (DO)
	4 EZ9010- ja EZ9020-suodatinyksikköjen virtalähde, 24 VDC / 1 A	9 EZ9150-paneeliliittimet, digitaaliset lähdöt (DO)
	5 Profibus DP tai Modbus RTU (RS485) (FB, P104)	
<b>FR</b>	1 Sorties analogiques (AO)	6 Connecteurs de panneau moduplex, sorties numériques (STR)
	2 Relais pour alarmes (FCT)	7 Connecteurs de panneau EZ9150, sorties numériques (EXT)
	3 Entrées numériques, 24 VCC (DI)	8 Connecteurs de panneau EZ9150, sorties numériques (DO)
	4 Alimentation pour les unités de filtration EZ9010 et EZ9020, 24 VCC / 1A	9 Connecteurs de panneau EZ9150, sorties numériques (DO)
	5 Profibus DP ou Modbus RTU (RS485) (FB, P104)	
<b>HR</b>	1 Analogni izlazi (AO)	6 Priključci ploče Moduplex, digitalni izlazi (STR)
	2 Releji za alarme (FCT)	7 Priključci ploče EZ9150, digitalni izlazi (EXT)
	3 Digitalni ulazi, 24 VDC (DI)	8 Priključci ploče EZ9150, digitalni izlazi (DO)
	4 Napajanje za jedinice za filtraciju EZ9010 i EZ9020, 24 VDC / 1A	9 Priključci ploče EZ9150, digitalni izlazi (DO)
	5 Profibus DP ili Modbus RTU (RS485) (FB, P104)	

<b>HU</b>	1 Analóg kimenetek (AO)	6 Mod duplex panelcsatlakozók, digitális kimenetek (STR)
	2 Riasztási relék (FCT)	7 EZ9150 panelcsatlakozók, digitális kimenetek (EXT)
	3 Digitális bemenetek, 24 V DC (DI)	8 EZ9150 panelcsatlakozók, digitális kimenetek (DO)
	4 Tápellátás az EZ9010 és EZ9020 szűrőegységekhez, 24 V DC / 1 A	9 EZ9150 panelcsatlakozók, digitális kimenetek (DO)
	5 Profibus DP vagy Modbus RTU (RS485) (FB, P104)	
<b>IT</b>	1 Uscite analogiche (AO)	6 Connettori per pannello Mod duplex, uscite digitali (STR)
	2 Relè per allarmi (FCT)	7 Connettori per pannello EZ9150, uscite digitali (EXT)
	3 Ingressi digitali, 24 V CC (DI)	8 Connettori per pannello EZ9150, uscite digitali (DO)
	4 Alimentatore per unità di filtrazione EZ9010 e EZ9020, 24 V CC/1 A	9 Connettori per pannello EZ9150, uscite digitali (DO)
	5 Profibus DP o Modbus RTU (RS485) (FB, P104)	
<b>LT</b>	1 Analoginiai išėjimai (AO)	6 „Mod duplex“ pulto jungtys, skaitmeniniai išėjimai (STR)
	2 Pavojaus signalų relės (FCT)	7 EZ9150 pulto jungtys, skaitmeniniai išėjimai (EXT)
	3 Skaitmeniniai įėjimai, 24 VDC (DI)	8 EZ9150 pulto jungtys, skaitmeniniai išėjimai (DO)
	4 EZ9010 ir EZ9020 filtravimo blokų maitinimo šaltinis, 24 VDC / 1A	9 EZ9150 pulto jungtys, skaitmeniniai išėjimai (DO)
	5 „Profibus DP“ arba „Modbus RTU“ (RS485) (FB, P104)	
<b>NL</b>	1 Analoge uitgangen (AO)	6 Mod duplex paneelconnectoren, digitale uitgangen (STR)
	2 Relais voor alarmen (FCT)	7 EZ9150 paneelconnectoren, digitale uitgangen (EXT)
	3 Digitale ingangen, 24 VDC (DI)	8 EZ9150-paneelconnectoren, digitale uitgangen (DO)
	4 Voeding voor EZ9010- en EZ9020-filtreeenheden, 24 VDC / 1A	9 EZ9150-paneelconnectoren, digitale uitgangen (DO)
	5 Profibus DP of Modbus RTU (RS485) (FB, P104)	
<b>PL</b>	1 Wyjścia analogowe (AO)	6 Złącza panelu Mod duplex, wyjścia cyfrowe (STR)
	2 Przekładniki alarmów (FCT)	7 Złącza panelu EZ9150, wyjścia cyfrowe (EXT)
	3 Wejścia cyfrowe, 24 VDC (DI)	8 Złącza panelu EZ9150, wyjścia cyfrowe (DO)
	4 Zasilanie modułów filtracyjnych EZ9010 i EZ9020, 24 VDC / 1A	9 Złącza panelu EZ9150, wyjścia cyfrowe (DO)
	5 Profibus DP lub Modbus RTU (RS485) (FB, P104)	


PT-PT	1 Saídas analógicas (AO)	6 Conectores do painel Moduplex, saídas digitais (STR)
	2 Relés para alarmes (FCT)	7 Conectores do painel EZ9150, saídas digitais (EXT)
	3 Entradas digitais, 24 V CC (DI)	8 Conectores do painel EZ9150, saídas digitais (DO)
	4 Fonte de alimentação para as unidades de filtragem EZ9010 e EZ9020, 24 V CC/1 A	9 Conectores do painel EZ9150, saídas digitais (DO)
	5 Profibus DP ou Modbus RTU (RS485) (FB, P104)	
RO	1 Ieșiri analogice (AO)	6 Conectori panou Moduplex, ieșiri digitale (STR)
	2 Relee pentru alarme (FCT)	7 Conectori panou EZ9150, ieșiri digitale (EXT)
	3 Intrări digitale, 24 V c.c. (DI)	8 Conectori pentru panoul EZ9150, ieșiri digitale (ID)
	4 Alimentare pentru unitățile de filtrare EZ9010 și EZ9020, 24 V c.c./1 A	9 Conectori pentru panoul EZ9150, ieșiri digitale (ID)
	5 Profibus DP sau Modbus RTU (RS485) (FB, P104)	
RU	1 Аналоговые выходы (AO)	6 Разъемы панели Moduplex, цифровые выходы (STR)
	2 Реле сигнализации (FCT)	7 Разъемы панели EZ9150, цифровые выходы (EXT)
	3 Цифровые входы, 24 А пост. тока (DI)	8 Разъемы панели EZ9150, цифровые выходы (DO)
	4 Источник питания для блоков фильтрации EZ9010 и EZ9020, 24 В пост. тока / 1 А	9 Разъемы панели EZ9150, цифровые выходы (DO)
	5 Profibus DP или Modbus RTU (RS485) (FB, P104)	
SK	1 Analógové výstupy (AO)	6 Konektory panela Moduplex, digitálne výstupy (STR)
	2 Relé pre alarmy (FCT)	7 Konektory panela EZ9150, digitálne výstupy (EXT)
	3 Digitálne vstupy, 24 V DC (DI)	8 Konektory panela EZ9150, digitálne výstupy (DO)
	4 Napájanie pre filtračné jednotky EZ9010 a EZ9020, 24 V DC/1 A	9 Konektory panela EZ9150, digitálne výstupy (DO)
	5 Profibus DP alebo Modbus RTU (RS485) (FB, P104)	
SL	1 Analogni izhodi (AO)	6 Konektorji panela Moduplex, digitalni izhodi (STR)
	2 Releji za alarme (FCT)	7 Konektorji panela EZ9150, digitalni izhodi (EXT)
	3 Digitalni vhodi, 24 V DC (DI)	8 Konektorji panela EZ9150, digitalni izhodi (DO)
	4 Napajanje za filtrirni enoti EZ9010 in EZ9020, 24 V DC/1 A	9 Konektorji panela EZ9150, digitalni izhodi (DO)
	5 Profibus DP ali Modbus RTU (RS485) (FB, P104)	

<b>SV-SE</b>	1 Analoga utgångar (AO)	6 Moduplex-panelkontakter, digitala utgångar (STR)
	2 Reläer för larm (FCT)	7 EZ9150-panelkontakter, digitala utgångar (EXT)
	3 Digitala ingångar, 24 VDC (DI)	8 EZ9150-panelkontakter, digitala utgångar (DO)
	4 Strömförsörjning för filtreringsenheterna EZ9010 och EZ9020, 24 VDC/1 A	9 EZ9150-panelkontakter, digitala utgångar (DO)
	5 Profibus DP eller Modbus RTU (RS485) (FB, P104)	
<b>TR</b>	1 Analog çıkışlar (AO)	6 Moduplex panel konektörleri, dijital çıkışlar (STR)
	2 Alarm röleleri (FCT)	7 EZ9150 panel konektörleri, dijital çıkışlar (EXT)
	3 Dijital girişler, 24 VDC (DI)	8 EZ9150 panel konektörleri, dijital çıkışlar (DO)
	4 EZ9010 ve EZ9020 filtrasyon üniteleri için güç kaynağı, 24 VDC/1 A	9 EZ9150 panel konektörleri, dijital çıkışlar (DO)
	5 Profibus DP veya Modbus RTU (RS485) (FB, P104)	


11

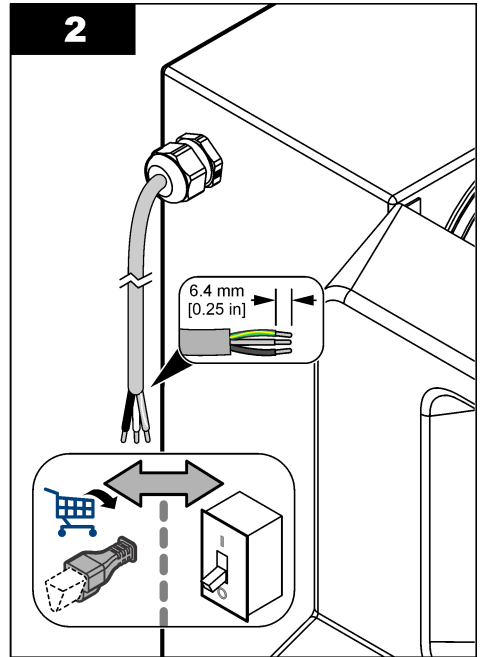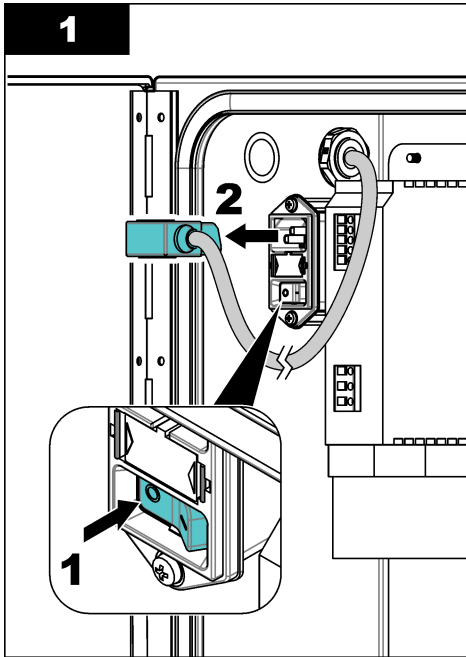


3

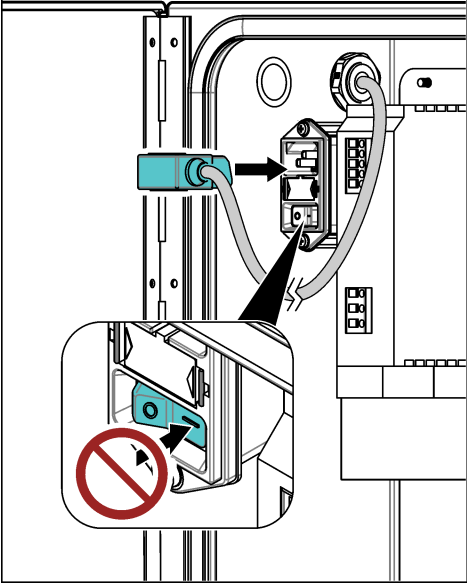

4

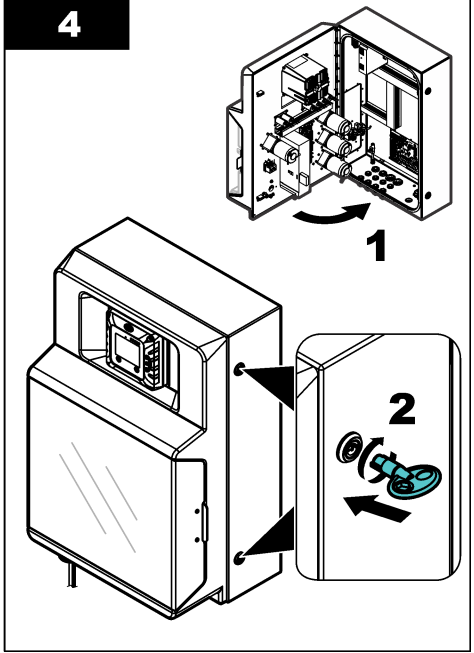

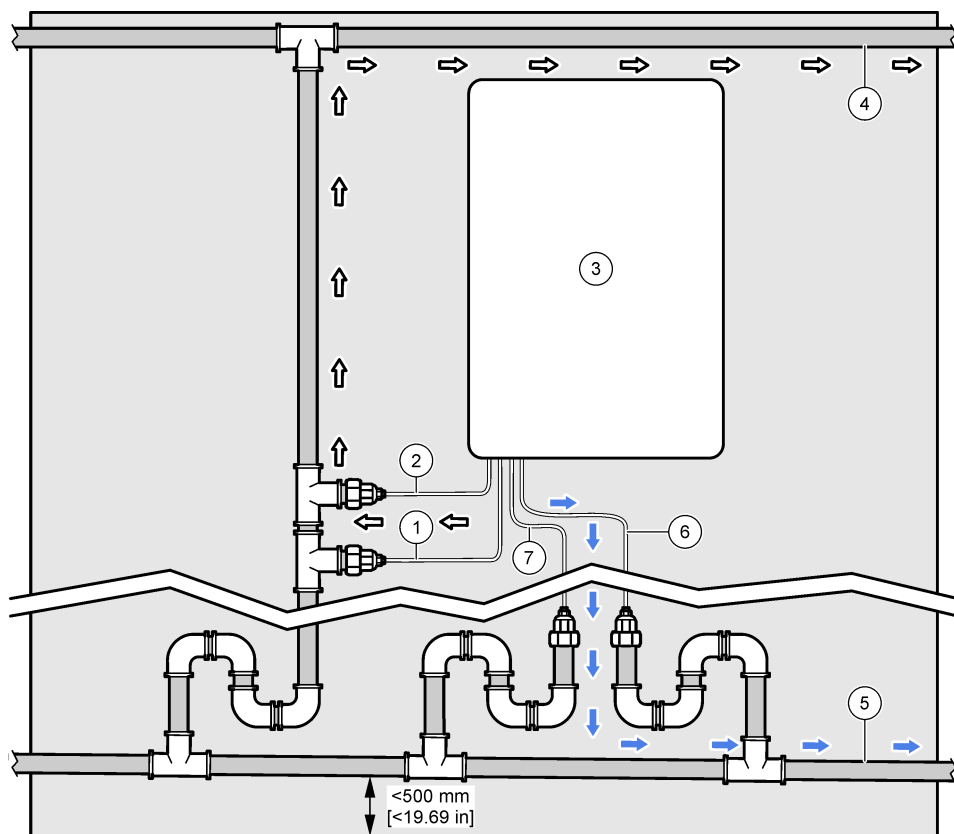


BG	1	Тръби за отдушник	5	Изход за източване към външно местоположение
	2	Тръба за отдушник на устройство за усвояване	6	Тръба за източване на корпус
	3	Анализатор	7	Дренажни тръби
	4	Вентилационен изход към външно местоположение		
CS	1	Odvětrávací hadička	5	Vypouštěcí výstup do externího místa
	2	Odvětrávací hadička digestoře	6	Vypouštěcí hadička skříně
	3	Analýzátor	7	Vypouštěcí hadička
	4	Odvětrávací výstup do externího místa		


DA	1 Udluftningslange	5 Aftap udløbet til omgivelserne
	2 Ventilslange til rådnetank	6 Kabinetsaftapningslange
	3 Analysator	7 Drænslange
	4 Udluft udløbet til omgivelserne	
DE	1 Entlüftungsschlauch	5 Ablaufauslass an externen Ort
	2 Entlüftungsschlauch des Aufschlussgefäßes	6 Ablaufschlauch des Gehäuses
	3 Analysator	7 Ablaufschlauch
	4 Entlüftungsauslass an externen Ort	
EL	1 Σωλήνωση αερισμού	5 Έξοδος αποστράγγισης σε εξωτερική θέση
	2 Σωλήνωση αερισμού συσκευής χώνευσης	6 Σωλήνας αποστράγγισης περιβλήματος
	3 Αναλυτής	7 Σωλήνωση αποστράγγισης
	4 Έξοδος αερισμού σε εξωτερική θέση	
EN	1 Vent tubing	5 Drain outlet to an external location
	2 Digester vent tubing	6 Enclosure drain tubing
	3 Analyzer	7 Drain tubing
	4 Vent outlet to an external location	
ES	1 Tubo de ventilación	5 Salida de drenaje a una ubicación externa
	2 Tubo de ventilación del digestor	6 Tubo de drenaje de la carcasa
	3 Analizador	7 Tubo de drenaje
	4 Salida de ventilación a una ubicación externa	
ET	1 Ventilatsioonivoolikud	5 Äravoolu väljund välisesse asukohta
	2 Töötlusventilaatori voolikud	6 Korpuse äravooluvoolikud
	3 Analüsaator	7 Äravooluvoolikud
	4 Ventilatsiooni väljund välisesse asukohta	
FI	1 Ilmanpoistoletku	5 Tyhjennyksen lähtöliitäntä ulos
	2 Hajotuksen ilmanpoistoletku	6 Kotelon tyhjennysletku
	3 Analysaattori	7 Tyhjennysletku
	4 Ilmanpoiston lähtöliitäntä ulos	
FR	1 Tuyau d'aération	5 Sortie d'évacuation vers un lieu extérieur
	2 Tuyau d'aération de digesteur	6 Tuyau d'évacuation du boîtier
	3 Analyseur	7 Tuyau d'évacuation
	4 Sortie de mise à l'air libre vers un lieu extérieur	
HR	1 Cijev za odzračivanje	5 Izlaz za odvod na vanjsku lokaciju
	2 Cijev za odzračivanje uređaja za razgradnju	6 Kućište odvodne cijevi
	3 Analizator	7 Odvodna cijev
	4 Izlaz za odzračivanje na vanjsku lokaciju	
HU	1 Szellőzőcső	5 Külső lefolyónyalás
	2 Lebontó szellőzőcsöve	6 Ház lefolyójának csővezetéke
	3 Analizátor	7 Üritőcső
	4 Külső szellőzőnyílás	

IT	1 Tubo di sfiato	5 Uscita di scarico uscita verso un luogo esterno
	2 Tubo di sfiato del digestore	6 Tubo di scarico alloggiamento
	3 Analizzatore	7 Tubo di scarico
	4 Uscita di sfiato verso un luogo esterno	
LT	1 Ventiliacinis vamzdelis	5 Ištuštinimo išvadas į išorinę vietą
	2 Skaidymo įrenginio ventiliavimo vamzdeliai	6 Ištuštinimo vamzdelis ant gaubto
	3 Analizatorius	7 Ištuštinimo vamzdelis
	4 Ventiliacijos išvadas į išorinę vietą	
NL	1 Ontluchtings slang	5 Afvoeruitlaat naar externe locatie
	2 Ontluchtings slang vergister	6 Afvoerslangen behuizing
	3 Analyser	7 Slangen aftappen
	4 Ontluchtingsuitlaat naar externe locatie	
PL	1 Przewód odpowietrzający	5 Wylot spustowy do lokalizacji zewnętrznej
	2 Przewód odpowietrzający fermentatora	6 Przewód spustowy obudowy
	3 Analizator	7 Przewód spustowy
	4 Wylot odpowietrzający do lokalizacji zewnętrznej	
PT-PT	1 Tubos de ventilação	5 Saída de drenagem para um local externo
	2 Tubos de ventilação do digestor	6 Tubos de drenagem da estrutura
	3 Analisador	7 Tubos de drenagem
	4 Saída de ventilação para um local externo	
RO	1 Tub de aerisire	5 Ieșire de scurgere într-o locație externă
	2 Tub pentru aerisirea blocului de digestie	6 Tub de scurgere a carcasei
	3 Analizor	7 Tubulatură scurgere
	4 Ieșire de aerisire într-o locație externă	
RU	1 Вентиляционная трубка	5 Вывод слива во внешнее пространство
	2 Вентиляционная трубка биореактора	6 Дренажная трубка корпуса
	3 Анализатор	7 Дренажная трубка
	4 Вентиляционный вывод во внешнее пространство	
SK	1 Vetracie hadičky	5 Odtokový výstup do externého priestoru
	2 Vetracie hadičky mineralizátora	6 Kryt odtokovej hadičky
	3 Analyzátor	7 Odtoková hadička
	4 Vetrací výstup do externého priestoru	
SL	1 Oddušna cev	5 Izhod odтока na zunanjo lokacijo
	2 Zračenje cevi posode za razkroj	6 Cev za odvajanje vode iz ohišja
	3 Analizator	7 Odtočna cev
	4 Odvod zraka na zunanjo lokacijo	
SV-SE	1 Ventilslang	5 Dräneringsutlopp till en extern plats
	2 Ventilslang för nedbrytning	6 Höljets uttömnings slang
	3 Analysator	7 Dränerings slang
	4 Ventilutlopp till en extern plats	

TR	1 Havalandırma hortumu	5 Harici konuma giden tahliye çıkışı
	2 Sindirici havalandırma hortumu	6 Muhafaza tahliye hortumu
	3 Analizör	7 Tahliye hortumu
	4 Harici konuma giden havalandırma çıkışı	

13

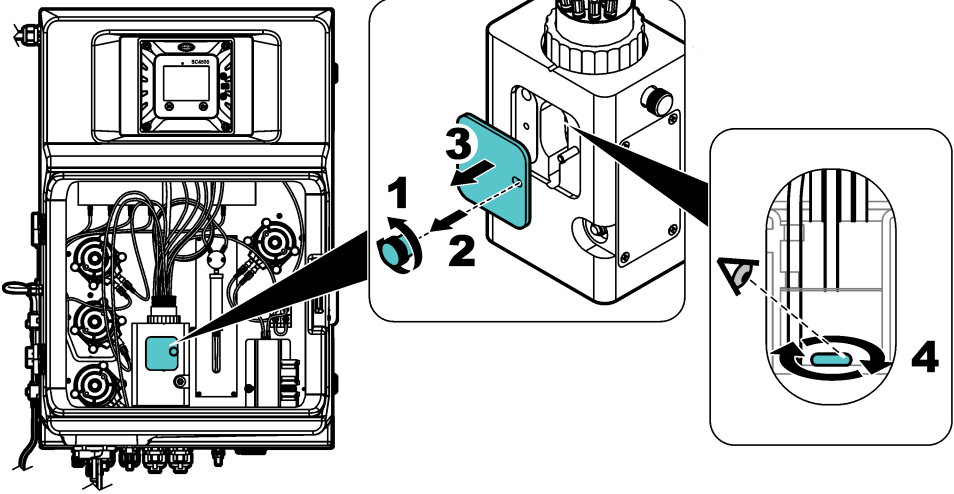

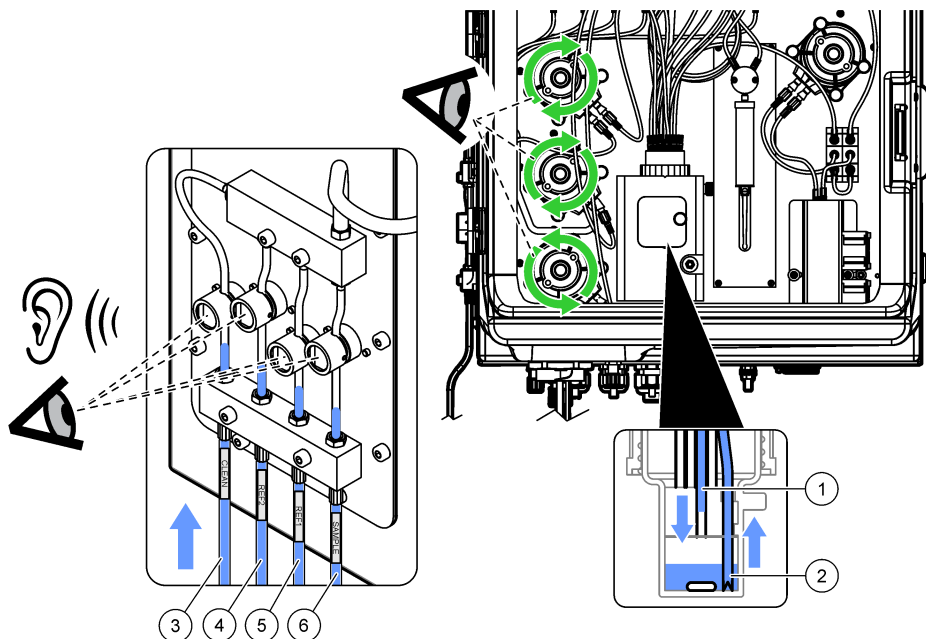


<b>BG</b>	1	Тръбичка за нивелиране (запълва съда)	4	Тръба за референтен разтвор 2 (REF2)
	2	Дренажни тръби	5	Тръба за референтен разтвор 1 (REF1)
	3	Тръба за почистващ разтвор	6	Входяща тръба за проби
<b>CS</b>	1	Hladinová hadička (plní nádobu)	4	Hadička roztoku Reference 2 (REF2)
	2	Vypouštěcí hadička	5	Hadička roztoku Reference 1 (REF1)
	3	Hadička čistícího roztoku	6	Hadička přívodu vzorku
<b>DA</b>	1	Udligningssslange (fylder beholderen)	4	Slange til Reference 2-opløsning (REF2)
	2	Drænslange	5	Slange til Reference 1-opløsning (REF1)
	3	Renseopløsningssslange	6	Prøveindløbssslange
<b>DE</b>	1	Nivellierschlauch (füllt das Gefäß)	4	Schlauch für Referenzlösung 2 (REF2)
	2	Ablaufschlauch	5	Schlauch für Referenzlösung 1 (REF1)
	3	Schlauch für Reinigungslösung	6	Probenzulaufschlauch
<b>EL</b>	1	Σωλήνωση στάθμισης (γεμίζει το δοχείο)	4	Σωλήνας διαλύματος αναφοράς 2 (REF2)
	2	Σωλήνωση αποστράγγισης	5	Σωλήνας διαλύματος αναφοράς 1 (REF1)
	3	Σωλήνας διαλύματος καθαρισμού	6	Σωλήνας εισόδου δείγματος


EN	1 Levelling tubing (fills the vessel)	4 Reference 2 solution (REF2) tube
	2 Drain tubing	5 Reference 1 solution (REF1) tube
	3 Cleaning solution tube	6 Sample inlet tube
ES	1 Tubos de nivelación (llenan el vaso)	4 Tubo de solución de Referencia 2 (REF2)
	2 Tubos de drenaje	5 Tubo de solución de Referencia 1 (REF1)
	3 Tubo de solución limpiadora	6 Tubo de entrada de muestra
ET	1 Tasandustoru (täidab nõu)	4 Etalonalhuse 2 (REF2) toru
	2 Äravoolutoru	5 Etalonalhuse 1 (REF1) toru
	3 Pesulahuse toru	6 Proovi sissevõtutoru
FI	1 Täyttöletku (täyttää astian)	4 Viitteen 2 liuoksen (REF2) letku
	2 Tyhjennysletku	5 Viitteen 1 liuoksen (REF1) letku
	3 Puhdistusliuoksen letku	6 Näytetuloletku
FR	1 Tuyau de mise à niveau (remplit la cuve)	4 Tuyau de solution de référence 2 (REF2)
	2 Tuyau d'évacuation	5 Tuyau de solution de référence 1 (REF1)
	3 Tuyau de solution de nettoyage	6 Tube d'entrée d'échantillon
HR	1 Poravnanje cijevi (punjenje posude)	4 Cijev za otopinu Referenca 2 (REF2)
	2 Cijev za odvod	5 Cijev za otopinu Referenca 1 (REF1)
	3 Cijev za otopinu za čišćenje	6 Cijev ulaza za uzorak
HU	1 Szintezőcső (a tartály feltöltéséért felelős)	4 2. referenciaoldat (REF2) csőve
	2 Üritőcső	5 1. referenciaoldat (REF1) csőve
	3 Tisztítóoldat csőve	6 Mintabemeneti cső
IT	1 Tubo di livellamento (riempie il contenitore)	4 Tubo della soluzione di riferimento 2 (REF2)
	2 Tubo di scarico	5 Tubo della soluzione di riferimento 1 (REF1)
	3 Pulizia del tubo della soluzione	6 Tubo di ingresso campione
LT	1 Lygio reguliavimo vamzdelis (užpildo indą)	4 Etaloninio 2 tirpalo (REF2) vamzdelis
	2 Ištuštinimo vamzdelis	5 Etaloninio 1 tirpalo (REF1) vamzdelis
	3 Valymo tirpalo vamzdelis	6 Mėginio įleidimo vamzdelis
NL	1 Nivelleerslang (vult het vat)	4 Slang voor referentie 2-oplossing (REF2)
	2 Slangen aftappen	5 Slang voor referentie 1-oplossing (REF1)
	3 Slang met reinigungsoplossing	6 Monsterinlaatslang
PL	1 Rurka poziomu (napelnia naczyńie)	4 Rurka roztworu Wzorzec 2 (REF2)
	2 Przewód spustowy	5 Rurka roztworu Wzorzec 1 (REF1)
	3 Rurka roztworu czyszczącego	6 Rurka wlotu próbki
PT-PT	1 Tubos de nivelamento (enchem o recipiente)	4 Tubo de solução de referência 2 (REF2)
	2 Tubos de drenagem	5 Tubo de solução de referência 1 (REF1)
	3 Tubo de solução de limpeza	6 Tubo de entrada da amostra
RO	1 Tubulatură nivelare (umple vasul)	4 Tubul de soluție de referință 2 (REF2)
	2 Tubulatură scurgere	5 Tubul de soluție de referință 1 (REF1)
	3 Curățarea tubului de soluție	6 Tubul de admisie a probei
RU	1 Выравнивающая трубка (заполняет сосуд)	4 Трубка с эталонным раствором 2 (REF2)
	2 Дренажная трубка	5 Трубка с эталонным раствором 1 (REF1)
	3 Трубка с раствором для очистки	6 Трубка входа пробы

<b>SK</b>	1 Vyrovnávací hadička (naplní nádobu)	4 Hadička na referenčný roztok 2 (REF2)
	2 Odtoková hadička	5 Hadička na referenčný roztok 1 (REF1)
	3 Hadička na čistiaci roztok	6 Hadička vstupu vzorky
<b>SL</b>	1 Cevka za uravnavanje (napolni posodo)	4 Cev za raztopino Referenca 2 (REF2)
	2 Odtočna cev	5 Cev za raztopino Referenca 1 (REF1)
	3 Cev za čistilno raztopino	6 Cev za dovod vzorca
<b>SV-SE</b>	1 Nivellerings slang (fyller kärlet)	4 Slang för Referens 2-lösning (REF2)
	2 Dränerings slang	5 Slang för Referens 1-lösning (REF1)
	3 Slang för rengöringslösning	6 Provinloppsslang
<b>TR</b>	1 Dengeleme hortumu (kabı doldurur)	4 Referans 2 çözeltisi (REF2) hortumu
	2 Tahliye hortumu	5 Referans 1 çözeltisi (REF1) hortumu
	3 Temizleme çözeltisi hortumu	6 Numune girişi hortumu


15

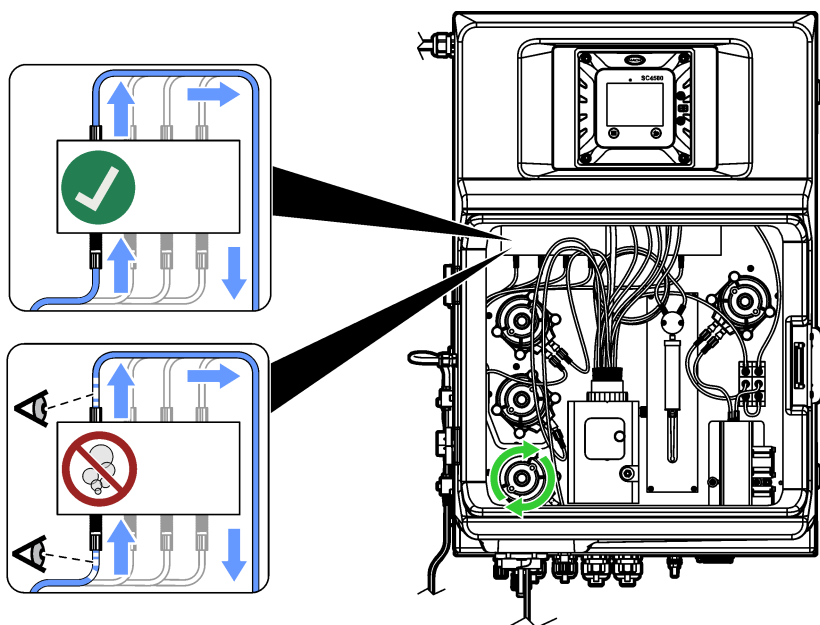


16

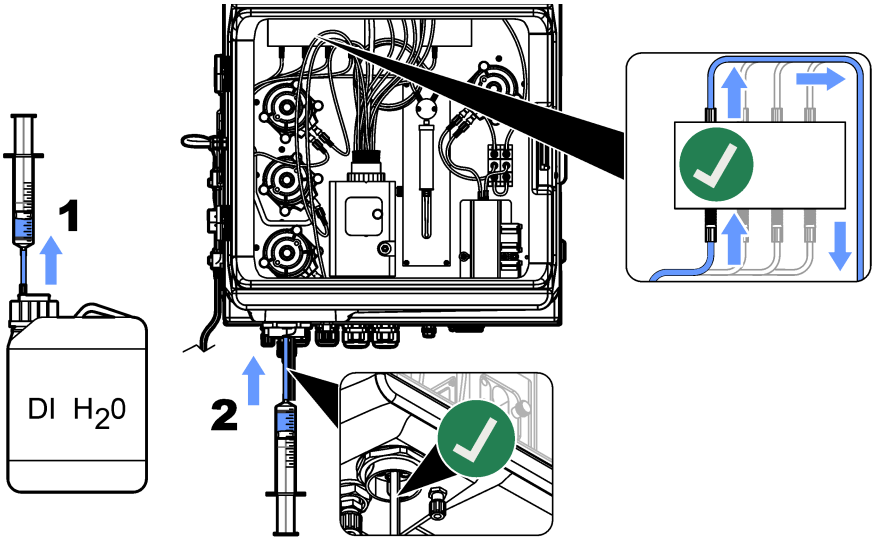

17

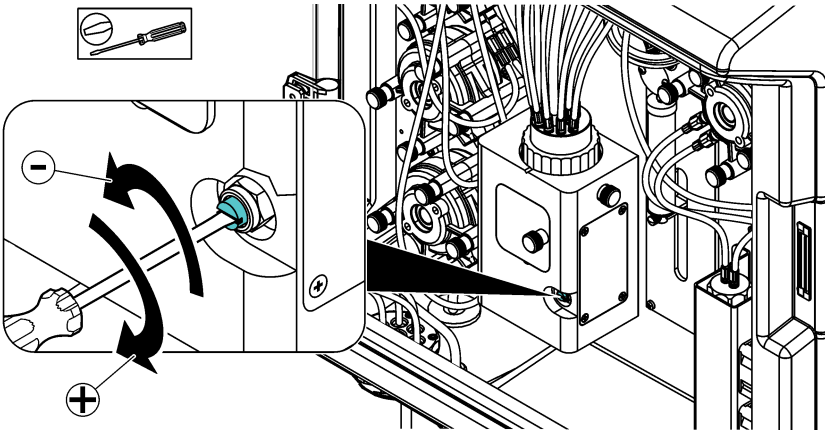

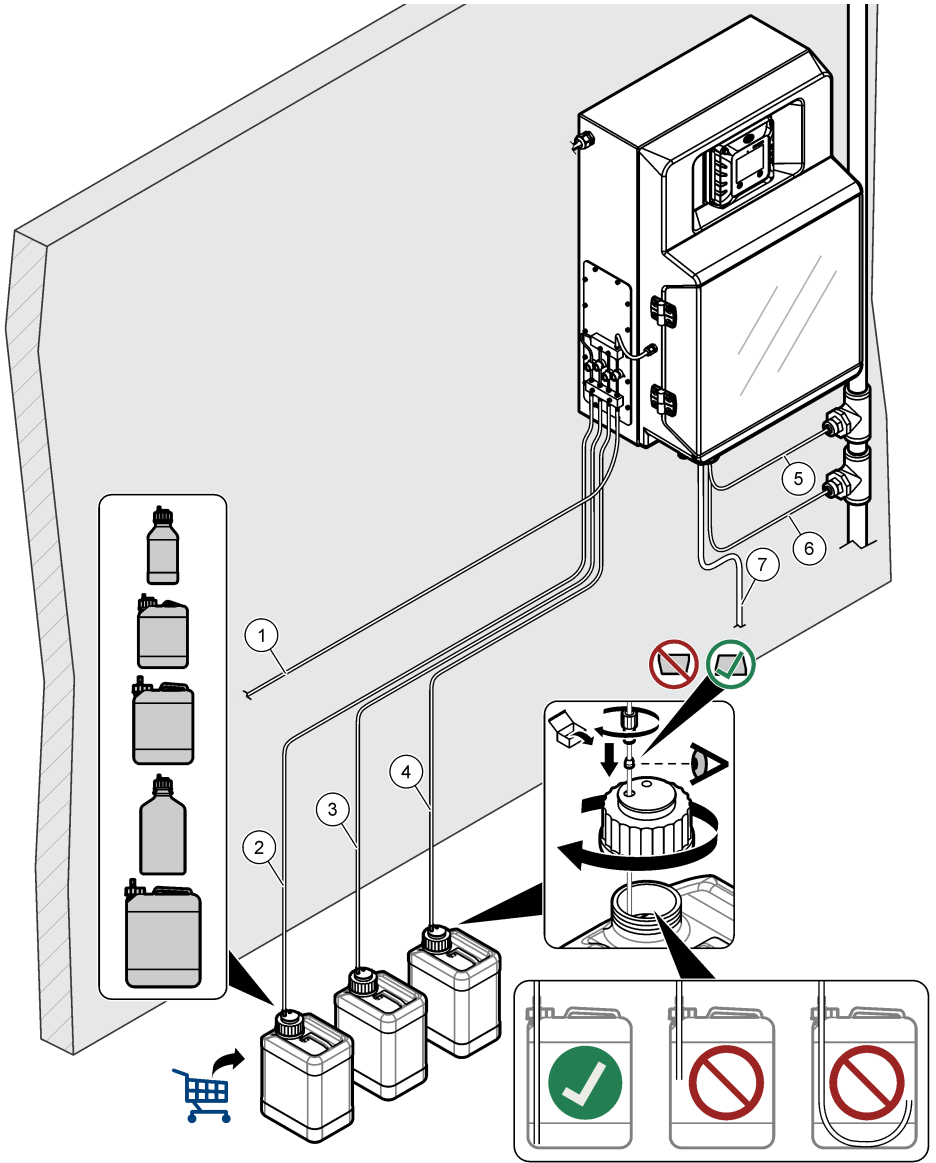

<b>BG</b>	1 Входящи тръби на проби	4 REF1 тръба	7 Дренажни тръби
	2 Почистващ разтвор	5 Тръби за отдушник	
	3 REF2 тръба	6 Вентилационен отвор, устройство за усвояване	
<b>CS</b>	1 Hadička vstupu vzorku	4 Hadička REF1	7 Vypouštěcí hadička
	2 Čisticí roztok	5 Odvětrávací hadička	
	3 Hadička REF2	6 Odvětrávací digestoř	
<b>DA</b>	1 Prøveindløbsslange	4 REF1-slange	7 Drænslange
	2 Rengøringsopløsning	5 Udluftningslange	
	3 REF2-slange	6 Ventil til rådnetank	
<b>DE</b>	1 Probenzulaufschlauch	4 Schlauch REF1	7 Ablaufschlauch
	2 Reinigungslösung	5 Entlüftungsschlauch	
	3 Schlauch REF2	6 Entlüftung Aufschlussgefäß	
<b>EL</b>	1 Σωλήνωση εισόδου δείγματος	4 Σωλήνας REF1	7 Σωλήνωση αποστράγγισης
	2 Διάλυμα καθαρισμού	5 Σωλήνωση αερισμού	
	3 Σωλήνας REF2	6 Συσκευή χώνευσης αερισμού	
<b>EN</b>	1 Sample inlet tubing	4 REF1 tubing	7 Drain tubing
	2 Cleaning solution	5 Vent tubing	
	3 REF2 tubing	6 Vent digester	
<b>ES</b>	1 Tubo de entrada de muestra	4 Tubo REF1	7 Tubo de drenaje
	2 Solución de limpieza	5 Tubo de ventilación	
	3 Tubo REF2	6 Digestor de ventilación	
<b>ET</b>	1 Proovi sisselasketoru	4 REF1 toru	7 Äravooluvoolikud
	2 Pesulahu	5 Ventilatsioonivoolikud	
	3 REF2 toru	6 Ventilatsiooni töötlus	
<b>FI</b>	1 Näytteen tuloletku	4 REF1-letku	7 Tyhjennysletku
	2 Puhdistusliuos	5 Ilmanpoistoletku	
	3 REF2-letku	6 Hajotusventtiili	
<b>FR</b>	1 Tuyau d'entrée d'échantillon	4 Tuyau REF1	7 Tuyau d'évacuation
	2 Solution de nettoyage	5 Tuyau d'aération	
	3 Tuyau REF2	6 Mise à l'air libre du digesteur	
<b>HR</b>	1 Cijev za dovod uzorka	4 Cijev REF1	7 Odvodna cijev
	2 Otopina za čišćenje	5 Cijev za odzračivanje	
	3 Cijev REF2	6 Cijev za odzračivanje uređaja za razgradnju	
<b>HU</b>	1 Mintaoldat bevezető csővezeték	4 REF1 cső	7 Üritőcső
	2 Tisztítóoldat	5 Szellőzőcső	
	3 REF2 cső	6 Lebontó szellőzője	
<b>IT</b>	1 Tubo di ingresso campione	4 Tubo REF1	7 Tubo di scarico
	2 Soluzione detergente	5 Tubo di sfiato	
	3 Tubo REF2	6 Digestore di sfiato	

LT	1 Mėginio įvado vamzdelis	4 REF1 vamzdelis	7 Ištuštinimo vamzdelis
	2 Valymo tirpalas	5 Ventiliacinis vamzdelis	
	3 REF2 vamzdelis	6 Skaidymo renginio ventiliavimas	
NL	1 Monsterslang	4 REF1-slang	7 Slangen aftappen
	2 Reinigingsoplossing	5 Ontluchtingslang	
	3 REF2-slang	6 Ontluchting vergister	
PL	1 Przewód wlotowy próbek	4 Przewód REF1	7 Przewód spustowy
	2 Roztwór czyszczący	5 Przewód odpowietrzający	
	3 Przewód REF2	6 Odpowietrznik fermentatora	
PT-PT	1 Tubos de entrada da amostra	4 Tubos REF1	7 Tubos de drenagem
	2 Solução de limpeza	5 Tubos de ventilação	
	3 Tubos REF2	6 Digestor de ventilação	
RO	1 Tubulatură pompă prelevare	4 Tubulatură REF1	7 Tubulatură scurgere
	2 Soluție de curățare	5 Tubulatură de aerisire	
	3 Tubulatură REF2	6 Bloc de digestie cu aerisire	
RU	1 Трубка входа пробы	4 Трубка REF1	7 Дренажная трубка
	2 Чистящий раствор	5 Вентиляционная трубка	
	3 Трубка REF2	6 Вентиляционный биореактор	
SK	1 Pritoková hadička vzorky	4 Hadičky REF1	7 Odtoková hadička
	2 Čistiaci roztok	5 Vetracie hadičky	
	3 Hadičky REF2	6 Vetranie mineralizátora	
SL	1 Cev za dovod vzorca	4 Cev REF1	7 Odtočna cev
	2 Čistilna raztopina	5 Oddušna cev	
	3 Cev REF2	6 Zračenje posode za razkroj	
SV-SE	1 Provinloppsslang	4 REF1-slang	7 Dräneringsslang
	2 Rengöringslösning	5 Ventilslang	
	3 REF2-slang	6 Nedbrytningsventil	
TR	1 Numune giriş hortumu	4 REF1 hortumu	7 Tahliye hortumu
	2 Temizleme çözeltisi	5 Havalandırma hortumu	
	3 REF2 hortumu	6 Havalandırma sindirici	







**HACH COMPANY World Headquarters**

P.O. Box 389, Loveland, CO 80539-0389 U.S.A.  
Tel. (970) 669-3050  
(800) 227-4224 (U.S.A. only)  
Fax (970) 669-2932  
orders@hach.com  
www.hach.com

**HACH LANGE GMBH**

Willstätterstraße 11  
D-40549 Düsseldorf, Germany  
Tel. +49 (0) 2 11 52 88-320  
Fax +49 (0) 2 11 52 88-210  
info-de@hach.com  
www.de.hach.com

**HACH LANGE Sàrl**

6, route de Compois  
1222 Vézenaz  
SWITZERLAND  
Tel. +41 22 594 6400  
Fax +41 22 594 6499